



Trevo® Retriever

Instructions for Use	2
Instrucciones de uso	9
Mode d'emploi	17
Gebrauchsanweisung	25
Istruzioni per l'uso	33
Gebruiksaanwijzing	41
Instruções de Utilização	49

Trevo® Retriever

Rx ONLY

Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

WARNING

Contents supplied STERILE using an ethylene oxide (EO) process. Do not use if sterile barrier is damaged. If damage is found, call your Stryker Neurovascular representative.

For single use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

After use, dispose of product and packaging in accordance with hospital, administrative and/or local government policy.

DEVICE DESCRIPTION

The Retriever consists of a flexible, tapered core wire with a shaped section at the distal end. Platinum markers at the distal end allow fluoroscopic visualization. In addition, the shaped section is also radiopaque. Retriever dimensions are indicated on product label. The Retriever has a hydrophilic coating to reduce friction during use. The Retriever has a shaft marker to indicate proximity of Retriever tip relative to Microcatheter tip. A torque device is provided with the Retriever to facilitate manipulation. The torque device is used to lock the core wire to the microcatheter during the procedure. Locking of the torque device to the wire allows the microcatheter and Retriever to be retracted as a system during clot retrieval. An insertion tool is provided to introduce the Retriever into a Microcatheter. The Insertion Tool is a sheath in which the Retriever comes preloaded. Once half the retriever's length is inserted into the microcatheter, the insertion tool is removed. Retrievers have a modified proximal end that permits attachment of the Abbott Vascular DOC Guide Wire Extension (REF 22260). Joining Guide Wire Extension to Retriever facilitates removal or exchange of a catheter while maintaining Retriever position in anatomy. After exchange has been completed, the extension can be detached.

User Information

The Trevo Retriever should only be used by physicians trained in interventional endovascular procedures.

Contents

One (1) Trevo Retriever

One (1) Torque Device

One (1) Insertion Tool

Compatibility

Retriever Size	Trevo Pro14 Microcatheter	Trevo Pro18 Microcatheter	Excelsior® XT-27® Microcatheters (150cm x 6cm straight REF XT275081)	Recommended Minimum Vessel ID (mm)
Trevo XP ProVue 3X20mm	✓	✓		2.5
Trevo XP ProVue 4X20mm		✓		
Trevo ProVue 4X20mm		✓		
Trevo XP ProVue 4X30mm		✓	✓	
Trevo XP ProVue 6X25mm			✓	

Compatibility of the Retriever with other microcatheters has not been established. Performance of the Retriever device may be impacted if a different microcatheter is used.

Balloon Guide Catheters (such as the Merci® Balloon Guide Catheter and the FlowGate® Balloon Guide Catheter) are recommended for use during thrombus removal procedures.

Retrievers are compatible with Boston Scientific Rotating Hemostatic Valve (REF 421242).

Retrievers are compatible with the Abbott Vascular DOC Guide Wire Extension (REF 22260).

INTENDED USE/INDICATIONS FOR USE

1. The Trevo Retriever is indicated for use to restore blood flow in the neurovasculature by removing thrombus for the treatment of acute ischemic stroke to reduce disability in patients with a persistent, proximal anterior circulation, large vessel occlusion, and smaller core infarcts who have first received intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA). Endovascular therapy with the device should start within 6 hours of symptom onset.
2. The Trevo Retriever is intended to restore blood flow in the neurovasculature by removing thrombus in patients experiencing ischemic stroke within 8 hours of symptom onset. Patients who are ineligible for intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA) or who fail IV t-PA therapy are candidates for treatment.
3. The Trevo Retriever is indicated for use to restore blood flow in the neurovasculature by removing thrombus for the treatment of acute ischemic stroke to reduce disability in patients with a persistent, proximal anterior circulation, large vessel occlusion of the internal carotid artery (ICA) or middle cerebral artery (MCA)-M1 segments with smaller core infarcts (0-50cc for age <80 years, 0-20cc for age ≥80 years). Endovascular therapy with the device should start within 6-24 hours of time last seen well in patients who are ineligible for intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA) or who fail IV t-PA therapy.

CONTRAINDICATIONS

None known.

WARNINGS

SPECIFIC WARNINGS FOR INDICATION 1

- The safety and effectiveness of the Trevo Retrievers in reducing disability has not been established in patients with large core infarcts (i.e., ASPECTS ≤ 7). There may be increased risks, such as intracerebral hemorrhage, in these patients.
- The safety and effectiveness of the Trevo Retrievers in reducing disability has not been established or evaluated in patients with occlusions in the posterior circulation (e.g., basilar or vertebral arteries) or for more distal occlusions in the anterior circulation.

SPECIFIC WARNINGS FOR INDICATION 2

- To reduce risk of vessel damage, take care to appropriately size Retriever to vessel diameter at intended site of deployment.

SPECIFIC WARNINGS FOR INDICATION 3

- The safety and effectiveness of the Trevo Retrievers in reducing disability has not been established in patients with large core infarcts (i.e., ASPECTS ≤ 7). There may be increased risks, such as intracerebral hemorrhage, in these patients.
- The safety and effectiveness of the Trevo Retrievers in reducing disability has not been established or evaluated in patients with occlusions in the posterior circulation (e.g., basilar or vertebral arteries) or for more distal occlusions in the anterior circulation.
- Users should validate their imaging software analysis techniques to ensure robust and consistent results for assessing core infarct size.

GENERAL WARNINGS APPLIED TO ALL INDICATIONS

- Administration of IV t-PA should be within the FDA-approved window (within 3 hours of stroke symptom onset).
- To reduce risk of vessel damage, adhere to the following recommendations:
 - Do not perform more than six (6) retrieval attempts in same vessel using Retriever devices.
 - Maintain Retriever position in vessel when removing or exchanging Microcatheter.
- To reduce risk of kinking/fracture, adhere to the following recommendations:
 - Immediately after unsheathing Retriever, position Microcatheter tip marker just proximal to shaped section. Maintain Microcatheter tip marker just proximal to shaped section of Retriever during manipulation and withdrawal.
 - Do not rotate or torque Retriever.
 - Use caution when passing Retriever through stented arteries.
- The Retriever is a delicate instrument and should be handled carefully. Before use and when possible during procedure, inspect device carefully for damage. Do not use a device that shows signs of damage. Damage may prevent device from functioning and may cause complications.
- Do not advance or withdraw Retriever against resistance or significant vasospasm. Moving or torquing device against resistance or significant vasospasm may result in damage to vessel or device. Assess cause of resistance using fluoroscopy and if needed reshath the device to withdraw.
- If Retriever is difficult to withdraw from the vessel, do not torque Retriever. Advance Microcatheter distally, gently pull Retriever back into Microcatheter, and remove Retriever and Microcatheter as a unit. If undue resistance is met when withdrawing the Retriever into the Microcatheter, consider extending the Retriever using the Abbott Vascular DOC guidewire extension (REF 22260) so that the Microcatheter can be exchanged for a larger diameter catheter such as a DAC® Catheter. Gently withdraw the Retriever into the larger diameter catheter.

- Administer anti-coagulation and anti-platelet medications per standard institutional guidelines.
- Users should take all necessary precautions to limit X-radiation doses to patients and themselves by using sufficient shielding, reducing fluoroscopy times, and modifying X-ray technical factors where possible.

PRECAUTIONS

- Store in cool, dry, dark place.
- Do not use open or damaged packages.
- Use by "Use By" date.
- Exposure to temperatures above 54°C (130°F) may damage device and accessories. Do not autoclave.
- Do not expose Retriever to solvents.
- Use Retriever in conjunction with fluoroscopic visualization and proper anti-coagulation agents.
- To prevent thrombus formation and contrast media crystal formation, maintain a constant infusion of appropriate flush solution between guide catheter and Microcatheter and between Microcatheter and Retriever or guidewire.
- Do not attach a torque device to the shaped proximal end of DOC Compatible Retriever. Damage may occur, preventing ability to attach DOC Guide Wire Extension.

ADVERSE EVENTS

Procedures requiring percutaneous catheter introduction should not be attempted by physicians unfamiliar with possible complications which may occur during or after the procedure. Possible complications include, but are not limited to, the following:

- air embolism
- hematoma or hemorrhage at puncture site
- infection
- distal embolization
- pain/headache
- vessel spasm
- thrombosis
- dissection
- perforation
- emboli
- acute occlusion
- ischemia
- intracranial hemorrhage
- false aneurysm formation
- neurological deficits including stroke
- death

Use of device requires fluoroscopy which presents potential risks to physicians and patients associated with x-ray exposure. Possible risks include, but are not limited to, the following:

- alopecia,
- burns ranging in severity from skin reddening to ulcers,
- cataracts,
- delayed neoplasia

Adverse Event Reporting

Please notify your Stryker Neurovascular representative immediately if a device malfunctions or patient complication or injury is experienced or suspected. Please make every attempt to retain any suspect device, its associated components and their packaging for return to Stryker Neurovascular.

HOW SUPPLIED

Stryker Neurovascular products are sterile and non-pyrogenic in unopened packaging that is designed to maintain sterility unless the primary product pouch has been opened or damaged.

Do not use if package is opened or damaged.

Do not use if labeling is incomplete or illegible.

Handling and Storage

Store in a cool, dry, dark place.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

Recommended Preparation Procedure

1. Flush Retriever package hoop with saline. Hydrate for 2 minutes minimum before removing Retriever from hoop. Keep Retriever hydrated.
2. Prepare and place Balloon Guide Catheter or Guide Catheter into internal carotid artery, common carotid artery or subclavian artery as specified in guide catheter labeling.
3. Connect rotating hemostasis valve to Microcatheter hub.

4. Using conventional catheterization techniques, place Microcatheter into target vessel using a standard neurovascular guidewire. Anotomy permitting, position Microcatheter tip distal to thrombus.
5. Remove guidewire from Microcatheter. Inject contrast media through Microcatheter to visualize distal vasculature. Flush Microcatheter.
6. Remove insertion tool and preloaded Retriever as a unit from package hoop. Do not allow Retriever to exit insertion tool tip or to retract further into insertion tool.
7. **Important:** Introduce insertion tool half way into the rotating hemostasis valve and use syringe or infusion line to flush insertion tool until saline exits the proximal end of the insertion tool. If insertion tool is not properly flushed, it may be difficult to advance the Retriever through the insertion tool.
8. Seat insertion tool into Microcatheter hub and close rotating hemostasis valve tightly to secure insertion tool in place.
9. Advance Retriever until half of its length has been inserted into Microcatheter. Remove insertion tool.

Recommended Retrieval Procedure

1. Advance Retriever until the distal tip aligns with the distal tip of the Microcatheter.

Note: The following table describes where the Retriever tip (the distal end of the Retriever) is located in relation to the microcatheter tip (the distal end of the microcatheter) when:

- a. the distal end of the Retriever shaft marker reaches the Microcatheter hub, **or**
- b. the proximal end of the Retriever shaft marker reaches the proximal end of the Rotating Hemostasis Valve.

Distal End Monitoring Table

Trevo® ProVue 4x20mm Trevo XP 4x20mm Trevo XP 6x25mm	• Within 8 cm of exiting the microcatheter tip
Trevo XP 3x20mm	• Within 15 cm of exiting the microcatheter tip
Trevo XP 4x30mm	<p>When used with Trevo Pro 18 MC (90238):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Within 8 cm of exiting the microcatheter tip <p>When used with Excelsior® XT-27® MC (XT275081):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Within 15 cm of exiting the microcatheter tip

2. Retract Microcatheter while applying gentle forward force to Retriever to deploy shaped section of Retriever within clot. Position Microcatheter tip marker just proximal to shaped section of Retriever.

WARNING: To reduce risk of kinking/fracture, maintain Microcatheter tip marker just proximal to shaped section of Retriever during manipulation and withdrawal.

3. After deploying Retriever, visualize strut expansion and allow sufficient time for clot to integrate into the Retriever (approximately 5 minutes).
4. If using a Balloon Guide Catheter, inflate balloon to occlude vessel as specified in Balloon Guide Catheter labeling.
5. Position and lock torque device onto Retriever at Microcatheter hub.
6. Slowly withdraw Retriever and Microcatheter as a unit to Balloon Guide Catheter tip while applying aspiration to Balloon Guide Catheter using 60 mL syringe.
7. Apply vigorous aspiration to Balloon Guide Catheter using 60 mL syringe and withdraw Retriever and Microcatheter inside guide catheter. Continue aspirating until Retriever and Microcatheter are nearly withdrawn from guide catheter.

Note: If withdrawal into Balloon Guide Catheter or Guide Catheter is difficult, deflate Balloon Guide Catheter balloon and simultaneously withdraw guide catheter, Microcatheter and Retriever as a unit through sheath. Remove sheath if necessary.

8. Deflate Balloon Guide Catheter balloon.
9. Disconnect Balloon Guide Catheter rotating hemostasis valve and fully remove Retriever, Microcatheter and rotating hemostasis valve as a unit from guide catheter.
10. Attach 60 mL syringe to Balloon Guide Catheter hub and aspirate.
11. Clean the device with saline. Inspect Retriever for damage. Do not reuse Retriever if core wire, shaped section or platinum coil appears different than when first removed from package. If not damaged, the Retriever may be used for up to three (3) retrieval attempts. A retrieval attempt is one (1) advancement and complete withdrawal cycle.

Recommended Catheter Exchange Procedure

1. Follow Instructions For Use provided with Abbott Vascular DOC Guide Wire Extension, except treat "Retriever" as the "guide wire" when following IFU steps.

CLINICAL STUDIES

Safety and Effectiveness Information

DAWN™ Study to support Indication 3

DAWN (DWI and CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention) was a prospective, randomized, multi-center, controlled trial designed to evaluate the hypothesis that Trevo® Retriever thrombectomy plus medical management leads to superior clinical outcomes at 90 days as compared to medical management alone in appropriately selected subjects experiencing an acute ischemic stroke when treatment is initiated within 6-24 hours after last seen well. A total of 206 subjects were enrolled across 26 investigative sites: 107 subjects (51.9%) were randomized to the Treatment Arm and 99 subjects (48.1%) were randomized to the Control Arm. The mean UW-mRS values at 90 days were 5.5 in the Treatment arm vs 3.4 in the Control arm; the core infarct adjusted group difference in utility-weighted degree of disability was 2.0 (95% Bayesian Credible Interval, 1.1 to 3.0, posterior probability of superiority >0.9999). Treatment with Trevo Retriever led to higher rates of functional independence (mRS 0-2) at 90 days, 48.6% vs. 13.1%; core infarct adjusted group difference 32.8% (95% Credible Interval, 21.1% to 44.1%, posterior probability of superiority >0.9999). The rate of symptomatic intracranial hemorrhage at 24 hours was higher in patients undergoing endovascular therapy. Patients and/or their legally authorized representatives should be advised of this risk during the treatment decision-making process. There is greater level of uncertainty in the results shown for subjects in the 18-24 hour time from last seen well.

Key Inclusion Criteria

Acute ischemic stroke with confirmed occlusion of intracranial ICA and/or M1, that failed or were contraindicated for IV t-PA, treatment within 6-24 hours after time last known well, baseline NIHSS ≥10, informed consent given and age 18 or over; In patients younger than 80, a stroke score equal to or greater than 10 must be associated with a core volume less than 51ml. In patients 80 or older, the stroke score must be greater than 10 and volume less than 21ml. Clinical-core mismatch which is defined as the mismatch between baseline infarct volume (or core) on CT or MRI imaging and the extent of total brain tissue at risk. Infarct volume was assessed with the use of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) or perfusion CT and was measured with one of the commercially available automated software packages (RAPID, IschemiaView).

Key Exclusion criteria

Rapid improvement in neurological status to an NIHSS <10 or evidence of vessel recanalization prior to randomization; Arterial blood pressure > 185/110 mmHg; laboratory evidence of electrolyte imbalance (i.e. sodium <130 mmol/L, potassium>3 mEq/L or >6 mEq/L); laboratory evidence of renal failure (i.e. serum creatinine >3.0 mg/dL (264 µmol/L); laboratory evidence of coagulation abnormalities (i.e., platelet count <50,000/µL, APTT>3 times normal or INR>3.0, if given factor Xa inhibitor 24-48 hours ago must have normal PTT); laboratory evidence of bleeding (i.e. hemoglobin <7mmol/L).

The primary endpoint was 90-day disability assessed by modified Rankin scale (mRS).

The secondary objective is to provide evidence that endovascular reperfusion with Trevo Retriever is associated with a significant reduction in median infarct size compared to the control group at 24 (-6/+24) hours post randomization. Secondary endpoints include proportion of subjects with good functional outcome at 90 days (mRS of 0-2); proportion of subjects with NIHSS drop of ≥10 points from baseline or NIHSS score 0 or 1; difference between treatment and control arm in all cause mortality; difference in median final infarct size at 24 hours; difference in revascularization rates at 24 hours; and rate of reperfusion to TICI >2b.

The safety outcomes include incidence of stroke-related mortality at 90 days; incidence of SICH, neurological deterioration, procedure-related and device-related serious adverse events.

90 Day Modified Rankin Scale ITT Population

Modified Rankin Scale (mRS)	Treatment Arm N=107	Control Arm N=99
0 - No symptoms / UW = 10	9.3% (10/107)	4.0% (4/99)
1 - No significant disability / UW = 9.1	22.4% (24/107)	5.1% (5/99)
2 - Slight disability / UW = 7.6	16.8% (18/107)	4.0% (4/99)
3 - Moderate disability / UW = 6.5	13.1% (14/107)	16.2% (16/99)
4 - Moderately severe disability / UW = 3.3	13.1% (14/107)	34.3% (34/99)
5 - Severe disability / UW = 0	6.5% (7/107)	18.2% (18/99)
6 - Dead / UW = 0	18.7% (20/107)	18.2% (18/99)
90 Day mRS [0-2]	48.6% (52/107)	13.1% (13/99)
90 Day Weighted mRS*		
Mean ± SD (N)	5.5 ± 3.8 (107)	3.4 ± 3.2 (99)
Median (Q1, Q3)	6.5 (0.0, 9.1)	3.3 (0.0, 6.5)
Range (min, max)	(0.0, 10.0)	(0.0, 10.0)
[95% Conf. Interval] ¹	[4.8, 6.3]	[2.7, 4.0]

¹By normal approximation

*mRS = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} was assigned a corresponding numerical value = {10, 9.1, 7.6, 6.5, 3.3, 0.0}, which represents its clinical utility

Co-Primary outcomes ITT population

Outcome	Intervention (N=107)	Control (N=99)	Mean Absolute Difference (95% CI)	Posterior mean benefit, core-adjusted (95% credible interval)*	Probability of superiority
Utility-Weighted mRS-mean (SD)	5.5 (3.8)	3.4 (3.1)	2.1 (1.2, 3.1)	2.0 (1.1, 3.0)	>0.9999 ¹
Functional Independence (mRS 0-2)	48.6%	13.1%	35.5% (23.9%, 47.0%)	32.8% (21.1%, 44.1%)	>0.9999

*Estimated by Bayesian general linear model adjusting for Core Infarct

¹The overall probability of a device benefit is then the average of the benefit probabilities for the imputed data sets, weighted by the imputation probabilities of those data sets. This probability is 0.999986.

The second secondary effectiveness endpoint was the NIHSS drop of ≥10 points from baseline or an NIHSS score of 0 or 1.

Early Neurological Response at Day 5-7/Discharge

Outcome	Intervention N=107	Control N=99	Mean Absolute Difference (95% CI)	Risk Ratio (95% CI)	p-value
Early Response†	47.7%	19.2%	28.5% (16.2%, 40.7%)	2.5 (1.6, 3.9)	<0.001

[†]Defined as NIHSS drop of ≥ 10 points from baseline or NIHSS 0 or 1 at day 5-7 or discharge (whichever was earlier). The p-value was not adjusted for multiplicity.

The secondary effectiveness outcome was the revascularization rates at 24 hours defined as the presence of partial or complete recanalization.

Revascularization rates at 24 hours

	Total N=206	Treatment Arm N=107	Control Arm N=99	Difference [95% CI]	p-value
Difference in revascularization rates at 24 (-6+24) hours from randomization	58.7% (121/206)	76.6% (82/107)	38.4% (38/99)	40.2% [27.1%, 51.5%]	<0.0001 ^a

Revascularization at 24 hours was defined as the presence of partial or complete recanalization.

a. t-test. The p-value was not adjusted for multiplicity.

The primary safety endpoint was the incidence of stroke-related mortality at 90 days. The secondary safety outcomes for both Treatment and Control Arms are incidence of SICH, by ECASS definition, within 24 (-6/+24) hours post randomization (time zero), and incidence of neurological deterioration from baseline NIHSS score through Day 5-7/discharge (whichever is earlier) post randomization. Neurological deterioration was defined as ≥ 4 point increase in the NIHSS score from the baseline score.

Stroke-Related Mortality at 90 Days

	Total N=206	Treatment Arm N=107	Control Arm N=99	Difference [95% CI] ¹	p-value
Incidence of all stroke-related mortality at 90 days	17.0% (35/206)	15.9% (17/107)	18.2% (18/99)	-2.3% [-12.6%, 8.0%]	0.7126 ^a

¹By normal approximation

a. t-test. The p-value was not adjusted for multiplicity.

The secondary safety outcome was the Incidence of SICH, by ECASS III definition, within 24 (-6/+24) hours post randomization (time zero).

Incidence of SICH by CEC Adjudication

	Total N=206	Treatment Arm N=107	Control Arm N=99	Difference [95% CI] ¹	p-value
SICH at 24 (-6+24) hrs post randomization	4.4% (9/206)	5.6% (6/107)	3.0% (3/99)	2.6% [-2.9%, 8.1%]	0.5011 ^a

¹By normal approximation

a. Fisher's exact test. The p-value was not adjusted for multiplicity.

Incidence of neurological deterioration was defined as a ≥ 4 point increase in the NIHSS score from baseline through Day 5-7/Discharge post randomization (time zero).

Incidence of Neurological Deterioration by CEC Adjudication

	Total N=206	Treatment Arm N=107	Control Arm N=99	Difference [95% CI] ⁱ	p-value
Incidence of neurological deterioration between baseline and Day 5 to 7/ Discharge	19.9% (41/206)	14.0% (15/107)	26.3% (26/99)	-12.2% [-23.1%, -1.4%]	0.0358 ^a

ⁱBy normal approximation

a. t-test. The p-value was not adjusted for multiplicity.

Functional independence (90 Day mRS 0-2) Sub-grouped by Time

TLSW Intervals	Treatment	Control	Difference	p-value
6-9 hrs	50.0% (9/18)	14.3% (3/21)	35.7% [8.2%, 63.2%]	0.0346 ^a
9-12 hrs	58.1 % (18/31)	26.1%(6/24)	33.1% [8.5%, 57.6%]	0.0273 ^a
6-12 hrs Total	55.1% (27/49)	20.0% (9/45)	35.1% [16.9%, 53.3%]	0.0006^a
12-15 hrs	37.5% (6/16)	9.1% (2/22)	28.4% [1.8%, 55.0%]	0.0498 ^a
15-18 hrs	50.0% (13/26)	5.3% (1/19)	44.7% [23.1%, 66.4%]	0.0025 ^a
18-21 hrs	36.4% (4/11)	0.0% (0/8)	36.4% [7.9%, 64.8%]	0.1032 ^a
21-24 hrs	40.0% (2/5)	20.0% (1/5)	20.0% [-35.4%, 75.4%]	1.0000 ^a
12-24 Total*	43.1% (25/58)	7.4% (4/54)	35.7% [21.2%, 50.2%]	< 0.0001^a

a. Fisher's exact test


* Greater level of uncertainty in the results shown for subjects in the 18-24 hour time from last seen well

The p-value was not adjusted for multiplicity.

The following table is a summary of all serious and non-serious adverse events for all Control Arm and Treatment Arm subjects by MedDRA Dictionary System Organ Classes (SOC).

MedDRA* System Organ Class	Treatment arm N=107						Control Arm N=99					
	SAEs	Subjects with SAEs	Non SAEs	Subjects with Non SAEs	Total AEs	Subjects with Total AEs	SAEs	Subjects with SAEs	Non SAEs	Subjects with Non SAEs	Total AEs	Subjects with Total AEs
Any Adverse Event (AE)	65	41 (38.3%)	476	102 (95.3%)	541	103 (96.3%)	83	47 (47.5%)	473	91 (91.9%)	556	91 (91.9%)
Blood and lymphatic system disorders	0	0	11	10 (9.3%)	11	10 (9.3%)	1	1 (1.0%)	8	8 (8.1%)	9	8 (8.1%)
Cardiac disorders	8	7 (6.5%)	37	29 (27.1%)	45	33 (30.8%)	6	5 (5.1%)	29	24 (24.2%)	35	28 (28.3%)
Endocrine disorders	0	0	1	1 (0.9%)	1	1 (0.9%)	0	0	0	0	0	0
Eye disorders	1	1 (0.9%)	0	0	1	1 (0.9%)	0	0	2	2 (2.0%)	2	2 (2.0%)
Gastrointestinal disorders	7	6 (5.6%)	42	30 (28.0%)	49	34 (31.8%)	12	11 (11.1%)	38	28 (28.3%)	50	34 (34.3%)
General disorders and administration site conditions	0	0	22	18 (16.8%)	22	18 (16.8%)	0	0	17	15 (15.2%)	17	15 (15.2%)
Hepatobiliary disorders	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1.0%)	1	1 (1.0%)
Immune system disorders	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1.0%)	1	1 (1.0%)
Infections and infestations	6	6 (5.6%)	46	34 (31.8%)	52	38 (35.5%)	7	7 (7.1%)	54	41 (41.4%)	61	43 (43.4%)
Injury, poisoning and procedural complications	2	2 (1.9%)	8	7 (6.5%)	10	9 (8.4%)	2	2 (2.0%)	8	6 (6.1%)	10	7 (7.1%)
Investigations	0	0	5	5 (4.7%)	5	5 (4.7%)	0	0	10	10 (10.1%)	10	10 (10.1%)
Metabolism and nutrition disorders	0	0	76	47 (43.9%)	76	47 (43.9%)	0	0	62	34 (34.3%)	62	34 (34.3%)
Musculoskeletal and connective tissue disorders	0	0	11	10 (9.3%)	11	10 (9.3%)	2	2 (2.0%)	22	15 (15.2%)	24	16 (16.2%)
Neoplasms benign, malignant and unspecified	0	0	1	1 (0.9%)	1	1 (0.9%)	0	0	0	0	0	0
Nervous system disorders	21	21 (19.6%)	95	63 (58.9%)	116	71 (66.4%)	34	30 (30.3%)	88	53 (53.5%)	122	66 (66.7%)
Psychiatric disorders	1	1 (0.9%)	26	24 (22.4%)	27	24 (22.4%)	2	2 (2.0%)	30	27 (27.3%)	32	28 (28.3%)
Renal and urinary disorders	0	0	18	15 (14.0%)	18	15 (14.0%)	1	1 (1.0%)	19	14 (14.1%)	20	15 (15.2%)
Reproductive system and breast disorders	0	0	1	1 (0.9%)	1	1 (0.9%)	0	0	2	2 (2.0%)	2	2 (2.0%)
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	14	11 (10.3%)	33	28 (26.2%)	47	33 (30.8%)	11	9 (9.1%)	42	34 (34.3%)	53	37 (37.4%)
Skin and subcutaneous tissue disorders	0	0	3	3 (2.8%)	3	3 (2.8%)	0	0	10	7 (7.1%)	10	7 (7.1%)
Surgical and medical procedures	1	1 (0.9%)	1	1 (0.9%)	2	2 (1.9%)	1	1 (1.0%)	2	2 (2.0%)	3	3 (3.0%)
Vascular disorders	4	3 (2.8%)	39	33 (30.8%)	43	34 (31.8%)	4	4 (4.0%)	28	21 (21.2%)	32	23 (23.2%)

*MedDRA v17.0 was used.

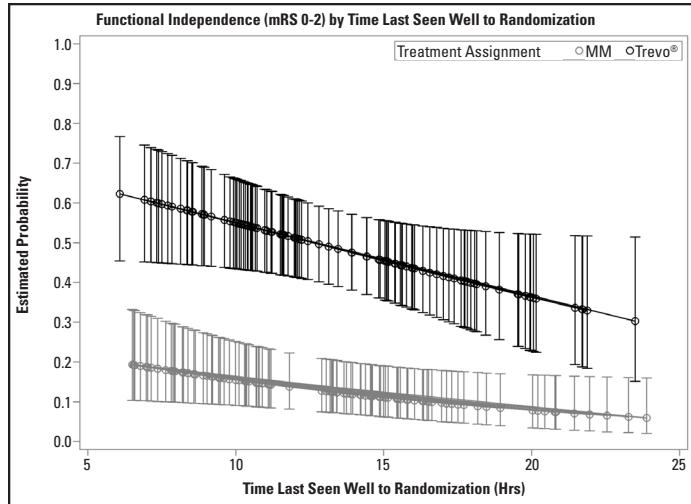

MR CLEAN study to support Indication 1

MR CLEAN was a large, prospective, randomized, open label, controlled, multicenter trial in which every endovascular hospital center in the Netherlands participated. Intra-arterial treatment plus usual care (which could include intravenous administration of IV t-PA) was compared with usual care alone (control group) in patients with acute ischemic stroke and a proximal intracranial arterial occlusion of the anterior circulation that was confirmed on vessel imaging. MR CLEAN randomized 500 patients (233 treatment ("IAT"), 267 control) at 16 medical centers. Retrievable stents (including the Trevo® Retriever product family) were used in 190 of the 233 patients (81.5%) assigned to the IAT arm, of which 120/190 subjects received first line intra-arterial treatment with a Trevo Retriever and 104/120 received IV t-PA within 3 hours from symptoms onset compared to the entire MR CLEAN Medical Management (MM) control group, of which 224 of 249 were treated with IV t-PA in accordance with FDA labeling. Of the 120 subjects who received first line intra-arterial treatment with a Trevo Retriever, 24 subjects had concomitant carotid stenting. These subjects are excluded from the efficacy summary below resulting in a primary efficacy cohort of 96 Trevo Retriever treated subjects. Subjects with IA Lytic usage or use of other mechanical thrombectomy devices after Trevo Retriever were counted as failures in efficacy summaries below.

Key Inclusion Criteria for MR CLEAN

Acute ischemic stroke with confirmed occlusion of ICA, M1, M2, A1 or A2, treatment within 6 hours of symptom onset, and a NIHSS >2, CT or MRI scan ruling out intracranial hemorrhage; informed consent given; and age 18 or over.

Key Inclusion Criteria for Trevo Retriever Subset

Additional key inclusion criteria for Trevo Retriever subset (FDA Cohort) analysis from MR CLEAN: first line treatment with Trevo Retriever and IV t-PA treatment within 3 hours of symptoms onset.

Key Exclusion criteria for MR CLEAN

Arterial blood pressure > 185/110 mmHg; blood glucose <2.7 or > 22.2 mmol/L; intravenous treatment with thrombolytic therapy in a dose exceeding 0.9 mg/kg alteplase or 90 mg; intravenous treatment with thrombolytic therapy despite contra-indications (i.e., major surgery, gastrointestinal bleeding or urinary tract bleeding within the previous 2 weeks, or arterial puncture at a non-compressible site within the previous 7 days; cerebral infarction in the distribution of the relevant occluded artery in the previous 6 weeks; laboratory evidence of coagulation abnormalities (i.e., platelet count <40x10⁹/L, APTT>50 sec or INR>3.0).

The primary effectiveness endpoint was to demonstrate that Trevo Retriever thrombectomy plus MM leads to superior functional independence (mRS <3) at 90 days as compared to MM alone in eligible subjects experiencing an acute ischemic stroke. Based on the analysis, the IAT Trevo Retriever treatment resulted in a highly significant treatment effect when adjusted for sites, IV t-PA use, and baseline NIHSS.

Primary Effectiveness Endpoint

Variable	Ratio for Binary Variables	Odds Ratio [95% CI]	p-value
Trevo Excluding Concomitant Carotid Stenting	Trevo vs MM	1.88 [1.07, 3.29]	0.014 ¹
IV t-PA	Yes vs No	1.45 [0.60, 3.52]	0.4134 ²
NIHSS	>14 or ≤14	0.41 [0.24, 0.69]	0.0010 ²

¹One-sided t-test.

²Two-sided t-test.

Distribution of 90-day mRS*

mRS	Trevo Excluding Concomitant Carotid Stenting (N=96)	90 DAY Mr Clean/Control (N=249)
0	4.2% (4/96)	0.4% (1/249)
1	8.3% (8/96)	5.2% (13/249)
2	17.7% (17/96)	13.7% (34/249)
3	15.6% (15/96)	16.5% (41/249)
4	32.3% (31/96)	31.3% (78/249)
5	7.3% (7/96)	10.4% (26/249)
6	14.6% (14/96)	22.5% (56/249)
mRS [0, <3] with Any IA Lytic use Considered Treatment Failure*	29.2% (28/96)	19.3% (48/249)

*1 subject with IA lytic use was counted as a failure.

*Subjects in both arms received IV tPA within 3 hours (81 out of 96 subjects in the Trevo Retriever cohort and 224 out of 249 subjects in the medical management arm).

The primary safety objective analysis was defined as the all-cause mortality rate between Trevo Retriever plus medical management in comparison to the all-cause mortality rate in the medical management alone control group.

	Trevo FDA Cohort % (x/n) (LCL, UCL) ¹	MM % (x/n) (LCL, UCL) ¹
Mortality by 90 Days	13.33 (16/120) (7.82, 20.75)	22.89 (57/249) (17.82, 28.62)

¹Two-sided 95% Exact Clopper Pearson confidence intervals.

The first secondary effectiveness endpoint was the percentage of patients with no intra-cranial occlusion assessed by a consensus review by up to three readers after 24 hours. The endpoint was assessed by CTA MRA using the Arterial Occlusive Lesion (AOL) scale.

	Trevo Excluding Concomitant Carotid Stenting % (x/N) (LCL, UCL) ²	MM % (x/N) (LCL, UCL) ²
Occlusion Free (24 Hours)	77.5% (62/80) (66.8, 86.1)	33.51 (65/194) (26.90, 40.62)

²Subjects without 24 hour CTA MRA were excluded from this analysis

²Two-sided 95% Exact Clopper Pearson confidence intervals.

The second secondary effectiveness endpoint is the percentage of Trevo Retriever patients that achieved recanalization (TICI 2a or better). This endpoint was also assessed by a consensus review by at least three readers.

	Trevo Excluding Concomitant Carotid Stenting % (x/N) (LCL, UCL) ¹
Revascularization Success (TICI ≥ 2a)	81.3% (78/96) (72.0, 88.5)

¹Two-sided 95% Exact Clopper Pearson confidence intervals.

The third effectiveness endpoint was defined as the difference in neurological outcomes assessed by NIHSS at 24 hours and at 5-7 days post-randomization between Trevo Retriever plus medical management in comparison to the MM control group.

NIHSS	Trevo Excluding Concomitant Carotid Stenting Mean ± SD (N) Median (Min, Max) (LCL, UCL) ²	MM Mean ± SD (N) Median (Min, Max) (LCL, UCL) ²
NIHSS (24 Hours)	14.23 ± 9.23 (96) 14.00 (1, 42) (12.36, 16.10)	16.19 ± 7.77 (240) 16 (0, 42) (15.20, 17.18)
NIHSS (5-7 Days) ¹	13.02 ± 12.16 (94) 12.00 (0, 42) (10.53, 15.51)	15.76 ± 11.49 (237) 15 (0, 42) (14.29, 17.23)

¹Subjects with missing NIHSS were excluded from this analysis. Subjects who expired prior to discharge were assigned a NIHSS value of 42.

²Two-sided 95% confidence limits by normal approximation.

The following table summarizes all adverse events through 90 days post randomization, for the Trevo® Retriever cohort of subjects, utilizing the MR CLEAN study categorization. For all safety analyses, subjects exposed to Trevo Retriever with or without carotid stenting are included.

MR CLEAN Class	Trevo FDA Cohort 120 Subjects w/189 Events % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Number of Events	MM 249 Subjects w/331 Events % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Number of Events
Ischemic stroke	2.5% (3/120) [0.5%, 7.1%] 3	0.8% (2/249) [0.1%, 2.9%] 2
Symptomatic intracranial hemorrhage	7.5% (9/120) [3.5%, 13.8%] 9	6.8% (17/249) [4.0%, 10.7%] 17
Extracranial hemorrhage	2.5% (3/120) [0.5%, 7.1%] 3	4.4% (11/249) [2.2%, 7.8%] 11
Cardiac Ischemia	0	2.0% (5/249) [0.7%, 4.6%] 5
Allergic reaction	1.7% (2/120) [0.2%, 5.9%] 2	0.4% (1/249) [0.0%, 2.2%] 1
Pneumonia	18.3% (22/120) [11.9%, 26.4%] 24	19.3% (48/249) [14.6%, 24.7%] 52
Other infection	23.3% (28/120) [16.1%, 31.9%] 34	13.7% (34/249) [9.6%, 18.6%] 41
Other complication	47.5% (57/120) [38.3%, 56.8%] 89	38.6% (96/249) [32.5%, 44.9%] 154
Progression of stroke	20.8% (25/120) [14.0%, 29.2%] 25	18.9% (47/249) [14.2%, 24.3%] 48

¹Two-sided 95% Exact Clopper Pearson confidence intervals

The following table summarizes all MR CLEAN adverse events through 90 days post randomization, for the FDA cohort, by MedDRA coding.

MR CLEAN MeDRA v18.0 Coded Adverse Events for FDA cohort over 1% Frequency

MedDRA Preferred Term	Trevo FDA Cohort (N=120) Patients with Events (%)	Control (N=249) Patients with Events (%)
Stroke in evolution	19 (15.8%)	41 (16.5%)
Haemorrhage intracranial	13 (10.8%)	20 (8.0%)
Urinary tract infection	11 (9.2%)	17 (6.8%)
Atrial fibrillation	10 (8.3%)	10 (4.0%)
Pyrexia	6 (5.0%)	6 (2.4%)
Neurological decompensation	6 (5.0%)	6 (2.4%)
Pneumonia aspiration	5 (4.2%)	8 (3.2%)
Delirium	4 (3.3%)	6 (2.4%)
Bone graft	4 (3.3%)	1 (0.4%)
Cardiac failure	3 (2.5%)	7 (2.8%)
Diarrhoea	3 (2.5%)	4 (1.6%)
Urosepsis	3 (2.5%)	4 (1.6%)
Fall	3 (2.5%)	4 (1.6%)
Headache	3 (2.5%)	1 (0.4%)
Ischaemic stroke	3 (2.5%)	1 (0.4%)
Cardiac arrest	2 (1.7%)	0
Hypersensitivity	2 (1.7%)	1 (0.4%)
Clostridium difficile infection	2 (1.7%)	0
Gout	2 (1.7%)	3 (1.2%)
Carotid artery dissection	2 (1.7%)	0
Epilepsy	2 (1.7%)	3 (1.2%)
Depression	2 (1.7%)	4 (1.6%)
Urinary retention	2 (1.7%)	2 (0.8%)
Pulmonary embolism	2 (1.7%)	6 (2.4%)
Haematoma	2 (1.7%)	2 (0.8%)
Anaemia	1 (0.8%)	3 (1.2%)
Bradycardia	1 (0.8%)	3 (1.2%)
Seizure	1 (0.8%)	3 (1.2%)
Respiratory failure	1 (0.8%)	3 (1.2%)
Gastrointestinal tube insertion	1 (0.8%)	5 (2.0%)
Hypotension	1 (0.8%)	3 (1.2%)
Phlebitis	1 (0.8%)	3 (1.2%)
Vasospasm	1 (0.8%)	0
Arrhythmia	0	3 (1.2%)
Myocardial ischaemia	0	3 (1.2%)
Renal failure	0	3 (1.2%)
Deep vein thrombosis	0	3 (1.2%)

TREVO® 2 study to support Indication 2

The TREVO 2 (Trombectomy REvascularization of large Vessel Occlusions in acute ischemic stroke) clinical trial assessed the safety and efficacy of the Trevo Retriever device in comparison to the Merci® Retriever. One hundred and seventy-eight (178) patients were enrolled and randomized to treatment with either the Trevo Retriever (N=88) or the Merci Retriever (N=90). Key inclusion criteria were: patients with a large-vessel occlusion who failed or were ineligible for intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA) and who could be treated within 8 hours of stroke symptom onset; age 18-85; 8 ≤ NIHSS ≤ 29; and angiographic confirmation of a persistent large vessel occlusion in the internal carotid, middle cerebral (M1 and/or M2 segments), basilar and/or vertebral arteries. Key exclusion criteria were: stenosis in a proximal vessel that requires treatment or that prevents access to the thrombus with the assigned study device.

The primary effectiveness endpoint was revascularization defined as at least TICI 2 flow after use of the assigned device, as measured by a Core Lab. Subjects with a baseline TICI 2a by Core Lab and subjects in whom the device was never attempted were excluded from the analyses shown in the table below.

The primary safety endpoint was incidence of procedure-related serious adverse events (PRSAEs) through 24 hours post procedure defined as the following: vascular perforation or intramural arterial dissection, symptomatic ICH, embolization to a previously uninvolvled territory, access site complication requiring surgical repair or blood transfusion, mortality within 24 hours, device failure (in-vivo breakage), or any other complications judged by the Clinical Events Committee to be related to the procedure.

TREVO 2 Study Endpoints

(Patients with Baseline TICI 0 or 1, Study Device Attempted)

Endpoint	Trevo N=79 pts	Merci N=81 pts	Difference [95% CI] ^a	p-value
Primary Effectiveness Endpoint				
Post-Device Revascularization Success (TICI ≥ 2a)				
<i>Any Adjunctive Therapy Use Considered Treatment Failure</i> [95% Conf. Interval] ^a	79.7% (63/79) [69.2%, 88.0%]	49.4% (40/81) [38.1%, 60.7%]	30.4% [15.0%, 44.1%]	<0.0001 ^c
Post-Device Revascularization Success (TICI ≥ 2a)				
<i>Any IA Lytic use Considered Treatment Failure</i> [95% Conf. Interval] ^a	87.3% (69/79) [78.0%, 93.8%]	58.0% (47/81) [46.5%, 68.9%]	29.3% [15.0%, 42.4%]	<0.0001 ^d
Primary Safety Endpoint				
Composite Events	13.9% (11/79)	23.5% (19/81)	-9.5% [-22.1%, 2.8%]	0.1567 ^e
[95% Conf. Interval] ^a	[7.2%, 23.6%]	[14.8%, 34.2%]		
Vessel Perforation	0.0% (0/79)	9.9% (8/81)	-9.9% [-18.5%, -3.9%]	
Intramural Arterial Dissection	0.0% (0/79)	1.2% (1/81)	-1.2% [-6.7%, 3.5%]	
Symptomatic ICH	5.1% (4/79)	9.9% (8/81)	-4.8% [-14.1%, 3.8%]	
Embolization to Previously Uninvolved Territory	7.6% (6/79)	4.9% (4/81)	2.7% [-5.6%, 11.4%]	
Access Site Complication Requiring Surgical Repair or Blood Transfusion	1.3% (1/79)	0.0% (0/81)	1.3% [-3.3%, 6.9%]	
Mortality within 24 hrs	1.3% (1/79)	0.0% (0/81)	1.3% [-3.3%, 6.9%]	
In-vivo Device Failure	0.0% (0/79)	0.0% (0/81)	0.0% [-4.6%, 4.6%]	
Other PR-SAE	0.0% (0/79)	0.0% (0/81)	0.0% [-4.6%, 4.6%]	
mRS 0-2 at 90 days	38.2% (29/76)	17.9% (14/78)	20.2% [6.4%, 34.1%]	0.0068 ^e

a: Exact Clopper Pearson confidence intervals on individual proportions; b: Exact confidence intervals on differences in proportions computed with StatXact Version 8; c: Non-inferiority hypothesis using Blackwelder's method with non-inferiority margin of 10%; d: One-sided Fisher's exact test of superiority; e: Two-sided Fisher's exact test.

WARRANTY

Stryker Neurovascular warrants that reasonable care has been used in the design and manufacture of this instrument. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties not expressly set forth herein, whether express or implied by operation of law or otherwise, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Handling, storage, cleaning and sterilization of this instrument as well as other factors relating to the patient, diagnosis, treatment, surgical procedures and other matters beyond Stryker Neurovascular's control directly affect the instrument and the results obtained from its use. Stryker Neurovascular's obligation under this warranty is limited to the repair or replacement of this instrument and Stryker Neurovascular shall not be liable for any incidental or consequential loss, damage or expense directly or indirectly arising from the use of this instrument. Stryker Neurovascular neither assumes, nor authorizes any other person to assume for it, any other or additional liability or responsibility in connection with this instrument. Stryker Neurovascular assumes no liability with respect to instruments reused, reprocessed or resterilized and makes no warranties, express or implied, including but not limited to merchantability or fitness for a particular purpose, with respect to such instruments.

Extractor Trevo®

Rx ONLY

Precaución: las leyes federales de los Estados Unidos sólo permiten la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa.

ADVERTENCIA

El contenido se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno (OE). No usar si la barrera estéril está dañada. Si se encuentran daños, llamar al representante de Stryker Neurovascular.

Para un solo uso. No reutilizar, reprocesar o reestérilizar. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden comprometer la integridad estructural del dispositivo y/o causar su fallo, lo que a su vez puede resultar en lesiones al paciente, enfermedad o la muerte. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden también crear el riesgo de contaminación del dispositivo y/o causar infección o infección cruzada al paciente, que incluye, entre otros, la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede causar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente.

Después de su uso, desechar el producto y su envase de acuerdo a las normas del hospital, administrativas y/o de las autoridades locales.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El extractor consta de una guía núcleo flexible y conificada con una sección moldeada en el extremo distal. Los marcadores de platino, situados en el extremo distal, permiten la visualización fluoroscópica. Además, la sección moldeada también es radiopaca. Las dimensiones del extractor se indican en la etiqueta del producto. El extractor posee un revestimiento hidrofílico para reducir la fricción durante el uso. El extractor presenta un marcador de cuero que indica la proximidad de su punta con respecto a la del microcatéter. El dispositivo de torsión suministrado con el extractor facilita la manipulación. El dispositivo de torsión se utiliza para fijar la guía núcleo al microcatéter durante la intervención. Al fijar el dispositivo de torsión a la guía, el microcatéter y el extractor pueden replegarse como un sistema durante la extracción de coágulos. Se suministra una herramienta de inserción para introducir el extractor en los microcatéteres. La herramienta de inserción consiste en una vaina que trae el extractor precargado. Una vez que la mitad del extractor esté insertada en el microcatéter, se retira la herramienta de inserción. El extractor posee un extremo proximal modificado que permite acoplar la extensión de la guía DOC de Abbott Vascular (REF. 22260). Al acoplar la extensión de la guía al extractor, se facilita la extracción o el cambio de un catéter mientras se mantiene el extractor en el interior de la anatomía. Al finalizar el cambio, es posible desacoplar la extensión.

Información para el usuario

El extractor Trevo solo debe ser utilizado por médicos debidamente formados para efectuar intervenciones quirúrgicas endovasculares.

Contenido

Un (1) extractor Trevo

Un (1) dispositivo de torsión

Un (1) dispositivo introductor

Compatibilidad

Tamaño del extractor	Microcatéter Trevo Pro14	Microcatéter Trevo Pro18	Microcatéteres Excelsior® XT-27® (150 cm x 6 cm, rectos, REF. XT275081)	Diámetro vascular interno mínimo recomendado (mm)
Trevo XP ProVue 3 x 20 mm	✓	✓		2,5
Trevo XP ProVue 4 x 20 mm		✓		
Trevo ProVue 4 x 20 mm		✓		
Trevo XP ProVue 4 x 30 mm		✓	✓	
Trevo XP ProVue 6 x 25 mm			✓	

No se ha establecido la compatibilidad del extractor con otros microcatéteres. El rendimiento del extractor puede verse alterado si se utiliza un microcatéter distinto.

Los catéteres guía con balón (como el catéter Merci® o el catéter FlowGate®) se recomiendan para intervenciones de extracción de trombos.

El extractor es compatible con la válvula hemostática giratoria de Boston Scientific (REF. 421242).

El extractor es compatible con la extensión de la guía DOC de Abbott Vascular (REF. 22260).

USO INDICADO / INDICACIONES DE USO

1. El extractor Trevo está pensado para el restablecimiento del flujo sanguíneo en la neurovasculatura a través de la extracción de trombos en el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo, para reducir la discapacidad en pacientes con circulación anterior proximal persistente, oclusión de grandes vasos e infartos de n úcleo más pequeño que se hayan tratado primero con activador tisular del plasminógeno intravenoso (tPA IV). La terapia endovascular con este dispositivo debe iniciarse en un plazo de 6 horas desde la aparición de los síntomas.
2. El extractor Trevo está indicado para restablecer la circulación sanguínea en la neurovasculatura mediante la extracción de trombos en pacientes afectados por un accidente cerebrovascular isquémico agudo, en un plazo de 8 horas desde la aparición de los síntomas. Los pacientes a los que no se les puede administrar un activador tisular del plasminógeno intravenoso (tPA IV) o que no responden al tPA IV son candidatos para este tratamiento.
3. El extractor Trevo está pensado para el restablecimiento del flujo sanguíneo en la neurovasculatura a través de la extracción de trombos en el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico agudo, para reducir la discapacidad en pacientes con circulación anterior proximal persistente, oclusión de la arteria carótida interna (ACI) o de los segmentos M1 de la arteria cerebral media (ACM) con infartos de n úcleo más pequeño (0-50 cc para edades <80 años, 0-20 cc para edades ≥80 años). La terapia endovascular con el dispositivo debe iniciarse en un plazo de 6 a 24 horas desde la última vez que se vio sano al paciente, en pacientes que no puedan tratarse con activador tisular del plasminógeno intravenoso (tPA IV) o que no respondan al tPA IV.

CONTRAINDICACIONES

No se conoce ninguna.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA INDICACIÓN 1

- La seguridad y la eficacia del extractor Trevo en la reducción de la discapacidad no se ha determinado en pacientes con infartos de n úcleo grande (es decir, ASPECTS ≤ 7). Es posible que aumenten los riesgos, como la hemorragia intracerebral, en estos pacientes.
- La seguridad y la eficacia del extractor Trevo en la reducción de la discapacidad no se ha determinado ni evaluado en pacientes cuyas oclusiones se produzcan en la circulación posterior (por ej., en las arterias vertebrales o basilares) o que presenten oclusiones más distales en la circulación anterior.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA INDICACIÓN 2

- Para reducir el riesgo de que se produzcan daños en los vasos, debe tenerse la precaución de adaptar el tamaño del extractor al diámetro del vaso en el lugar en el que se pretende desplegarlo.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA INDICACIÓN 3

- La seguridad y la eficacia del extractor Trevo en la reducción de la discapacidad no se ha determinado en pacientes con infartos de n úcleo grande (es decir, ASPECTS ≤ 7). Es posible que aumenten los riesgos, como la hemorragia intracerebral, en estos pacientes.
- La seguridad y la eficacia del extractor Trevo en la reducción de la discapacidad no se ha determinado ni evaluado en pacientes cuyas oclusiones se produzcan en la circulación posterior (por ej., en las arterias vertebrales o basilares) o que presenten oclusiones más distales en la circulación anterior.
- Los usuarios deben comprobar las técnicas de análisis del software de obtención de imágenes para garantizar que los resultados son sólidos y consistentes para evaluar el tamaño del n úcleo del infarto.

ADVERTENCIAS GENERALES APLICABLES A TODAS LAS INDICACIONES

- La administración de tPA IV debe producirse en el intervalo aprobado por la FDA (en un plazo de 3 horas desde la aparición de los síntomas del accidente).
- A fin de reducir el riesgo de que se produzcan daños vasculares, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - No ejecute más de seis (6) intentos de extracción en el mismo vaso con dispositivos extractores.
 - Conserva la posición del extractor en el vaso al extraer o cambiar el microcatéter.
- A fin de reducir el riesgo de que se produzcan acodamientos o fracturas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - Inmediatamente después de retirar el extractor de la vaina, coloque el marcador de la punta del microcatéter en la zona proximal con respecto a la sección moldeada. Durante la manipulación y retirada, mantenga la punta del microcatéter en la zona proximal con respecto a la sección moldeada del extractor.
 - No rote ni doble el extractor.
 - Tenga cuidado al pasar el extractor por arterias con stents.
- El extractor es un instrumento delicado y debe manipularse con cuidado. Antes del uso y siempre que sea posible durante la intervención, inspeccione el dispositivo atentamente para detectar la presencia de daños. No utilice ningún dispositivo que pueda presentar indicios de daños. Los dispositivos dañados pueden no funcionar correctamente y causar complicaciones.

- No haga avanzar el extractor ni lo retire si nota resistencia o vasospasmos significativos. Al mover o girar el dispositivo cuando se detecta resistencia o vasospasmos significativos, se pueden producir daños al vaso o al propio dispositivo. Evalúe la causa de la resistencia mediante fluoroscopía y, si es necesario, vuelva a introducir el dispositivo en la vaina para retirarlo.
- Si el extractor ofrece resistencia al retirarlo del vaso, no lo gire. Haga avanzar el microcatéter distalmente, tire con suavidad del extractor hacia el interior del microcatéter y retire ambos en conjunto. Si encuentra resistencia indebida al retirar el extractor hacia el interior del microcatéter, considere ampliar el extractor mediante la extensión de la guía DOC de Abbott Vascular (REF. 22260) de manera que sea posible cambiar el microcatéter por uno de mayor diámetro, como el catéter DAC®. Retire el extractor con suavidad hacia el interior del catéter de mayor tamaño.
- Administre medicación anticoagulante y antipláquetaria de acuerdo con las directrices de la institución.
- Los usuarios deben tomar todas las medidas de precaución necesarias para limitar la exposición a rayos X de los pacientes y ellos mismos mediante el uso de protecciones suficientes, la reducción de los tiempos de fluoroscopia y la modificación de los factores técnicos de radiografía siempre que sea posible.

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar oscuro, seco y fresco.
- No usar si los envases están abiertos o dañados.
- Usar antes de la fecha de caducidad.
- La exposición a temperaturas superiores a los 54 °C (130 °F) puede dañar el dispositivo y los accesorios. No debe esterilizarse en autoclave.
- No exponer el extractor a disolventes.
- Utilizar el extractor en conjunto con la visualización fluoroscópica y los agentes anticoagulantes correspondientes.
- Para evitar la formación de trombos y la formación de cristales debido al medio de contraste, mantener la infusión constante de una solución de irrigación adecuada entre el catéter guía y el microcatéter, y entre este y el extractor o la guía.
- No acoplar ningún dispositivo de torsión al extremo proximal moldeado del extractor compatible con DOC. Es posible que se produzcan daños y no se pueda acoplar la extensión de la guía DOC.

EPISODIOS ADVERSOS

Los médicos que no estén familiarizados con las complicaciones que pueden aparecer durante o después de la intervención no deben realizar procedimientos que requieran la introducción percutánea del catéter. Entre las posibles complicaciones, cabe citar las siguientes:

- embolia gaseosa
- hematoma o hemorragia en el lugar de la punción
- infección
- embolización distal
- dolor y cefalea
- espasmo vascular
- trombosis
- disección
- perforación
- émbolos
- oclusión aguda
- isquemia
- hemorragia intracraneal
- formación de seudoaneurismas
- déficits neurológicos, como el accidente cerebrovascular
- fallecimiento

El uso del dispositivo exige la utilización de fluoroscopia, por lo que el personal médico y los pacientes pueden sufrir problemas derivados de la exposición a rayos X. Entre las posibles complicaciones, cabe citar las siguientes:

- alopecia
- quemaduras de diversa gravedad, desde enrojecimiento hasta úlceras
- cataratas
- neoplasia con retraso en diagnóstico

Notificación de episodios adversos

Informe inmediatamente al representante de Stryker Neurovascular si un dispositivo no funciona correctamente o si se experimentan o se sospechan complicaciones o lesiones en un paciente. Haga todo lo posible por conservar cualquier dispositivo sospechoso, sus componentes asociados y su envase, a fin de devolverlos a Stryker Neurovascular.

PRESENTACIÓN

Los productos de Stryker Neurovascular son estériles y apirógenos, y se suministran en un envase cerrado diseñado para mantener la esterilidad, a menos que se haya abierto o dañado la bolsa principal del producto. No utilizar si el envase está abierto o dañado.

No utilizar si la etiqueta está incompleta o ilegible.

Manipulación y almacenamiento

Almacenar en un lugar oscuro, seco y fresco.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Procedimiento recomendado para la preparación

1. Irrigue el aro del envase del extractor con solución salina. Hidrate durante un mínimo de 2 minutos antes de retirar el extractor del aro. Mantenga el extractor hidratado.
2. Prepare y coloque el catéter guía con balón o el catéter guía en la arteria carótida interna, la arteria carótida común o la arteria subclavia como se indica en la etiqueta del catéter.
3. Conecte la válvula hemostática giratoria al conector del microcatéter.
4. Mediante técnicas de cateterización convencionales, coloque el microcatéter en el vaso en tratamiento con una guía neurovascular estándar. Si la anatomía lo permite, coloque la punta del microcatéter en la zona distal con respecto al trombo.
5. Retire la guía del microcatéter. Inyecte el medio de contraste a través del microcatéter para visualizar la vasculatura distal. Irrigue el microcatéter.
6. Retire en conjunto la herramienta de inserción y el extractor precargado del aro del envase. No permita que el extractor salga de la punta de la herramienta de inserción o se retraje más hacia el interior de dicha herramienta.
7. **Importante:** Introduzca la herramienta de inserción hasta la mitad en la válvula hemostática giratoria y utilice una jeringa o una línea de infusión para irrigar dicha herramienta hasta que la solución salina salga por el extremo proximal de la misma. Si no se irriga correctamente la herramienta de inserción, es posible que se dificulte el avance del extractor a través de la misma.
8. Coloque la herramienta de inserción en el conector del microcatéter y cierre la válvula hemostática giratoria de manera firme para mantener la posición de la herramienta.
9. Haga avanzar el extractor hasta que la mitad se encuentre insertada en el microcatéter. Retire la herramienta de inserción.

Procedimiento de extracción recomendado

1. Haga avanzar el extractor hasta que la punta distal se alinee con la punta distal del microcatéter.

Nota: La siguiente tabla describe el lugar en el que se ubica la punta del extractor (el extremo distal del extractor) con respecto a la punta del microcatéter (el extremo distal del microcatéter) cuando:

- a. el extremo distal del marcador del cuerpo del extractor alcance el conector del microcatéter o
- b. el extremo proximal del marcador del cuerpo del extractor alcance el extremo proximal de la válvula hemostática giratoria.

Tabla de control del extremo distal

Trevo® ProVue 4 x 20 mm Trevo XP 4 x 20 mm Trevo XP 6 x 25 mm	• A 8 cm como máximo de la salida de la punta del microcatéter
Trevo XP 3 x 20 mm	• A 15 cm como máximo de la salida de la punta del microcatéter
Trevo XP 4 x 30 mm	<p>Si se usa con Trevo Pro 18 MC (90238):</p> <p>• A 8 cm como máximo de la salida de la punta del microcatéter</p> <p>Si se usa con Excelsior® XT-27® MC (XT275081):</p> <p>• A 15 cm como máximo de la salida de la punta del microcatéter</p>

2. Retraiga el microcatéter mientras aplica en el extractor fuerza hacia delante con suavidad a fin de desplegar la sección moldeada del mismo en el coágulo. Coloque el marcador de la punta del microcatéter en la zona proximal con respecto a la sección moldeada del extractor.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de que se produzcan acodamientos o fracturas durante la manipulación y retirada, mantenga la punta del microcatéter en la zona proximal con respecto a la sección moldeada del extractor.

3. Despues de desplegar el extractor, visualice la expansión del soporte y espere el tiempo suficiente para que el coágulo se integre en el extractor (aproximadamente 5 minutos).
4. Si utiliza un catéter guía con balón, inflé el balón para ocluir el vaso según se indica en la etiqueta de dicho catéter.
5. Coloque y bloquee el dispositivo de torsión en el extractor mediante el conector del microcatéter.
6. Retire lentamente el extractor y el microcatéter en conjunto hasta la punta del catéter guía con balón mientras aspira este último mediante una jeringa de 60 mL.

7. Aspire vigorosamente el catéter guía con balón con una jeringa de 60 mL y retire el extractor y el microcatéter hacia el interior del catéter guía. Siga aspirando hasta que el extractor y el microcatéter prácticamente se hayan retirado del catéter guía.

Nota: Si retirar el catéter guía con balón o el catéter guía resultase difícil, desinflé el balón del catéter y retire simultáneamente y en conjunto el catéter guía, el microcatéter y el extractor a través de la vaina. Retire la vaina si es necesario.

8. Desinflé el balón del catéter guía con balón.
9. Desconecte el catéter guía con balón rotando la válvula hemostática y retire completamente y en conjunto el extractor, el microcatéter y la válvula hemostática giratoria del catéter guía.
10. Acople una jeringa de 60 mL al conector del catéter guía con balón y aspire.
11. Limpie el dispositivo con solución salina. Examine el extractor para asegurarse de que no se han producido daños. No vuelva a utilizar el extractor si la guía núcleo, la sección moldeada o la espiral de platino presentan un aspecto diferente al que tenían cuando se retiraron del envase por primera vez. Si el extractor no está dañado, es posible utilizarlo en un máximo de tres (3) intentos de extracción. Por intento de extracción se entiende un (1) avance y un ciclo de retirada completo.

Procedimiento recomendado de cambio del catéter

1. Siga las instrucciones de uso suministradas con la extensión de la guía DOC de Abbott Vascular, excepto que debe tratar el extractor como si fuese la guía.

ESTUDIOS CLÍNICOS

Información sobre seguridad y eficacia

Estudio DAWN™ como respaldo de la indicación 3

El estudio DAWN (Evaluación de la toma de imágenes ponderadas por difusión [DWI] y de la tomografía computarizada de perfusión [TCP] con discordancia clínica en la priorización de accidentes cerebrovasculares de tiempo de inicio desconocido y de aparición tardía durante neurointervenciones) fue un estudio prospectivo, aleatorizado, multicentro y controlado para evaluar la hipótesis de que combinando la trombectomía con el extractor Trevo® y la gestión médica se obtienen mejores resultados clínicos a los 90 días que si solo se aplica la gestión médica en pacientes adecuadamente seleccionados y afectados por un ataque isquémico agudo cuando el tratamiento se inicia entre 6 y 24 horas desde la última vez que se vio sano al paciente. Participó un total de 206 pacientes en 26 centros de investigación: 107 pacientes (51,9 %) se aleatorizaron e incluyeron en el grupo de tratamiento y 99 pacientes (48,1 %) se aleatorizaron e incluyeron en el grupo de control. Los valores promedio de la escala de Rankin modificada ponderada por utilidad (UW-mRS) a 90 días fueron de 5,5 en el grupo de tratamiento frente a 3,4 en el grupo de control; la diferencia del grupo ajustado por núcleo de infarto en el grado de discapacidad ponderado por utilidad fue de 2,0 (intervalo de credibilidad bayesiana del 95 %, 1,1 a 3,0, probabilidad a posteriori de superioridad > 0,9999). El tratamiento con el extractor Trevo condujo a índices más elevados de independencia funcional (mRS de 0-2) a 90 días, 48,6 % frente a 13,1 %; la diferencia del grupo ajustado por núcleo de infarto fue de 32,8 % (intervalo de credibilidad del 95 %, 21,1 a 44,1 %, probabilidad a posterior de superioridad > 0,9999). El índice de hemorragia intracranal sintomática a las 24 horas fue superior en los pacientes sometidos a terapia endovascular. Es necesario informar a los pacientes o sus representantes legalmente autorizados acerca de dicho riesgo durante el proceso de toma de decisiones para el tratamiento. El nivel de incertidumbre es todavía mayor en los resultados mostrados para los sujetos pasadas 18 a 24 horas desde la última vez que se vio sano al paciente.

Criterios de inclusión fundamentales

Accidente cerebrovascular isquémico con oclusión confirmada de la ACI y/o la M1, cuyo tratamiento con tPA IV esté contraindicado o no resultase satisfactorio, tratamiento en un plazo de 6 a 24 horas desde el inicio de los síntomas, NIHSS inicial ≥10, consentimiento informado autorizado y edad superior a 18 años. En pacientes con menos de 80 años, la puntuación del accidente igual o superior a 10 debe asociarse a un volumen de núcleo inferior a 51 mL. En pacientes de 80 años o más, la puntuación del accidente debe ser superior a 10 y el volumen inferior a 21 mL. Discordancia clínica entre núcleos, definida como la falta de coincidencia entre el volumen inicial del infarto (o núcleo), observado a través de TAC o IRM, y la extensión del tejido cerebral total que esté en peligro. Volumen del infarto evaluado con IRM ponderada por difusión o TAC de perfusión, y medida con uno de los paquetes de software automatizado que se comercializan (RAPID, IschemiaView).

Criterios de exclusión fundamentales

Mejora rápida del estado neurológico hasta alcanzar un valor NIHSS <10 o existencia de pruebas de recanalización de los vasos previa a la aleatorización; presión arterial >185/110 mmHg; prueba de laboratorio de desequilibrio hidroelectrolítico (es decir, sodio <130 mmol/L, potasio <3 mEq/L o >6 mEq/L); prueba de laboratorio de insuficiencia renal (es decir, creatinina sérica >3,0 mg/dL (264 µmol/L); prueba de laboratorio de anomalías en la coagulación (es decir, recuento de plaquetas <50.000/µL, TTPa > 3 veces lo normal o INN > 3,0, si se ha suministrado inhibidor del factor Xa entre 24 y 48 atrás, el valor de TTP debe ser normal); prueba de laboratorio de hemorragia (es decir, hemoglobina <7 mmol/L).

El criterio de valoración principal fue la discapacidad a 90 días evaluada mediante la escala de Rankin modificada (mRS).

El segundo objetivo es aportar hechos indicativos de que la reperfusión endovascular con el extractor Trevo está asociada a una reducción significativa del tamaño medio del infarto respecto al grupo de control 24 (-6/+24) horas después de la aleatorización. Entre los criterios de valoración secundarios se encuentran la proporción de pacientes con buenos resultados funcionales a 90 días (mRS de 0-2); la proporción de sujetos con un descenso de la puntuación de la NIHSS ≥ 10 puntos desde el inicio o una puntuación de NIHSS de 0 o 1; la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en la mortalidad por todas las causas; la diferencia en el tamaño del infarto final medio a las 24 horas; la diferencia en los índices de revascularización a las 24 horas y el índice de reperfusión de TICI > 2b.

Los resultados de seguridad incluyen la incidencia de la mortalidad relacionada con el accidente cerebrovascular a los 90 días, la incidencia de los HICS, el deterioro neurológico, y los episodios adversos graves relacionados con la intervención y los relacionados con el dispositivo.

Población IDT según la escala de Rankin modificada a 90 días

Escala de Rankin modificada (mRS)	Grupo de tratamiento N=107	Grupo de control N=99
0 - Sin síntomas / Ponderación por utilidad (UW) = 10	9,3 % (10/107)	4,0 % (4/99)
1 - Sin discapacidad / UW = 9,1	22,4 % (24/107)	5,1 % (5/99)
2 - Discapacidad ligera / UW = 7,6	16,8 % (18/107)	4,0 % (4/99)
3 - Discapacidad moderada / UW = 6,5	13,1 % (14/107)	16,2 % (16/99)
4 - Discapacidad de gravedad moderada / UW = 3,3	13,1 % (14/107)	34,3 % (34/99)
5 - Discapacidad grave / UW = 0	6,5 % (7/107)	18,2 % (18/99)
6 - Muerte / UW = 0	18,7 % (20/107)	18,2 % (18/99)
mRS a los 90 días [0-2]	48,6 % (52/107)	13,1 % (13/99)
mRS ponderada a los 90 días*		
Promedio ± desviación típica (N)	5,5 ± 3,8 (107)	3,4 ± 3,2 (99)
Mediana (Q1, Q3)	6,5 (0,0, 9,1)	3,3 (0,0, 6,5)
Intervalo (mín., máx.)	(0,0, 10,0)	(0,0, 10,0)
[95 % interv. confianza] ^b	[4,8, 6,3]	[2,7, 4,0]

^aPor aproximación normal

^bLa escala mRS = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} recibió un valor numérico correspondiente = (10, 9, 1, 7, 6, 6, 5, 3, 0, 0), que representa su utilidad clínica

Resultados coprimarios en la población IDT

Resultados	Acción N=107	PROACT II N=99	Diferencia absoluta promedio (IC 95 %)	Beneficio promedio a posteriori, ajustado por núcleo (intervalo de credibilidad del 95 %)*	Probabilidad de superioridad
Promedio de la escala de Rankin modificada ponderada por utilidad (DT)	5,5 (3,8)	3,4 (3,1)	2,1 (1,2, 3,1)	2,0 (1,1, 3,0)	> 0,9999 ^a
Independencia funcional (mRS 0-2)	48,6 %	13,1 %	35,5 % (23,9 %, 47,0 %)	32,8 % (21,1 %, 44,1 %)	> 0,9999

*Estimación hecha según el modelo lineal generalizado bayesiano ajustado para el núcleo de infarto

^aLa probabilidad total del beneficio de un dispositivo será la media de las probabilidades de beneficio correspondiente a los conjuntos de datos atribuidos, ponderada por la atribución de probabilidades de dichos conjuntos de datos. Esta probabilidad es de 0,9999986.

El segundo criterio de valoración de la eficacia secundaria fue el descenso de la puntuación de la NIHSS ≥ 10 puntos desde el inicio o una puntuación de NIHSS de 0 o 1.

Respuesta neurológica temprana en el día 5 a 7/alta hospitalaria

Resultados	Acción N=107	PROACT II N=99	Diferencia absoluta promedio (IC de 95 %)	Coeficiente de riesgo (IC de 95 %)	Valor de p
Respuesta temprana†	47,7 %	19,2 %	28,5 % (16,2 %, 40,7 %)	2,5 (1,6, 3,9)	< 0,001

^aDefinida como un descenso de la puntuación de la NIHSS ≥ 10 puntos desde el inicio o una puntuación de la NIHSS de 0 o 1 el día 5 a 7, o la alta hospitalaria (lo que ocurra primero). El valor de p no se ajustó para la multiplicidad.

El resultado secundario de la eficacia fue el índice de revascularización a las 24 horas, definida como la presencia de recanalización parcial o completa.

Índices de revascularización a las 24 horas

	Total N=206	Grupo de tratamiento N=107	Grupo de control N=99	Diferencia [IC del 95 %] ¹	Valor de p
Diferencia en los índices de revascularización a las 24 (-6/+24) horas de la aleatorización	58,7 % (121/206)	76,6 % (82/107)	38,4 % (38/99)	40,2 % [27,1 %, 51,5 %]	< 0,0001 ^a

La revascularización a las 24 horas se definió como la presencia de recanalización parcial o completa.

a. Prueba t. El valor de p no se ajustó para la multiplicidad.

El criterio de valoración de la seguridad principal fue la incidencia de la mortalidad relacionada con el accidente cerebrovascular a los 90 días. Los resultados secundarios sobre la seguridad tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de control son la incidencia de HICS, según la definición de ECASS, en un plazo de 24 (-6/+24) horas tras la aleatorización (hora cero), y la incidencia del deterioro neurológico desde el valor de la escala NIHSS inicial hasta el día 5 a 7, o el alta hospitalaria (lo que ocurra primero) tras la aleatorización. El deterioro neurológico se definió como un aumento de ≥ 4 puntos en la escala NIHSS respecto a la puntuación inicial.

Mortalidad relacionada con el accidente cerebrovascular a los 90 días

	Total N=206	Grupo de tratamiento N=107	Grupo de control N=99	Diferencia [IC del 95 %] ¹	Valor de p
Incidencia de toda la mortalidad relacionada con el accidente cerebrovascular a los 90 días.	17,0 % (35/206)	15,9 % (17/107)	18,2 % (18/99)	-2,3 % [-12,6 %, 8,0 %]	0,7126 ^a

¹Por aproximación normal

a. Prueba t. El valor de p no se ajustó para la multiplicidad.

El resultado de seguridad secundario fue la incidencia de la hemorragia intracraneal sintomática (HICS), según la definición del estudio ECASS III, dentro de las 24 (-6/+24) horas siguientes a la aleatorización (hora cero).

Incidencia de HICS según la resolución del Comité de episodios clínicos (CEC).

	Total N=206	Grupo de tratamiento N=107	Grupo de control N=99	Diferencia [IC del 95 %] ¹	Valor de p
HICS a las 24 (-6/+24) horas después de la aleatorización	4,4 % (9/206)	5,6 % (6/107)	3,0 % (3/99)	2,6 % [-2,9 %, 8,1 %]	0,5011 ^a

¹Por aproximación normal

a. Prueba exacta de Fisher. El valor de p no se ajustó para la multiplicidad.

La incidencia del deterioro neurológico se definió como un aumento de ≥ 4 puntos en la escala NIHSS desde el inicio hasta el día 5 a 7 o el día del alta (lo que ocurra primero) después de la aleatorización (hora cero).

Incidencia del deterioro neurológico según la resolución del Comité de episodios clínicos (CEC).

	Total N=206	Grupo de tratamiento N=107	Grupo de control N=99	Diferencia [IC del 95 %] ¹	Valor de p
Incidencia del deterioro neurológico entre el valor inicial y el día 5 a 7/alta hospitalaria	19,9 % (41/206)	14,0 % (15/107)	26,3 % (26/99)	-12,2 % [-23,1 %, -1,4 %]	0,0358 ^a

¹Por aproximación normal

a. Prueba t. El valor de p no se ajustó para la multiplicidad.

Independencia funcional (valor de mRS de 0-2 a los 90 días) subagrupados por tiempo


Intervalos de TLSW	Tratamiento	Control	Diferencia	Valor de p
6-9 h	50,0 % (9/18)	14,3 % (3/21)	35,7 % [8,2 %, 63,2 %]	0,0346 ^a
9-12 h	58,1 % (18/31)	26,1 % (6/24)	33,1 % [8,5 %, 57,6 %]	0,0273 ^a
6-12 h total	55,1 % (27/49)	20,0 % (9/45)	35,1 % [16,9 %, 53,3 %]	0,0006^a
12-15 h	37,5 % (6/16)	9,1 % (2/22)	28,4 % [1,8 %, 55,0 %]	0,0498 ^a
15-18 h	50,0 % (13/26)	5,3 % (1/19)	44,7 % [23,1 %, 66,4 %]	0,0025 ^a
18-21 h	36,4 % (4/11)	0,0 % (0/8)	36,4 % [7,9 %, 64,8 %]	0,1032 ^a
21-24 h	40,0 % (2/5)	20,0 % (1/5)	20,0 % [-35,4 %, 75,4 %]	1,0000 ^a
12-24 total*	43,1 % (25/58)	7,4 % (4/54)	35,7 % [21,2 %, 50,2 %]	< 0,0001^a

a. Prueba exacta de Fisher

*Nivel de incertidumbre todavía mayor en los resultados mostrados para los sujetos pasadas 18 a 24 horas desde la última vez que se vio sano al paciente.

El valor de p no se ajustó para la multiplicidad.

Independencia funcional (mRS de 0-2) en el tiempo transcurrido desde la última vez que se vio sano al paciente hasta la aleatorización

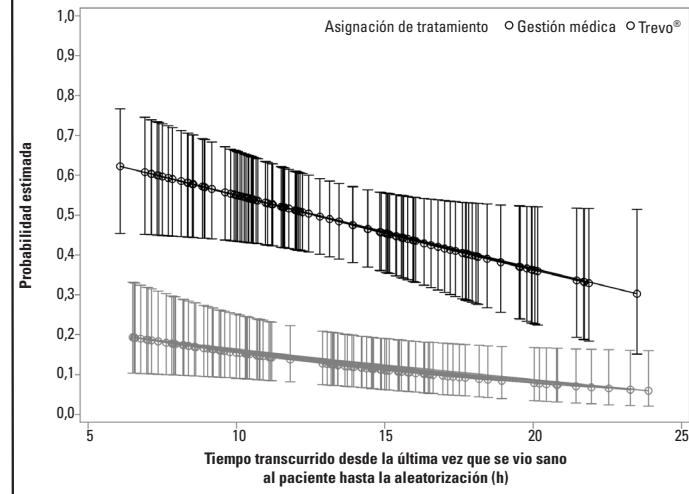

La siguiente tabla muestra un resumen de todos los episodios adversos graves y leves padecidos por todos los pacientes del grupo de control y el grupo de tratamiento según los grupos sistémicos (SOC, por sus siglas en inglés) del diccionario MedDRA.

MedDRA* Grupos sistémicos (SOC)	Grupo de tratamiento N=107					Grupo de control N=99						
	EAG	Pacientes con EAG	Sin EAG	Pacientes sin EAG	Total de EA	Pacientes con total de EA	EAG	Pacientes sin EAG	Sin EAG	Pacientes sin EAG	Total de EA	Pacientes con total de EA
Cualquier episodio adverso (EA)	65	41 (38,3 %)	476	102 (95,3 %)	541	103 (96,3 %)	83	47 (47,5 %)	473	91 (91,9 %)	556	91 (91,9 %)
Trastornos del sistema linfático y sanguíneo	0	0	11	10 (9,3 %)	11	10 (9,3 %)	1	1 (1,0 %)	8	8 (8,1 %)	9	8 (8,1 %)
Trastornos cardíacos	8	7 (6,5 %)	37	29 (27,1 %)	45	33 (30,8 %)	6	5 (5,1 %)	29	24 (24,2 %)	35	28 (28,3 %)
Trastornos endocrinos	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	0	0	0	0
Trastornos oculares	1	1 (0,9 %)	0	0	1	1 (0,9 %)	0	0	2	2 (2,0 %)	2	2 (2,0 %)
Trastornos gastrointestinales	7	6 (5,6 %)	42	30 (28,0 %)	49	34 (31,8 %)	12	11 (11,1 %)	38	28 (28,3 %)	50	34 (34,3 %)
Trastornos de carácter general y problemas en el lugar de la administración	0	0	22	18 (16,8 %)	22	18 (16,8 %)	0	0	17	15 (15,2 %)	17	15 (15,2 %)
Trastornos hepatobiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0 %)	1	1 (1,0 %)
Trastornos del sistema inmunitario	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0 %)	1	1 (1,0 %)
Infecciones e invasiones	6	6 (5,6 %)	46	34 (31,8 %)	52	38 (35,5 %)	7	7 (7,1 %)	54	41 (41,4 %)	61	43 (43,4 %)
Lesión, intoxicación y complicaciones derivadas de la intervención	2	2 (1,9 %)	8	7 (6,5 %)	10	9 (8,4 %)	2	2 (2,0 %)	8	6 (6,1 %)	10	7 (7,1 %)
Investigaciones	0	0	5	5 (4,7 %)	5	5 (4,7 %)	0	0	10	10 (10,1 %)	10	10 (10,1 %)
Trastornos metabólicos y nutricionales	0	0	76	47 (43,9 %)	76	47 (43,9 %)	0	0	62	34 (34,3 %)	62	34 (34,3 %)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	0	0	11	10 (9,3 %)	11	10 (9,3 %)	2	2 (2,0 %)	22	15 (15,2 %)	24	16 (16,2 %)
Neoplasias benignas, malignas y sin especificar	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	0	0	0	0
Trastornos del sistema nervioso	21	21 (19,6 %)	95	63 (58,9 %)	116	71 (66,4 %)	34	30 (30,3 %)	88	53 (53,5 %)	122	66 (66,7 %)
Trastornos psiquiátricos	1	1 (0,9 %)	26	24 (22,4 %)	27	24 (22,4 %)	2	2 (2,0 %)	30	27 (27,3 %)	32	28 (28,3 %)
Trastornos renales y urinarios	0	0	18	15 (14,0 %)	18	15 (14,0 %)	1	1 (1,0 %)	19	14 (14,1 %)	20	15 (15,2 %)
Trastornos de las mamas y el sistema reproductor	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	2	2 (2,0 %)	2	2 (2,0 %)
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	14	11 (10,3 %)	33	28 (26,2 %)	47	33 (30,8 %)	11	9 (9,1 %)	42	34 (34,3 %)	53	37 (37,4 %)
Trastornos cutáneos y del tejido subcutáneo	0	0	3	3 (2,8 %)	3	3 (2,8 %)	0	0	10	7 (7,1 %)	10	7 (7,1 %)
Intervenciones médicas y quirúrgicas	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	2	2 (1,9 %)	1	1 (1,0 %)	2	2 (2,0 %)	3	3 (3,0 %)
Trastornos vasculares	4	3 (2,8 %)	39	33 (30,8 %)	43	34 (31,8 %)	4	4 (4,0 %)	28	21 (21,2 %)	32	23 (23,2 %)

*Se empleó la versión 17.0 de MedDRA.

El estudio MR CLEAN como respaldo de la indicación 1

El estudio MR CLEAN consistió en un gran ensayo prospectivo, aleatorizado, abierto, controlado y realizado en varios centros en el que participaron todos los centros hospitalarios con práctica endovascular de los Países Bajos. Se comparó el tratamiento intraarterial con cuidados habituales (que podían incluir la administración intravenosa de tPA IV) con el tratamiento con cuidados habituales únicamente (grupo de control) en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo y oclusión arterial intracraneal proximal de la circulación anterior confirmada mediante diagnóstico por imagen del sistema vascular. En el estudio MR CLEAN, se aleatorizó a 500 pacientes (233 en el grupo de tratamiento ("IAT") y 267 en el grupo de control) en 16 centros médicos. Se usaron stents extraíbles (incluida la familia de productos del extractor Trevo®) en 190 de los 233 pacientes (81,5 %) asignados al grupo IAT, de los cuales 120/190 recibieron tratamiento intraarterial de primera línea con el extractor Trevo, y 104/120 recibieron tPA IV en un plazo de 3 horas desde el inicio de los síntomas, en comparación con todo el grupo de control de la gestión médica de MR CLEAN, de los cuales 224 de 249 se trataron con tPA IV de acuerdo con el etiquetado de la FDA. De los 120 pacientes que recibieron tratamiento intraarterial de primera línea con el extractor Trevo, 24 presentaban stents carotídeos concomitantes. Se excluyó a estos pacientes del siguiente resumen sobre la eficacia, por lo que la cohorte de eficacia principal fue de 96 pacientes tratados con el extractor Trevo. Los pacientes que fueron tratados con líquidos intravenosos o con cualquier otro dispositivo de trombectomía mecánica después del tratamiento con el extractor Trevo se consideraron fracasos en el siguiente resumen sobre la eficacia.

Criterios de inclusión fundamentales para MR CLEAN

Accidente cerebrovascular isquémico agudo con oclusión confirmada de ACI, M1, M2, A1 o A2, tratamiento en un plazo de 6 horas desde la aparición de los síntomas, una puntuación de NIHSS >2, exploración mediante TAC o IRM que descarte la hemorragia intracraneal, consentimiento informado otorgado y edad de 18 años o más.

Criterios de inclusión fundamentales para el subgrupo del extractor Trevo

Criterios de inclusión fundamentales adicionales para el análisis del subgrupo del extractor Trevo (cohorte de la FDA) a partir de MR CLEAN: tratamiento de primera línea con extractor Trevo y administración de tPA IV en un plazo de 3 horas desde la aparición de los síntomas.

Criterios de exclusión fundamentales para MR CLEAN

Presión arterial > 185/110 mmHg; glucemia < 2,7 o > 22,2 mmol/L; tratamiento intravenoso con terapia trombolítica en una dosis superior a 0,9 mg/kg de alteplasa o 90 mg; tratamiento intravenoso con terapia trombolítica a pesar de las contraindicaciones (es decir, cirugía mayor, hemorragia gastrointestinal o hemorragia del tracto urinario en las 2 semanas anteriores, o punción arterial en un lugar no compresible en los 7 días anteriores; infarto cerebral en la distribución de la arteria ocluida en cuestión en las anteriores 6 semanas; prueba de laboratorio de anomalías en la coagulación [es decir, recuento plaquetario < 40 x 10⁹/L, TTTPa > 50 s o INN > 3,0]).

El criterio principal de valoración de la eficacia fue demostrar que la terapia con el extractor Trevo más la gestión médica conduce a una independencia funcional superior (mRS < 3) a los 90 días, cuando se compara con la gestión médica solamente en pacientes que cumplen los requisitos y padecen un accidente cerebrovascular isquémico. De acuerdo con el análisis, el tratamiento con el extractor Trevo en el grupo IAT tuvo como resultado un efecto del tratamiento realmente significativo cuando se ajustó para los centros, el uso de tPA IV y el valor de NIHSS inicial.

Criterio principal de valoración de la eficacia

Variable	Coeficiente para las variables binarias	Coiciente de probabilidades [IC 95 %]	Valor de p
Extractor Trevo® sin implantación concomitante de stents carotídeos	Extractor Trevo frente a la gestión médica	1,88 [1,07, 3,29]	0,014 ¹
tPA IV	Sí frente a No	1,45 [0,60, 3,52]	0,4134 ²
NIHSS	>14 o ≤14	0,41 [0,24, 0,69]	0,0010 ²

¹Prueba t unilateral.²Prueba t bilateral.**Distribución de mRS a 90 días***

mRS	Trevo sin implantación concomitante de stents carotídeos (N=96)	Mr Clean/Control a 90 días (N=249)
0	4,2 % (4/96)	0,4 % (1/249)
1	8,3 % (8/96)	5,2 % (13/249)
2	17,7 % (17/96)	13,7 % (34/249)
3	15,6 % (15/96)	16,5 % (41/249)
4	32,3 % (31/96)	31,3 % (78/249)
5	7,3 % (7/96)	10,4 % (26/249)
6	14,6 % (14/96)	22,5 % (56/249)
mRS [0, <3] con el uso de cualquier lítico intravenoso se considera fallo de tratamiento*	29,2 % (28/96)	19,3 % (48/249)

¹Un paciente tratado con lítico intravenoso se contó como fallo.²Los pacientes de ambos grupos recibieron tPA IV en un plazo de 3 horas (81 pacientes de 96 en la cohorte del extractor Trevo y 224 pacientes de 249 en el grupo de gestión médica).

El análisis objetivo principal de la seguridad se definió como el índice de mortalidad por todas las causas en el grupo tratado con el extractor Trevo y gestión médica comparado con el índice de mortalidad por todas las causas en el grupo con gestión médica únicamente (grupo de control).

	Cohorte tratada con el extractor Trevo de la FDA % (x/n) (LCL, UCL) ¹	Gestión médica % (x/n) (LCL, UCL) ¹
Mortalidad a los 90 días	13,33 (16/120) (7,82, 20,75)	22,89 (57/249) (17,82, 28,62)

¹Intervalos de confianza exactos de Clopper-Pearson bilaterales del 95 %.

El primer criterio secundario de valoración de la eficacia fue el porcentaje de pacientes que no presentaban oclusión intracraneal evaluada mediante revisión consensuada de hasta tres lectores pasadas 24 horas. El criterio de valoración se evaluó con ATC o ARM mediante la escala de enfermedad arterial oclusiva.

	Trevo sin implantación concomitante de stents carotídeos % (x/N) (LCL, UCL) ²	Gestión médica % (x/N) (LCL, UCL) ²
Sin oclusión (24 horas)	77,5 % (62/80) (66,8, 86,1)	33,51 (65/194) (26,90, 40,62)

¹Se excluyeron del análisis los sujetos sin valoración mediante ATC o ARM en un plazo de 24 horas.²Intervalos de confianza exactos de Clopper-Pearson bilaterales del 95 %.

El segundo criterio secundario de valoración de la eficacia es el porcentaje de pacientes tratados con el extractor Trevo que alcanzaron la recanalización (TICI 2a o mejor). Este criterio de valoración también se evaluó a través de una revisión consensuada de un mínimo de tres lectores.

	Extractor Trevo sin implantación concomitante de stents carotídeos % (x/N) (LCL, UCL) ¹
Éxito de la revascularización (TICI ≥ 2a)	81,3 % (78/96) (72,0, 88,5)

¹Intervalos de confianza exactos de Clopper-Pearson bilaterales del 95 %.

El tercer criterio de valoración consistió en la diferencia existente en los resultados neurológicos evaluados según la NIHSS a las 24 horas y a los 5 a 7 días tras la aleatorización, comparando el grupo tratado con el extractor Trevo y gestión médica con el grupo de gestión médica solamente (grupo de control).

NIHSS	Extractor Trevo sin implantación concomitante de stents carotídeos Promedio ± DT (N) Mediana (min., máx.) (LCL, UCL) ²	Gestión médica Promedio ± DT (N) Mediana (min., máx.) (LCL, UCL) ²
NIHSS (24 horas)	14,23 ± 9,23 (96) 14,00 (1, 42) (12,36, 16,10)	16,19 ± 7,77 (240) 16 (0, 42) (15,20, 17,18)
NIHSS (5 a 7 días)³	13,02 ± 12,16 (94) 12,00 (0, 42) (10,53, 15,51)	15,76 ± 11,49 (237) 15 (0, 42) (14,29, 17,23)

¹Se excluyeron del análisis los sujetos sin valoración mediante NIHSS. A los pacientes que fallecieron antes del alta hospitalaria se les asignó un valor NIHSS de 42.²Límites de confianza bilaterales del 95 % por aproximación normal.

La siguiente tabla resume todos los episodios adversos que se manifestaron a lo largo de 90 días tras la aleatorización, para la cohorte de pacientes tratados con el extractor Trevo y mediante la categorización del estudio MR CLEAN. Para todos los análisis de seguridad, se incluyeron los pacientes expuestos al extractor Trevo con o sin stents carotídeos.

Clase de MR CLEAN	Cohorte tratada con el extractor Trevo de la FDA 120 pacientes con 189 episodios % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Cantidad de episodios	Gestión médica 249 pacientes con 331 episodios % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Cantidad de episodios
Accidente cerebrovascular isquémico	2,5 % (3/120) [0,5 %, 7,1 %] 3	0,8 % (2/249) [0,1 %, 2,9 %] 2
Hemorragia intracraneal sintomática	7,5 % (9/120) [3,5 %, 13,8 %] 9	6,8 % (17/249) [4,0 %, 10,7 %] 17
Hemorragia extracraneal	2,5 % (3/120) [0,5%, 7,1 %] 3	4,4 % (11/249) [2,2 %, 7,8 %] 11
Isquemia cardiaca	0	2,0 % (5/249) [0,7 %, 4,6 %] 5
Reacción alérgica	1,7 % (2/120) [0,2 %, 5,9 %] 2	0,4 % (1/249) [0,0 %, 2,2 %] 1
Neumonía	18,3 % (22/120) [11,9 %, 26,4 %] 24	19,3 % (48/249) [14,6 %, 24,7 %] 52
Otra infección	23,3 % (28/120) [16,1 %, 31,9 %] 34	13,7 % (34/249) [9,6 %, 18,6 %] 41
Otras complicaciones	47,5 % (57/120) [38,3 %, 56,8 %] 89	38,6 % (96/249) [32,5 %, 44,9 %] 154
Progresión del accidente cerebrovascular	20,8 % (25/120) [14,0 %, 29,2 %] 25	18,9 % (47/249) [14,2 %, 24,3 %] 48

¹Intervalos de confianza exactos de Clopper-Pearson bilaterales del 95 %.

La siguiente tabla resume todos los episodios adversos de MR CLEAN que se manifestaron a lo largo de 90 días tras la aleatorización, para la cohorte de la FDA mediante la codificación de MedDRA.

Episodios adversos de MR CLEAN codificados según la versión 18.0 de MedDRA para la cohorte de la FDA con una frecuencia superior al 1%

Término preferente de MedDRA	Cohorte tratada con Trevo® de la FDA (N=120) Pacientes con episodios (%)	Control (N=249) Pacientes con episodios (%)
Accidente cerebrovascular en evolución	19 (15,8 %)	41 (16,5 %)
Hemorragia intracraneal	13 (10,8 %)	20 (8,0 %)
Infección del tracto urinario	11 (9,2 %)	17 (6,8 %)
Fibrilación auricular	10 (8,3 %)	10 (4,0 %)
Pirexia	6 (5,0 %)	6 (2,4 %)
Descompensación neurológica	6 (5,0 %)	6 (2,4 %)
Neumonía por aspiración	5 (4,2 %)	8 (3,2 %)
Delirio	4 (3,3 %)	6 (2,4 %)
Inseto óseo	4 (3,3 %)	1 (0,4 %)
Insuficiencia cardiaca	3 (2,5 %)	7 (2,8 %)
Diarrea	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Urosepsis	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Caída	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Cefalea	3 (2,5 %)	1 (0,4 %)
Accidente cerebrovascular isquémico	3 (2,5 %)	1 (0,4 %)
Paro cardíaco	2 (1,7 %)	0
Hipersensibilidad	2 (1,7 %)	1 (0,4 %)
Infección por Clostridium difficile	2 (1,7 %)	0
Gota	2 (1,7 %)	3 (1,2 %)
Disección de la arteria carótida	2 (1,7 %)	0
Epilepsia	2 (1,7 %)	3 (1,2 %)
Depresión	2 (1,7 %)	4 (1,6 %)
Retención de orina	2 (1,7 %)	2 (0,8 %)
Embolia pulmonar	2 (1,7 %)	6 (2,4 %)
Hematoma	2 (1,7 %)	2 (0,8 %)
Anemia	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Bradicardia	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Convulsiones	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Insuficiencia respiratoria	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Inserción de tubo gastrointestinal	1 (0,8 %)	5 (2,0 %)
Hipotensión	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Flebitis	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Vasoespasmo	1 (0,8 %)	0
Arritmia	0	3 (1,2 %)
Isquemia de miocardio	0	3 (1,2 %)
Insuficiencia renal	0	3 (1,2 %)
Trombosis venosa profunda	0	3 (1,2 %)

El estudio de TREVO 2 como respaldo de la indicación 2

El ensayo clínico sobre TREVO 2 (del inglés, Thrombectomy REvascularization of large Vessel Occlusions in acute ischemic stroke [revascularización mediante trombectomía de occlusiones de grandes vasos en accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos]) evaluó la seguridad y eficacia del dispositivo extractor TREVO comparándolo con el extractor Merci®. En él participaron ciento setenta y ocho (178) pacientes, que recibieron tratamiento de forma aleatoria con el extractor Trevo (N = 88) o el extractor Merci (N = 90). Los principales criterios de inclusión que se utilizaron fueron los siguientes: pacientes con oclusión de grandes vasos a los que no se les pudo administrar un activador tisular del plasminógeno intravenoso (tPA IV) o que no respondieron al tPA IV y que podían ser tratados en un plazo de 8 horas desde la aparición de los síntomas; pacientes entre 18 y 85 años; pacientes con valores de escala NIHSS mayores o iguales a 8 y menores o iguales a 29, y pacientes a los que se les ha confirmado mediante angiografía la presencia de una oclusión persistente de un vaso grande en la arteria carótida interna, la cerebral media (segmento M1 o M2), la basilar o la vertebral. El principal criterio de exclusión que se utilizó fue: presencia de estenosis en un vaso proximal que exige tratamiento o que impide el acceso al trombo con el dispositivo en estudio.

El criterio principal de valoración de la eficacia fue establecer un flujo de revascularización con una puntuación mínima de TICI igual a 2 tras emplear el dispositivo en estudio. La evaluación la realizó el laboratorio principal. Del análisis que se muestra en la siguiente tabla, se excluyeron aquellos sujetos cuyo valor inicial de TICI era de 2a, según el laboratorio principal, y los sujetos en los que no se probó el dispositivo.

El criterio principal de valoración de la seguridad fue la incidencia de episodios adversos graves relacionados con la intervención (PRSAE) en un plazo de 24 horas desde la finalización de la misma, a saber: perforación vascular o disección arterial intramural, HIC sintomática, embolización de una región no afectada previamente, complicación en el lugar de acceso que requiera reparación quirúrgica o transfusión sanguínea, fallecimiento en un período de 24 horas, fallo del dispositivo (rotura *in vivo*) u otras complicaciones que el CEC considere que estén relacionadas con la intervención.

Criterios de valoración del estudio de TREVO 2
(pacientes con valor inicial de TICI igual a 0 o 1 y en los que se haya probado el dispositivo en estudio)

Criterio de valoración	Trevo N=79 pacientes	Merci N=81 pacientes	Diferencia [IC del 95 %]b	Valor de p
Criterio principal de valoración de la eficacia				
Éxito de la revascularización después de usar el dispositivo (TICI ≥ 2a)				
<i>El uso de cualquier terapia adyuvante se considera fallo de tratamiento</i> [95 % interv. confianza]a	79,7 % (63/79)	49,4 % (40/81)	30,4 %	< 0,0001c
	[69,2 %, 88,0 %]	[38,1 %, 60,7 %]	[15,0 %, 44,1 %]	< 0,0001d
Criterio principal de valoración de la seguridad				
Episodios compuestos	13,9 % (11/79)	23,5% (19/81)	-9,5% [-22,1%, 2,8%]	0,1567e
[95 % interv. confianza]a	[7,2 %, 23,6 %]	[14,8 %, 34,2 %]		
Perforación vascular	0,0 % (0/79)	9,9 % (8/81)	-9,9 % [-18,5%, -3,9%]	
Disección arterial intramural	0,0 % (0/79)	1,2 % (1/81)	-1,2 % [-6,7 %, 3,5 %]	
HIC sintomática	5,1 % (4/79)	9,9 % (8/81)	-4,8 % [-14,1 %, 3,8 %]	
Embolización de una región no afectada previamente	7,6 % (6/79)	4,9 % (4/81)	2,7 % [-5,6 %, 11,4 %]	
Complicación en el punto de acceso que necesite reparación quirúrgica o transfusión de sangre	1,3 % (1/79)	0,0 % (0/81)	1,3 % [-3,3 %, 6,9 %]	
Mortalidad en un plazo de 24 horas	1,3 % (1/79)	0,0 % (0/81)	1,3 % [-3,3 %, 6,9 %]	
Fallo del dispositivo <i>in vivo</i>	0,0 % (0/79)	0,0 % (0/81)	0,0 % [-4,6 %, 4,6 %]	
Otros PRSAE	0,0 % (0/79)	0,0 % (0/81)	0,0 % [-4,6 %, 4,6 %]	
mRS a los 90 días 0-2	38,2 % (29/76)	17,9 % (14/78)	20,2 % [6,4 %, 34,1 %]	0,0068e

a: Intervalos de confianza de Clopper-Pearson exactos para proporciones individuales; b: Intervalos de confianza exactos para diferencias en proporciones computados con StatXact versión 8; c: Hipótesis de no inferioridad evaluada mediante el método de Blackwelder con un margen de no inferioridad del 10%; d: Prueba exacta de Fisher unilateral de superioridad; e: Prueba exacta de Fisher bilateral.

GARANTÍA

Stryker Neurovascular garantiza que se ha puesto un cuidado razonable en el diseño y la fabricación de este instrumento. **Esta garantía sustituye a cualquier otra que no se mencione expresamente en este documento, ya sea de forma explícita o implícita por ley o de otro modo, incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o de adecuación para un fin concreto.** La manipulación, el almacenamiento, la limpieza y la esterilización de este instrumento, así como otros factores relacionados con el paciente, el diagnóstico, el tratamiento, las intervenciones quirúrgicas y cualquier otro aspecto ajeno al control de Stryker Neurovascular afectan directamente a este instrumento y a los resultados que puedan obtenerse de su uso. La responsabilidad de Stryker Neurovascular en virtud de esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este instrumento y Stryker Neurovascular no asumirá responsabilidad alguna por pérdidas accidentales o consecuentes, por daños ni por los gastos directos o indirectos que pueda ocasionar el uso de este instrumento. Stryker Neurovascular tampoco asume ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada con este instrumento ni autoriza a ninguna persona a que lo haga en su nombre. **Stryker Neurovascular rechaza cualquier responsabilidad con respecto a instrumentos reutilizados, reprocessados o reesterilizados y, respecto a los mismos, no ofrece garantía alguna, ya sea explícita o implícita, incluyendo entre otras la de comerciabilidad y adecuación para un fin concreto.**

Extracteur Trevo®

Rx ONLY

Avertissement : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription d'un médecin.

MISE EN GARDE

Contenu STÉRILISÉ à l'oxyde d'éthylène (OE). Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé. Si le produit est endommagé, contacter le représentant de Stryker Neurovascular.

À usage unique. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation de ce dispositif risquent de compromettre son intégrité structurelle et/ou d'entraîner son dysfonctionnement, risquant de provoquer des blessures, des maladies ou le décès du patient. De plus, une telle action risque d'entraîner la contamination du dispositif et/ou l'infection croisée du patient, y compris la transmission de maladies infectieuses d'un patient à un autre. La contamination du dispositif peut causer des blessures, des maladies ou le décès du patient.

Après utilisation, éliminer le produit et l'emballage conformément au règlement de l'établissement, de l'administration et/ou du gouvernement local.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

L'extracteur comprend un raidisseur flexible conique présentant une section façonnée à son extrémité distale. Des repères en platine placés à l'extrémité distale permettent une visualisation radioscopique. La section façonnée est également radio-opaque. Les dimensions de l'extracteur sont indiquées sur l'étiquette. L'extracteur est doté d'un revêtement hydrophile visant à diminuer le frottement pendant l'utilisation. L'extracteur est muni d'un repère sur le corps indiquant la proximité de son extrémité par rapport à l'extrémité du microcathéter. Un dispositif de torsion est fourni avec l'extracteur pour en faciliter la manipulation. Le dispositif de torsion permet de verrouiller le raidisseur au microcathéter pendant l'intervention. Le verrouillage du dispositif de torsion au raidisseur permet de retirer le microcathéter et l'extracteur ensemble lors de l'extraction d'un caillot. Une aiguille d'introduction est fournie pour introduire l'extracteur dans un microcathéter. L'aiguille d'introduction est une gaine dans laquelle l'extracteur est préchargé. Lorsque la moitié de la longueur de l'extracteur a été insérée dans le microcathéter, on retire l'aiguille d'introduction. Les extracteurs présentent une extrémité proximale modifiée qui permet la fixation de l'extension de guide DOC de Abbott Vascular (RÉF 22260). Le fait de fixer l'extension de guide à l'extracteur facilite le retrait ou le remplacement d'un cathéter tout en maintenant l'extracteur positionné dans les tissus. Une fois l'échange terminé, l'extension peut être détachée.

Informations destinées aux utilisateurs

L'extracteur Trevo ne doit être utilisé que par des médecins dûment formés aux techniques endovasculaires interventionnelles.

Contenu

Un (1) extracteur Trevo

Un (1) dispositif de torsion

Une (1) aiguille d'introduction

Compatibilité

Taille de l'extracteur	Micocathéter Trevo Pro14	Microcathéter Trevo Pro18	Microcathétters Excelsior® XT-27® (150 cm x 6 cm, droits RÉF XT275081)	DI minimal recommandé du vaisseau (mm)
Trevo XP ProVue 3X20 mm	✓	✓		
Trevo XP ProVue 4X20 mm		✓		
Trevo ProVue 4X20 mm		✓		
Trevo XP ProVue 4X30 mm		✓	✓	
Trevo XP ProVue 6X25 mm			✓	

La compatibilité de l'extracteur avec d'autres microcathétters n'est pas établie. L'utilisation d'un autre microcathéter peut avoir un impact sur les performances de l'extracteur.

Les cathétér guides à ballonnet (comme le cathéter guide à ballonnet Merci® et le cathéter guide à ballonnet FlowGate®) sont recommandés pour les thrombectomies.

Les extracteurs sont compatibles avec la valve hémostatique rotative de Boston Scientific (RÉF 421242).

Les extracteurs sont compatibles avec l'extension de guide DOC de Abbott Vascular (RÉF 22260).

UTILISATION/INDICATIONS

1. L'extracteur Trevo est indiqué pour restaurer le flux sanguin dans le système neurovasculaire par thrombectomie lors du traitement des AVC ischémiques aigus afin de réduire l'invalidité chez les patients présentant une circulation antérieure proximale persistante, une occlusion d'un gros vaisseau et des infarctus de plus petite taille, et ayant reçu dans un premier temps un activateur tissulaire du plasminogène par voie intraveineuse (t-PA IV). Le traitement endovasculaire avec ce dispositif doit débuter dans les 6 heures suivant l'apparition des symptômes.
2. L'extracteur Trevo est conçu pour restaurer le flux sanguin dans le système neurovasculaire par thrombectomie chez les patients présentant un AVC ischémique, dans les 8 heures suivant l'apparition des symptômes. Les patients qui ne peuvent recevoir un activateur tissulaire du plasminogène par voie intraveineuse (t-PA IV) ou chez qui ce traitement a échoué sont candidats au traitement.
3. L'extracteur Trevo est indiqué pour restaurer le flux sanguin dans le système neurovasculaire par thrombectomie lors du traitement des AVC ischémiques aigus afin de réduire l'invalidité chez les patients présentant une circulation antérieure proximale persistante, une occlusion d'un gros vaisseau au niveau de l'artère carotide interne (ACI) ou du segment M1 de l'artère cérébrale moyenne (ACM) associée à des infarctus de plus petite taille (0-50 cc pour les patients <80 ans, 0-20 cc pour les patients ≥80 ans). Le traitement endovasculaire utilisant le dispositif doit débuter 6-24 heures après la dernière fois où le patient a été vu en bonne santé, chez des patients non admissibles à un traitement par activateur tissulaire du plasminogène par voie intraveineuse (t-PA IV) ou qui ne répondent pas à ce traitement.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour.

MISES EN GARDE

MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES POUR L'INDICATION 1

- La sécurité et l'efficacité des extracteurs Trevo pour la réduction de l'invalidité n'ont pas été établies chez des patients présentant des infarctus de grande taille (c'est-à-dire score ASPECTS ≤ 7). Les risques peuvent être accrus chez ces patients (p. ex. risque d'hémorragie intracérébrale).
- La sécurité et l'efficacité des extracteurs Trevo pour la réduction de l'invalidité n'ont pas été établies ni évaluées chez des patients présentant des occlusions au niveau de la circulation postérieure (p. ex. tronc basilaire ou artères vertébrales) ni pour des occlusions plus distales au niveau de la circulation antérieure.

MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES POUR L'INDICATION 2

- Pour réduire les risques de lésions vasculaires, veiller à choisir une taille d'extracteur adaptée au diamètre du vaisseau, au site prévu de déploiement.

MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES POUR L'INDICATION 3

- La sécurité et l'efficacité des extracteurs Trevo pour la réduction de l'invalidité n'ont pas été établies chez des patients présentant des infarctus de grande taille (c'est-à-dire score ASPECTS ≤ 7). Les risques peuvent être accrus chez ces patients (p. ex. risque d'hémorragie intracérébrale).
- La sécurité et l'efficacité des extracteurs Trevo pour la réduction de l'invalidité n'ont pas été établies ni évaluées chez des patients présentant des occlusions au niveau de la circulation postérieure (p. ex. tronc basilaire ou artères vertébrales) ni pour des occlusions plus distales au niveau de la circulation antérieure.
- Les utilisateurs doivent valider leurs techniques d'analyse logicielle d'imagerie pour garantir des résultats solides et cohérents lors de l'évaluation de la taille de l'infarctus.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES INDICATIONS

- L'administration de t-PA IV doit avoir lieu dans la fenêtre approuvée par la FDA (dans les 3 heures suivant l'apparition des symptômes).
- Pour réduire les risques de lésions vasculaires, respecter les recommandations suivantes :
 - Ne pas effectuer plus de six (6) tentatives de récupération dans le même vaisseau à l'aide d'extracteurs.
 - Maintenir la position de l'extracteur dans le vaisseau lors du retrait ou de l'échange de microcathéter.
- Pour réduire les risques de pliure/rupture, respecter les recommandations suivantes :
 - Immédiatement après avoir retiré la gaine de l'extracteur, positionner le repère d'extrémité du microcathéter en position proximale par rapport à la section façonnée. Maintenir le repère d'extrémité du microcathéter dans cette position pendant la manipulation et le retrait.
 - Ne pas faire tourner ni tordre l'extracteur.
 - Procéder avec prudence lors du passage de l'extracteur dans des artères présentant un stent.
- L'extracteur est un instrument fragile qui doit être manipulé avec soin. Avant utilisation, et si possible pendant la procédure, inspecter attentivement le dispositif pour repérer d'éventuels dommages. Ne pas utiliser un dispositif endommagé. Les détériorations peuvent perturber le fonctionnement du dispositif et entraîner des complications.
- Ne pas faire avancer et ne pas retirer l'extracteur en cas de résistance ou en présence d'un vasospasme important. La torsion ou le déplacement du dispositif contre résistance ou un vasospasme important peuvent endommager ce dernier ou causer une lésion vasculaire. Déterminer la cause de la résistance par radioscopie et, si nécessaire, remplacer la gaine sur le dispositif pour le retirer.

- S'il est difficile de retirer l'extracteur du vaisseau, ne pas tordre l'extracteur. Faire avancer le microcathéter en direction distale, rétracter doucement l'extracteur dans le microcathéter et retirer ensemble l'extracteur et le microcathéter. Si une résistance se fait sentir lors du retrait de l'extracteur dans le microcathéter, envisager d'allonger l'extracteur à l'aide de l'extension de guide DOC de Abbott Vascular (RÉF 22260) de manière à pouvoir remplacer le microcathéter par un microcathéter de plus gros diamètre, comme le cathéter DAC®. Rétracter doucement l'extracteur dans le cathéter de plus gros diamètre.
- Administrer un traitement anticoagulant et antiplaquettaire selon les directives standard de l'établissement.
- L'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les doses de rayons X administrées aux patients et aux utilisateurs en utilisant un bouclier suffisant, en réduisant la durée de la radioscopie et en modifiant les facteurs techniques de radiographie dans la mesure du possible.

PRÉCAUTIONS

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Utiliser avant la date limite d'utilisation.
- Une exposition à des températures supérieures à 54 °C (130 °F) est susceptible d'endommager le dispositif et les accessoires. Ne pas mettre à l'autoclave.
- Ne pas exposer l'extracteur à des solvants.
- Utiliser l'extracteur sous visualisation radioscopique et après administration d'agents anticoagulants appropriés.
- Afin d'éviter la formation de thrombus et la cristallisation du produit de contraste, maintenir une irrigation constante avec une solution de rinçage appropriée entre le cathéter guide et le microcathéter et entre le microcathéter et l'extracteur ou le guide.
- Ne pas fixer de dispositif de torsion à l'extrémité proximale façonnée de l'extracteur DOC compatible. Cela pourrait l'endommager et empêcher la fixation de l'extension de guide DOC.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Aucune tentative d'intervention nécessitant l'introduction de cathéters percutanés ne doit être effectuée par des médecins non expérimentés avec les complications susceptibles de se produire pendant ou après l'intervention. Les complications possibles incluent notamment :

- embolie gazeuse
- hématome ou hémorragie au site de ponction
- infection
- embolisation distale
- douleur/céphalée
- spasme vasculaire
- thrombose
- dissection
- perforation
- embolie
- occlusion aiguë
- ischémie
- hémorragie intracrânienne
- formation d'un faux anévrisme
- déficits neurologiques incluant accident vasculaire cérébral
- décès

L'utilisation du dispositif nécessite l'emploi de la radioscopie qui présente des risques potentiels liés à l'exposition aux rayons X encourus par les médecins et les patients. Les risques possibles incluent notamment :

- alopécie
- brûlures dont la gravité peut aller d'une simple rougeur à la formation d'ulcères
- cataracte
- néoplasie retardée

Signalement d'événements indésirables

Avertir immédiatement le représentant Stryker Neurovascular en cas de dysfonctionnement du dispositif, de complications chez le patient ou de lésion avérée ou suspectée. Conserver tout dispositif suspect, ses composants et leurs emballages pour les retourner à Stryker Neurovascular.

PRÉSENTATION

Les produits Stryker Neurovascular sont stériles et apyrogènes dans leur emballage non ouvert. L'emballage est conçu pour garantir la stérilité, sauf si la poche principale du produit a été ouverte ou endommagée.

Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Ne pas utiliser si l'étiquetage est incomplet ou illisible.

Manipulation et stockage

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Procédure de préparation recommandée

- Rincer le manchon d'emballage de l'extracteur avec du sérum physiologique. Hydrater pendant au moins 2 minutes avant de retirer l'extracteur du manchon. L'extracteur doit rester hydraté.
- Préparer et placer un cathéter guide à ballonnet ou un cathéter guide dans l'artère carotide interne, l'artère carotide commune ou l'artère sous-clavière, en suivant les indications de l'étiquetage du cathéter guide.
- Connecter une valve hémostatique rotative à l'embase du microcathéter.
- Appliquer des techniques de cathétérisme classiques pour placer le microcathéter dans le vaisseau cible en utilisant un guide neurovasculaire standard. Si l'anatomie le permet, positionner l'extrémité du microcathéter en position distale par rapport au thrombus.
- Retirer le guide du microcathéter. Injecter du produit de contraste dans le microcathéter pour visualiser le système vasculaire distal. Rincer le microcathéter.
- Retirer l'aiguille d'introduction et l'extracteur préchargé ensemble du manchon. Ne pas laisser l'extracteur sortir de l'extrémité de l'aiguille d'introduction ni se rétracter davantage à l'intérieur de l'aiguille d'introduction.
- Important :** Introduire l'aiguille d'introduction à mi-chemin dans la valve hémostatique rotative et utiliser une seringue ou une ligne de perfusion pour rincer l'aiguille d'introduction jusqu'à ce que de le sérum physiologique sorte à l'extrémité proximale de l'aiguille d'introduction. Si l'aiguille d'introduction n'est pas rincée correctement, la progression de l'extracteur dans l'aiguille d'introduction pourrait être difficile.
- Placer l'aiguille d'introduction dans l'embase du microcathéter et fermer la valve hémostatique rotative fermement pour fixer l'aiguille d'introduction.
- Faire avancer l'extracteur jusqu'à ce que la moitié de sa longueur soit insérée dans le microcathéter. Retirer l'aiguille d'introduction.

Procédure de récupération recommandée

- Faire avancer l'extracteur jusqu'à ce que son extrémité distale soit alignée avec l'extrémité distale du microcathéter.

Remarque : Le tableau ci-dessous montre l'endroit où se trouve l'extrémité de l'extracteur (extrémité distale de l'extracteur) par rapport à l'extrémité du microcathéter (extrémité distale du microcathéter) lorsque :

- l'extrémité distale du repère sur le corps de l'extracteur atteint l'embase du microcathéter, ou
- l'extrémité proximale du repère sur le corps de l'extracteur atteint l'extrémité proximale de la valve hémostatique rotative.

Tableau de suivi de l'extrémité distale

Trevo® ProVue 4x20 mm Trevo XP 4x20 mm Trevo XP 6x25 mm	• Dans les 8 cm à partir de la sortie de l'extrémité du microcathéter
Trevo XP 3x20 mm	• Dans les 15 cm à partir de la sortie de l'extrémité du microcathéter
Trevo XP 4x30 mm	<p>Lors d'une utilisation avec Trevo Pro 18 MC (90238) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans les 8 cm à partir de la sortie de l'extrémité du microcathéter <p>Lors d'une utilisation avec Excelsior® XT-27™ MC (XT275081) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans les 15 cm à partir de la sortie de l'extrémité du microcathéter

- Retirer le microcathéter tout en appliquant une légère force vers l'avant sur l'extracteur pour déployer la section façonnée de l'extracteur dans le caillot. Placer le repère d'extrémité du microcathéter juste à côté (en position proximale) de la section façonnée de l'extracteur.

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques de pliure/rupture, maintenir le repère d'extrémité du microcathéter dans cette position pendant la manipulation et le retrait.

- Après le déploiement de l'extracteur, visualiser l'expansion du filament et laisser le temps au caillot d'intégrer l'extracteur (environ 5 minutes).
- En cas d'utilisation d'un cathéter guide à ballonnet, gonfler le ballonnet pour obstruer le vaisseau en suivant les instructions de l'étiquetage du cathéter guide à ballonnet.
- Positionner et verrouiller le dispositif de torsion sur l'extracteur au niveau de l'embase du microcathéter.
- Retirer lentement l'extracteur et le microcathéter ensemble jusqu'à l'extrémité du cathéter guide à ballonnet tout en appliquant une aspiration sur le cathéter guide à ballonnet en utilisant une seringue de 60 mL.
- Appliquer une aspiration vigoureuse sur le cathéter guide à ballonnet en utilisant une seringue de 60 mL et retirer l'extracteur et le microcathéter à l'intérieur du cathéter guide. Poursuivre l'aspiration jusqu'à ce que l'extracteur et le microcathéter soient pratiquement retirés du cathéter guide.

Remarque : Si le retrait dans le cathéter guide à ballonnet ou dans le cathéter guide est difficile, dégonfler le ballonnet du cathéter guide à ballonnet tout en retirant simultanément ensemble le cathéter guide, le microcathéter et l'extracteur à travers la gaine. Retirer la gaine si nécessaire.

8. Dégonfler le ballonnet du cathéter guide à ballonnet.
9. Désconnecter la valve hémostatique rotative du cathéter guide à ballonnet et retirer complètement l'extracteur, le microcathéter et la valve hémostatique rotative ensemble du cathéter guide.
10. Fixer une seringue de 60 mL à l'embase du cathéter guide à ballonnet et aspirer.
11. Nettoyer le dispositif avec du sérum physiologique. Inspecter l'extracteur pour identifier des dommages éventuels. Ne pas réutiliser l'extracteur si le raidisseur, la section façonnée ou le col en platine ont un aspect différent par rapport au moment de leur retrait de l'emballage. Si aucune détérioration n'est observée, l'extracteur peut être utilisé pour trois (3) tentatives d'extraction au maximum. Une tentative d'extraction correspond à un (1) cycle de progression et de retrait complet.

Procédure d'échange de cathéter recommandée

1. Suivre les directives du mode d'emploi fourni avec l'extension de guide DOC de Abbott Vascular en remplaçant le terme « guide » par « extracteur ».

ÉTUDES CLINIQUES

Informations sur la sécurité et l'efficacité

Etude DAWN™ soutenant l'indication 3

L'étude DAWN (DWI and CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention [évaluation par IRM de diffusion et TDM avec injection avec mismatch clinique dans le triage des AVC du réveil et avec présentation tardive traités par neuro-intervention]) était un essai prospectif, randomisé, multicentrique, contrôlé, conçu pour évaluer l'hypothèse selon laquelle une thrombectomie avec l'extracteur Trevo® associée à un traitement médical permet d'obtenir des résultats cliniques à 90 jours supérieurs aux résultats obtenus avec un traitement médical seul chez des sujets sélectionnés de manière appropriée et présentant un AVC ischémique aigu lorsque le traitement est instauré 6 à 24 heures après qu'ils ont été vus en bonne santé pour la dernière fois. Au total, 206 sujets ont été inscrits dans 26 centres de recherche : 107 sujets (51,9 %) ont été randomisés dans le groupe de traitement et 99 sujets (48,1 %) ont été randomisés dans le groupe témoin. Les valeurs UV-mRS moyennes à 90 jours étaient de 5,5 dans le groupe de traitement vs 3,4 dans le groupe témoin ; la différence entre les groupes pour le degré d'invalidité pondéré selon l'utilité (utility-weighted, UW) et ajusté en fonction de l'infarctus était de 2,0 (intervallo de confiance Bayésien à 95 %, 1,1 à 3,0, probabilité postérieure de supériorité >0,9999). Le traitement avec l'extracteur Trevo a conduit à l'obtention de taux d'indépendance fonctionnelle supérieurs (score mRS 0-2) à 90 jours de 48,6 % vs 13,1 % ; la différence entre les groupes, ajustée en fonction de l'infarctus, était de 32,8 % (intervallo de confiance à 95 %, 21,1 % à 44,1 %, probabilité postérieure de supériorité >0,9999). Le taux d'hémorragie intracrânienne symptomatique à 24 heures était supérieur chez les patients ayant reçu le traitement endovasculaire. Les patients et/ou leurs représentants légaux doivent être informés de ce risque au cours du processus de décision thérapeutique. L'incertitude est plus élevée pour les résultats obtenus chez les sujets traités 18-24 heures après avoir été vus en bonne santé pour la dernière fois.

Principaux critères d'inclusion

AVC ischémique aigu avec occlusion confirmée de l'ACI intracrânienne et/ou du segment M1, n'ayant pas répondu au t-PA IV ou ayant une contre-indication à ce traitement, traités 6-24 heures après avoir été vus en bonne santé pour la dernière fois, score NIHSS initial ≥10, consentement éclairé donné et âge supérieur ou égal à 18 ans ; chez les patients ayant moins de 80 ans, un score d'AVC supérieur ou égal à 10 doit être associé à un volume d'infarctus inférieur à 51 mL. Chez les patients de 80 ans ou plus, le score d'AVC doit être supérieur à 10 et le volume inférieur à 21 mL. Discordance entre les signes cliniques et la taille de l'infarctus définie comme la discordance entre le volume de l'infarctus à l'état initial à l'imagerie par TDM ou IRM et l'étendue du tissu cérébral total à risque. Le volume de l'infarctus a été évalué par imagerie par résonance magnétique (IRM) pondérée en diffusion ou par TDM avec injection et mesuré avec l'une des suites logicielles automatisées disponibles sur le marché (RAPID, IschemiaView).

Principaux critères d'exclusion

Amélioration rapide de l'état neurologique jusqu'à un score NIHSS <10 ou signe de recanalisation vasculaire avant la randomisation ; tension artérielle > 185/110 mmHg ; résultats de laboratoire démontrant un déséquilibre électrolytique (sodium <130 mmol/L, potassium <3 mEq/L ou >6 mEq/L) ; résultats de laboratoire démontrant une insuffisance rénale (créatinine sérique >3,0 mg/dL [264 µmol/L] ; résultats de laboratoire démontrant des anomalies de la coagulation (numération plaquettaire <50 000/µL, APTT >3 fois la valeur normale ou INR >3,0, si inhibiteur du facteur Xa administré 24-48 heures auparavant, PTT normal) ; résultats de laboratoire démontrant une hémorragie (hémoglobine <7 mmol/L).

Le critère d'évaluation principal était l'invalidité à 90 jours, évaluée sur l'échelle de Rankin modifiée (mRS).

L'objectif secondaire est d'apporter des preuves que la réperfusion endovasculaire avec l'extracteur Trevo est associée à une réduction significative de la taille médiane de l'infarctus comparativement au groupe témoin 24 heures (-6/+24 heures) après la randomisation. Les critères d'évaluation secondaires incluent la proportion de sujets avec bon résultat fonctionnel à 90 jours (score mRS de 0-2) ; la proportion de sujets avec réduction du score NIHSS ≥10 points depuis l'état initial ou score NIHSS de 0 ou 1 ; la différence entre le groupe de traitement et le groupe témoin pour la mortalité toutes causes confondues ; la différence de taille médiane finale de l'infarctus à 24 heures ; la différence de taux de revascularisation à 24 heures ; et le taux de réperfusion jusqu'à un score TICI >2b.

Les résultats relatifs à la sécurité incluent l'incidence de mortalité associée à l'AVC à 90 jours, l'incidence de HIS, de détérioration neurologique et d'événements indésirables graves associés à la procédure et associés au dispositif.

Échelle de Rankin modifiée à 90 jours - population ITT

Échelle de Rankin modifiée (mRS)	Groupe de traitement N = 107	Groupe témoin N = 99
0 - Aucun symptôme / UW = 10	9,3 % (10/107)	4,0 % (4/99)
1 - Pas d'invalidité significative / UW = 9,1	22,4 % (24/107)	5,1 % (5/99)
2 - Légère invalidité / UW = 7,6	16,8 % (18/107)	4,0 % (4/99)
3 - Invalidité modérée / UW = 6,5	13,1 % (14/107)	16,2 % (16/99)
4 - Invalidité modérément sévère / UW = 3,3	13,1 % (14/107)	34,3 % (34/99)
5 - Invalidité sévère / UW = 0	6,5 % (7/107)	18,2 % (18/99)
6 - Décès / UW = 0	18,7 % (20/107)	18,2 % (18/99)
Score mRS à 90 jours [0-2]	48,6 % (52/107)	13,1 % (13/99)
Score mRS pondéré à 90 jours*		
Moyenne ± écart type (N)	5,5 ± 3,8 (107)	3,4 ± 3,2 (99)
Médiane (Q1, Q3)	6,5 (0,0, 9,1)	3,3 (0,0, 6,5)
Fourchette (min, max)	(0,0, 10,0)	(0,0, 10,0)
[Intervalle de conf. à 95 %] ¹	[4,8, 6,3]	[2,7, 4,0]

*Par approximation normale
*Le score mRS = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) s'est vu attribuer une valeur numérique correspondante = (10, 9,1, 7,6, 6,5, 3,3, 0,0), représentant son utilité clinique

Principaux co-critères d'évaluation - population ITT

Résultat	Intervention (N = 107)	Témoin (N = 99)	Déférence absolue moyenne (IC à 95 %)	Bénéfice moyen postérieur, ajusté selon l'infarctus (Intervalle de confiance à 95 %)*	Probabilité de supériorité
Moyenne des scores mRS pondérés selon l'utilité (utility-weighted, UW) (écart type, É.-T.)	5,5 (3,8)	3,4 (3,1)	2,1 (1,2, 3,1)	2,0 (1,1, 3,0)	>0,9999 ¹
Indépendance fonctionnelle (mRS 0-2)	48,6 %	13,1 %	35,5 % (23,9, 47,0 %)	32,8 % (21,1 %, 44,1 %)	>0,9999

*Estimation par modèle linéaire général Bayésien avec ajustement en fonction de l'infarctus

¹La probabilité globale que le dispositif apporte un bénéfice est la moyenne des probabilités du bénéfice pour les ensembles de données imputées, pondérée par les probabilités d'imputation de ces ensembles de données. Cette probabilité est de 0,999996.

Le second critère d'évaluation secondaire de l'efficacité était la réduction du score NIHSS≥10 points depuis l'état initial ou un score NIHSS de 0 ou 1.

Réponse neurologique rapide au jour 5-7 à la sortie de l'hôpital

Résultat	Intervention N = 107	Témoin N = 99	Déférence absolue moyenne (IC à 95 %)	Risque relatif (IC à 95 %)	Valeur p
Réponse rapide†	47,7 %	19,2 %	28,5 % (16,2 %, 40,7 %)	2,5 (1,6, 3,9)	<0,001

†Définie par une réduction du score NIHSS ≥ 10 points par rapport à l'état initial ou par un score NIHSS de 0 ou 1 les jours 5-7 ou à la sortie de l'hôpital (si elle intervient plus tôt). La valeur p n'a pas été ajustée pour tenir compte de la multiplicité.

Le résultat secondaire d'efficacité était le taux de revascularisation à 24 heures, défini par la présence d'une recanalisation partielle ou complète.

Taux de revascularisation à 24 heures

	Total N = 206	Groupe de traitement N = 107	Groupe témoin N = 99	Déférence [IC à 95 %]	Valeur p
Différence entre les taux de revascularisation à 24 heures (-6/+24 heures) après la randomisation	58,7 % (121/206)	76,6 % (82/107)	38,4 % (38/99)	40,2 % [27,1 %, 51,5 %]	< 0,0001 ^a

Revascularisation à 24 heures, définie par la présence d'une recanalisation partielle ou complète.

a. test t. La valeur p n'a pas été ajustée pour tenir compte de la multiplicité.

Le critère d'évaluation principal de la sécurité était l'incidence de la mortalité associée à l'AVC à 90 jours. Les

résultats secondaires d'efficacité, pour les groupes de traitement et témoin, sont l'incidence de HIS selon la définition de l'ECASS, dans les 24 (-6/+24) heures suivant la randomisation (temps zéro) et l'incidence de la détérioration neurologique d'après le score NIHSS entre l'état initial et le jour 5-7/la sortie de l'hôpital (si elle intervient avant) après la randomisation. La détérioration neurologique était définie comme une augmentation ≥ 4 points du score NIHSS par rapport au score initial.

Mortalité associée à l'AVC à 90 jours

	Total N = 206	Groupe de traitement N = 107	Groupe témoin N = 99	Déférence [IC à 95 %] ^a	Valeur p
Incidence de la mortalité associée à l'AVC à 90 jours	17,0 % (35/206)	15,9 % (17/107)	18,2 % (18/99)	-2,3 % [-12,6, 8,0 %]	0,7126 ^a

^aPar approximation normale

a. test t. La valeur p n'a pas été ajustée pour tenir compte de la multiplicité.

Le résultat secondaire de sécurité était l'incidence de HIS (selon la définition de l'ECASS III), dans les 24 heures (-6/+24 heures) suivant la randomisation (temps zéro).

Incidence de HIS selon l'adjudication par le CEC

	Total N = 206	Groupe de traitement N = 107	Groupe témoin N = 99	Déférence [IC à 95 %] ^a	Valeur p
HIS 24 heures (-6/+24) après randomisation	4,4 % (9/206)	5,6 % (6/107)	3,0 % (3/99)	2,6 % [-2,9, 8,1 %]	0,5011 ^a

^aPar approximation normale

a. Test exact de Fisher. La valeur p n'a pas été ajustée pour tenir compte de la multiplicité.

L'incidence de la détérioration neurologique a été définie par une augmentation ≥ 4 points du score NIHSS entre l'état initial et le jour 5-7/sortie de l'hôpital après randomisation (temps zéro).

Incidence de la détérioration neurologique selon la décision du CEC

	Total N = 206	Groupe de traitement N = 107	Groupe témoin N = 99	Déférence [IC à 95 %] ^a	Valeur p
Incidence de la détérioration neurologique entre l'état initial et les jours 5 à 7/la sortie de l'hôpital	19,9 % (41/206)	14,0 % (15/107)	26,3 % (26/99)	-12,2 % [-23,1 %, -1,4 %]	0,0358 ^a

^aPar approximation normale

a. test t. La valeur p n'a pas été ajustée pour tenir compte de la multiplicité.


Indépendance fonctionnelle (score mRS à 90 jours, 0-2), sous-groupes créés en fonction du temps

Intervalle de TLSV	Traitements	Témoin	Déférence	Valeur p
6-9 h	50,0 % (9/18)	14,3 % (3/21)	35,7 % [8,2 %, 63,2 %]	0,0346 ^a
9-12 h	58,1 % (18/31)	26,1 % (6/24)	33,1 % [8,5 %, 57,6 %]	0,0273 ^a
Total 6-12 h	55,1 % (27/49)	20,0 % (9/45)	35,1 % [16,9 %, 53,3 %]	0,0006^a
12-15 h	37,5 % (6/16)	9,1 % (2/22)	28,4 % [1,8 %, 55,0 %]	0,0498 ^a
15-18 h	50,0 % (13/26)	5,3 % (1/19)	44,7 % [23,1 %, 66,4 %]	0,0025 ^a
18-21 h	36,4 % (4/11)	0,0 % (0/8)	36,4 % [7,9 %, 64,8 %]	0,1032 ^a
21-24 h	40,0 % (2/5)	20,0 % (1/5)	20,0 % [-35,4 %, 75,4 %]	1,0000 ^a
Total 12-24 h*	43,1 % (25/58)	7,4 % (4/54)	35,7 % [21,2 %, 50,2 %]	< 0,0001^a

a. Test exact de Fisher

* L'incertitude la plus élevée pour les résultats obtenus chez les sujets traités 18-24 heures après qu'ils ont été vus en bonne santé pour la dernière fois.

La valeur p n'a pas été ajustée pour tenir compte de la multiplicité.

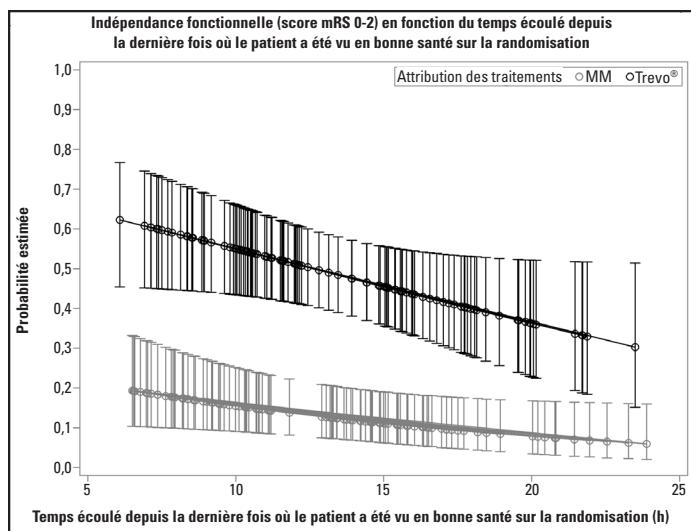

Le tableau qui suit reprend tous les événements indésirables graves et non graves survenus chez l'ensemble des sujets du groupe témoin et du groupe de traitement, par classe de système d'organes du dictionnaire MedDRA.

MedDRA* Classe par système/organe	Groupe de traitement N = 107						Groupe témoin N = 99					
	EIG	Sujets avec EIG	El non graves	Sujets avec El non graves	Total des El	Sujets avec El graves et non graves (total)	EIG	Sujets avec EIG	El non graves	Sujets avec El non graves	Total des El	Sujets avec El graves et non graves (total)
Tout événement indésirable (El)	65	41 (38,3 %)	476	102 (95,3 %)	541	103 (96,3 %)	83	47 (47,5 %)	473	91 (91,9 %)	556	91 (91,9 %)
Troubles hématologiques et du système lymphatique	0	0	11	10 (9,3 %)	11	10 (9,3 %)	1	1 (1,0 %)	8	8 (8,1 %)	9	8 (8,1 %)
Troubles cardiaques	8	7 (6,5 %)	37	29 (27,1 %)	45	33 (30,8 %)	6	5 (5,1 %)	29	24 (24,2 %)	35	28 (28,3 %)
Troubles endocriniens	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	0	0	0	0
Troubles oculaires	1	1 (0,9 %)	0	0	1	1 (0,9 %)	0	0	2	2 (2,0 %)	2	2 (2,0 %)
Troubles gastrointestinaux	7	6 (5,6 %)	42	30 (28,0 %)	49	34 (31,8 %)	12	11 (11,1 %)	38	28 (28,3 %)	50	34 (34,3 %)
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	0	0	22	18 (16,8 %)	22	18 (16,8 %)	0	0	17	15 (15,2 %)	17	15 (15,2 %)
Troubles hépatobiliaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0 %)	1	1 (1,0 %)
Troubles du système immunitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0 %)	1	1 (1,0 %)
Infections et infestations	6	6 (5,6 %)	46	34 (31,8 %)	52	38 (35,5 %)	7	7 (7,1 %)	54	41 (41,4 %)	61	43 (43,4 %)
Lésions, intoxications et complications associées à l'intervention	2	2 (1,9 %)	8	7 (6,5 %)	10	9 (8,4 %)	2	2 (2,0 %)	8	6 (6,1 %)	10	7 (7,1 %)
Études	0	0	5	5 (4,7 %)	5	5 (4,7 %)	0	0	10	10 (10,1 %)	10	10 (10,1 %)
Troubles du métabolisme et de la nutrition	0	0	76	47 (43,9 %)	76	47 (43,9 %)	0	0	62	34 (34,3 %)	62	34 (34,3 %)
Troubles musculo-squelettiques et systémiques	0	0	11	10 (9,3 %)	11	10 (9,3 %)	2	2 (2,0 %)	22	15 (15,2 %)	24	16 (16,2 %)
Tumeurs bénignes, malignes et non précisées	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	0	0	0	0
Troubles du système nerveux	21	21 (19,6 %)	95	63 (58,9 %)	116	71 (66,4 %)	34	30 (30,3 %)	88	53 (53,5 %)	122	66 (66,7 %)
Troubles psychiatriques	1	1 (0,9 %)	26	24 (22,4 %)	27	24 (22,4 %)	2	2 (2,0 %)	30	27 (27,3 %)	32	28 (28,3 %)
Troubles rénaux et des voies urinaires	0	0	18	15 (14,0 %)	18	15 (14,0 %)	1	1 (1,0 %)	19	14 (14,1 %)	20	15 (15,2 %)
Troubles du système de reproduction et du sein	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	2	2 (2,0 %)	2	2 (2,0 %)
Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux	14	11 (10,3 %)	33	28 (26,2 %)	47	33 (30,8 %)	11	9 (9,1 %)	42	34 (34,3 %)	53	37 (37,4 %)
Troubles de la peau et du tissu sous-cutané	0	0	3	3 (2,8 %)	3	3 (2,8 %)	0	0	10	7 (7,1 %)	10	7 (7,1 %)
Actes médicaux et chirurgicaux	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	2	2 (1,9 %)	1	1 (1,0 %)	2	2 (2,0 %)	3	3 (3,0 %)
Troubles vasculaires	4	3 (2,8 %)	39	33 (30,8 %)	43	34 (31,8 %)	4	4 (4,0 %)	28	21 (21,2 %)	32	23 (23,2 %)

*MedDRA v17.0.

Étude MR CLEAN soutenant l'indication 1

MR CLEAN est un essai prospectif, randomisé, contrôlé, multicentrique, de grande envergure, mené en ouvert et auquel ont participé tous les centres hospitaliers des Pays-Bas pratiquant des interventions endovasculaires. Un traitement intra-artériel (IA), associé à des soins habituels (pouvant inclure l'administration de t-PA par voie intraveineuse), a été comparé aux soins habituels pratiqués seuls (groupe témoin) chez des patients avec AVC ischémique aigu et occlusion de la circulation antérieure au niveau de l'artère intracrânienne proximale, confirmée à l'imagerie vasculaire. Dans l'étude MR CLEAN, 500 patients ont été randomisés (233 dans le groupe de traitement (« IAT »), 267 dans le groupe témoin) dans 16 centres médicaux. Des stents récupérables (incluant la gamme de produits de l'extracteur Trevo®) ont été utilisés chez 190 des 233 patients (81,5 %) du groupe IAT, dont 120 sujets/190 ont reçu un traitement intra-artériel de première intention avec un extracteur Trevo et 104 / 120 ont reçu du t-PA IV dans les 3 heures suivant l'apparition des symptômes, comparativement à l'ensemble du groupe recevant le traitement médicamenteux (MM) MR CLEAN, dont 224 sujets sur 249 ont été traités par t-PA IV conformément à l'étiquetage de la FDA. Sur les 120 sujets qui ont reçu un traitement intra-artériel de première intention avec un extracteur Trevo, 24 sujets ont bénéficié de la pose concomitante d'un stent carotidien. Ces sujets sont exclus du résumé d'efficacité présenté ci-dessous, ce qui donne une cohorte d'efficacité principale incluant 96 sujets traités avec l'extracteur Trevo. Les sujets ayant reçu des thrombolytiques en IA ou un traitement avec d'autres dispositifs de thrombectomy mécanique après l'extracteur Trevo ont été comptés comme des échecs dans les résumés d'efficacité ci-dessous.

Principaux critères d'inclusion pour l'étude MR CLEAN

AVC ischémique aigu avec occlusion confirmée pour l'ACI, les segments M1, M2, A1 ou A2, traitement dans les 6 heures suivant l'apparition des symptômes et score NIHSS >2, TDM ou IRM excluant toute hémorragie intracrânienne, consentement éclairé donné et patient ayant 18 ans ou plus.

Principaux critères d'inclusion pour le sous-ensemble extracteur Trevo

Critères d'inclusion principaux supplémentaires pour l'analyse du sous-ensemble extracteur Trevo (cohorte FDA) effectuée dans le cadre de l'étude MR CLEAN : traitement de première intention avec l'extracteur Trevo et traitement par t-PA IV dans les 3 heures suivant l'apparition des symptômes.

Principaux critères d'exclusion pour l'étude MR CLEAN

Tension artérielle > 185/110 mmHg ; glycémie <2,7 ou >22,2 mmol/L ; traitement thrombolytique en intraveineuse à une dose supérieure à 0,9 mg/kg d'altéplase ou 90 mg ; traitement thrombolytique en intraveineuse malgré des contre-indications (chirurgie majeure, hémorragie gastrointestinale ou hémorragie des voies urinaires au cours des 2 semaines précédentes, ou ponction artérielle au niveau d'un site non compressible au cours des 7 jours précédents ; infarctus cérébral au niveau de la distribution de l'artère obstruée au cours des 6 semaines précédentes ; résultats de laboratoire démontrant une anomalie de la coagulation (numération plaquettaires <40x10⁹/L, APTT >50 sec ou INR >3,0).

Le critère d'évaluation principal de l'efficacité visait à démontrer qu'une thrombectomy avec l'extracteur Trevo associée au MM entraîne une indépendance fonctionnelle supérieure (mRS <3) à 90 Jours comparativement au MM seul chez les sujets admissibles avec AVC ischémique aigu. D'après l'analyse, le traitement IAT avec l'extracteur Trevo a eu un effet hautement significatif après ajustement en fonction du site, l'utilisation de t-PA IV et le score NIHSS initial.

Critère d'évaluation principal de l'efficacité

Variable	Ratio pour les variables binaires	Rapport des cotes [IC à 95 %]	Valeur p
Trevo® sans pose concomitante d'un stent carotidien	Trevo vs MM	1,88 [1,07, 3,29]	0,014 ¹
t-PA IV	Oui vs Non	1,45 [0,60, 3,52]	0,4134 ²
NIHSS	>14 ou ≤14	0,41 [0,24, 0,69]	0,0010 ²

¹Test t unilatéral.²Test t bilatéral.**Distribution du score mRS à 90 jours***

Score mRS	Trevo sans pose concomitante d'un stent carotidien (N = 96)	90 JOURS Mr Clean/témoin (N = 249)
0	4,2 % (4/96)	0,4 % (1/249)
1	8,3 % (8/96)	5,2 % (13/249)
2	17,7 % (17/96)	13,7 % (34/249)
3	15,6 % (15/96)	16,5 % (41/249)
4	32,3 % (31/96)	31,3 % (78/249)
5	7,3 % (7/96)	10,4 % (26/249)
6	14,6 % (14/96)	22,5 % (56/249)
Score mRS [0, <3], tout recours à un traitement thrombolytique intra-artériel considéré comme un échec du traitement*	29,2 % (28/96)	19,3 % (48/249)

¹I sujet avec utilisation d'un traitement thrombolytique IA a été compté comme échec.²Des sujets des deux groupes ont reçu un tPA en IV dans les 3 heures (81 sur 96 dans la cohorte l'extracteur Trevo et 224 sur 249 dans le groupe traitement médical).

L'analyse de l'objectif principal de sécurité a été définie comme la comparaison du taux de mortalité toutes causes confondues entre le groupe l'extracteur Trevo plus traitement médical et le groupe témoin avec traitement médical seul.

	Cohorte Trevo FDA % (x/n) (LIC, LSC) ¹	MM % (x/n) (LIC, LSC) ¹
Mortalité à 90 jours	13,33 (16/120) (7,82, 20,75)	22,89 (57/249) (17,82, 28,62)

¹Intervalles de confiance exacts bilatéraux de Clopper Pearson à 95 %.

Le premier critère d'évaluation secondaire de l'efficacité était le pourcentage de patients sans occlusion intracrânienne évalué par étude de consensus par trois évaluateurs au maximum après 24 heures. Le critère d'évaluation a été évalué par ATDM/ARM en utilisant l'échelle de lésion d'occlusion artérielle (AOL, Arterial Occlusive Lesion).

	Trevo sans pose concomitante d'un stent carotidien (%) (x/N) (LIC, LSC) ¹	MM (%) (x/N) (LIC, LSC) ²
Sans occlusion (24 heures)	77,5 % (62/80) (66,8, 86,1)	33,51 (65/194) (26,90, 40,62)

¹Les sujets sans ATDM/ARM à 24 heures ont été exclus de cette analyse.²Intervalles de confiance exacts bilatéraux de Clopper Pearson à 95 %.

Le deuxième critère d'évaluation secondaire de l'efficacité est le pourcentage de patients du groupe extracteur Trevo ayant obtenu une recanalisation (score TICI 2a ou mieux). Ce critère d'évaluation a également été évalué par étude de consensus par au moins trois évaluateurs.

	Trevo sans pose concomitante d'un stent carotidien % (x/N) (LIC, LSC) ¹
Réussite de la revascularisation (score TICI ≥ 2a)	81,3 % (78/96) (72,0, 88,5)

¹Intervalles de confiance exacts bilatéraux de Clopper Pearson à 95 %.

Le troisième critère d'évaluation de l'efficacité était défini comme la différence concernant les résultats neurologiques évalués par le score NIHSS à 24 heures et 5-7 jours après la randomisation entre le groupe avec extracteur Trevo plus traitement médical et le groupe témoin MM.

Score NIHSS	Trevo sans pose concomitante d'un stent carotidien Moyenne ± écart type (N) Médiane (min, max) (LIC, LSC) ¹	MM Moyenne ± écart type (N) Médiane (min, max) (LIC, LSC) ²
Score NIHSS (24 heures)	14,23 ± 9,23 (96) 14,00 (1, 42) (12,36, 16,10)	16,19 ± 7,77 (240) 16 (0, 42) (15,20, 17,18)
Score NIHSS (5-7 jours)¹	13,02 ± 12,16 (94) 12,00 (0, 42) (10,53, 15,51)	15,76 ± 11,49 (237) 15 (0, 42) (14,29, 17,23)

¹Les sujets sans score NIHSS ont été exclus de cette analyse. Un score NIHSS de 42 a été attribué aux sujets décédés avant la sortie de l'hôpital.

²Limites de confiance bilatérales à 95 % par approximation normale.

Le tableau qui suit résume tous les événements indésirables jusqu'à 90 jours après la randomisation, pour la cohorte l'extracteur Trevo de sujets, selon la catégorisation de l'étude MR CLEAN. Pour toutes les analyses de sécurité, les sujets exposés à l'extracteur Trevo avec ou sans pose d'un stent carotidien sont inclus.

Classe dans l'étude MR CLEAN	Cohorte Trevo FDA 120 sujets avec 189 événements (%) (x/N) (LIC, LSC) ¹ Nombre d'événements	MM 249 sujets avec 331 événements (%) (x/N) (LIC, LSC) ¹ Nombre d'événements
AVC ischémique	2,5 % (3/120) [0,5 %, 7,1 %] 3	0,8 % (2/249) [0,1 %, 2,9 %] 2
Hémorragie intracrânienne symptomatique	7,5 % (9/120) [3,5 %, 13,8 %] 9	6,8 % (17/249) [4,0 %, 10,7 %] 17
Hémorragie extracrânienne	2,5 % (3/120) [0,5 %, 7,1 %] 3	4,4 % (11/249) [2,2 %, 7,8 %] 11
Ischémie cardiaque	0	2,0 % (5/249) [0,7 %, 4,6 %] 5
Réaction allergique	1,7 % (2/120) [0,2 %, 5,9 %] 2	0,4 % (1/249) [0,0 %, 2,2 %] 1
Pneumonie	18,3 % (22/120) [11,9 %, 26,4 %] 24	19,3 % (48/249) [14,6 %, 24,7 %] 52
Autre infection	23,3 % (28/120) [16,1 %, 31,9 %] 34	13,7 % (34/249) [9,6 %, 18,6 %] 41
Autre complication	47,5 % (57/120) [38,3 %, 56,8 %] 89	38,6 % (96/249) [32,5 %, 44,9 %] 154
Progression de l'AVC	20,8 % (25/120) [14,0 %, 29,2 %] 25	18,9 % (47/249) [14,2 %, 24,3 %] 48

¹Intervalles de confiance exacts bilatéraux de Clopper Pearson à 95 %

Le tableau qui suit résume tous les événements indésirables de l'étude MR CLEAN jusqu'à 90 jours après la randomisation, pour la cohorte FDA, selon le codage MeDRA.

Événements indésirables de l'étude MR CLEAN, codage MeDRA v18.0, pour la cohorte FDA, fréquence supérieure à 1 %

Terme MedDRA privilégié	Cohorte Trevo® FDA (N = 120) Patients avec événements (%)	Témoin (N = 249) Patients avec événements (%)
AVC en progression	19 (15,8 %)	41 (16,5 %)
Hémorragie intracrânienne	13 (10,8 %)	20 (8,0 %)
Infection des voies urinaires	11 (9,2 %)	17 (6,8 %)
Fibrillation auriculaire	10 (8,3 %)	10 (4,0 %)
Pyrexie	6 (5,0 %)	6 (2,4 %)
Décompensation neurologique	6 (5,0 %)	6 (2,4 %)
Pneumonie par aspiration	5 (4,2 %)	8 (3,2 %)
Délire	4 (3,3 %)	6 (2,4 %)
Greffé osseuse	4 (3,3 %)	1 (0,4 %)
Insuffisance cardiaque	3 (2,5 %)	7 (2,8 %)
Diarrhée	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Urosepsis	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Chute	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Céphalée	3 (2,5 %)	1 (0,4 %)
AVC ischémique	3 (2,5 %)	1 (0,4 %)
Arrêt cardiaque	2 (1,7 %)	0
Hypersensibilité	2 (1,7 %)	1 (0,4 %)
Infection à Clostridium difficile	2 (1,7 %)	0
Goutte	2 (1,7 %)	3 (1,2 %)
Dissection de l'artère carotide	2 (1,7 %)	0
Épilepsie	2 (1,7 %)	3 (1,2 %)
Dépression	2 (1,7 %)	4 (1,6 %)
Rétention urinaire	2 (1,7 %)	2 (0,8 %)
Embolie pulmonaire	2 (1,7 %)	6 (2,4 %)
Hématome	2 (1,7 %)	2 (0,8 %)
Anémie	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Bradycardie	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Convulsions	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Insuffisance respiratoire	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Insertion d'une sonde gastrointestinale	1 (0,8 %)	5 (2,0 %)
Hypotension	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Phlébite	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Vasospasme	1 (0,8 %)	0
Arythmie cardiaque	0	3 (1,2 %)
Ischémie myocardique	0	3 (1,2 %)
Insuffisance rénale	0	3 (1,2 %)
Thrombose veineuse profonde	0	3 (1,2 %)

Étude TREVO 2 pour soutenir l'indication 2

L'essai clinique TREVO 2 (Thrombectomy REvascularization of large Vessel Occlusions in acute ischemic stroke (revascularisation par thrombectomie d'occlusions de gros vaisseaux en cas d'AVC ischémique aigu) a permis d'évaluer la sécurité et l'efficacité de l'extracteur Trevo et de les comparer à celles de l'extracteur Merci®. Cent soixante dix huit (178) patients ont été inscrits et randomisés dans un groupe de traitement soit par l'extracteur Trevo (N = 88) soit par l'extracteur Merci (N = 90). Critères d'inclusion principaux : patients avec occlusion d'un gros vaisseau n'ayant pas répondu ou n'étant pas admissibles pour un traitement par activateur tissulaire du plasminogène en intraveineuse (t-PA IV) et ayant pu être traités dans les 8 heures suivant l'apparition des symptômes ; patients de 18 à 85 ans ; $8 \leq \text{score NIHSS} \leq 29$; et confirmation à l'angiographie d'une occlusion persistante d'un gros vaisseau dans l'artère carotide interne, l'artère cérébrale moyenne (segments M1 et/ou M2), l'artère basilaire et/ou l'artère vertébrale. Critères d'exclusion principaux : sténose d'un vaisseau proximal nécessitant un traitement ou empêchant l'accès au thrombus avec le dispositif à l'étude affecté.

Le critère d'évaluation principal de l'efficacité était la revascularisation avec score TICI d'au moins 2 après utilisation du dispositif affecté, mesurée dans un laboratoire central. Les sujets avec score TICI initial de 2a d'après le laboratoire central et les sujets chez lesquels aucune tentative d'utilisation du dispositif n'a été réalisée ont été exclus des analyses présentées dans le tableau ci-dessous.

Le critère d'évaluation principal de la sécurité était l'incidence des événements indésirables graves (EIG) liés à l'intervention dans les 24 heures suivant l'intervention, à savoir : perforation vasculaire ou dissection artérielle intramurale, HI symptomatique, embolisation impliquant un territoire précédemment épargné, complications au point d'accès nécessitant une réparation chirurgicale ou une transfusion sanguine, mortalité dans les 24 heures, défaillance du dispositif (rupture *in vivo*), ou toute autre complication dont le Comité des événements cliniques (CEC) estime qu'elle est liée à l'intervention.

Critères d'évaluation de l'étude TREVO 2
(patients avec un score TICI initial de 0 ou 1, tentative d'utilisation du dispositif à l'étude)

Critère d'évaluation	Trevo N = 79 pts	Merci N = 81 pts	Déférence [IC à 95 %] ^a	Valeur p
Critère d'évaluation principal de l'efficacité				
Réussite de la revascularisation après mise en place du dispositif (score TICI ≥ 2a)				
<i>Tout recours à un traitement d'appoint était considéré comme un échec du traitement</i>	79,7 % (63/79)	49,4 % (40/81)	30,4 %	<0,0001 ^c
[Intervalle de conf. à 95 %] ^b	[69,2 %, 88,0 %]	[38,1 %, 60,7 %]	[15,0 %, 44,1 %]	<0,0001 ^d
Réussite de la revascularisation après pose du dispositif (score TICI ≥ 2a)				
<i>Tout recours à un traitement thrombolytique intra-artériel était considéré comme un échec du traitement</i>	87,3 % (69/79)	58,0 % (47/81)	29,3 %	<0,0001 ^c
[Intervalle de conf. à 95 %] ^b	[78,0 %, 93,8 %]	[46,5 %, 68,9 %]	[15,0 %, 42,4 %]	<0,0001 ^d
Critère d'évaluation principal de la sécurité				
Événements composites	13,9 % (11/79)	23,5 % (19/81)	-9,5 % [-22,1 %, 2,8 %]	0,1567 ^e
[Intervalle de conf. à 95 %] ^b	[7,2 %, 23,6 %]	[14,8 %, 34,2 %]		
Perforation vasculaire	0,0 % (0/79)	9,9 % (8/81)	-9,9 % [-18,5 %, -3,9 %]	
Dissection artérielle intramurale	0,0 % (0/79)	1,2 % (1/81)	-1,2 % [-6,7 %, 3,5 %]	
Hémorragie intracrânienne symptomatique	5,1 % (4/79)	9,9 % (8/81)	-4,8 % [-14,1 %, 3,8 %]	
Embolisation dans un territoire précédemment épargné	7,6 % (6/79)	4,9 % (4/81)	2,7 % [-5,6 %, 11,4 %]	
Complication associée au site d'accès nécessitant une réparation chirurgicale ou une transfusion sanguine	1,3 % (1/79)	0,0 % (0/81)	1,3 % [-3,3 %, 6,9 %]	
Mortalité dans les 24 heures	1,3 % (1/79)	0,0 % (0/81)	1,3 % [-3,3 %, 6,9 %]	
Défaillance du dispositif <i>in vivo</i>	0,0 % (0/79)	0,0 % (0/81)	0,0 % [-4,6 %, 4,6 %]	
Autre EIG associé à l'acte chirurgical	0,0 % (0/79)	0,0 % (0/81)	0,0 % [-4,6 %, 4,6 %]	
Score mRS 0-2 à 90 jours	38,2 % (29/76)	17,9 % (14/78)	20,2 % [6,4 %, 34,1 %]	0,0068 ^e

a : intervalles de confiance exacts de Clopper Pearson sur les proportions individuelles ; b : intervalles de confiance exacts sur les différences de proportions, calculés avec StatXact Version 8 ; c : hypothèse de non-inériorité utilisant la méthode de Blackwelder avec marge de non-inériorité de 10 % ; d : test exact de Fisher unilatéral de la supériorité ; e : test exact de Fisher bilatéral.

GARANTIE

Stryker Neurovascular garantit que cet instrument a été conçu et fabriqué avec un soin raisonnable. **Cette garantie remplace et exclut toute autre garantie non expressément formulée dans le présent document, qu'elle soit explicite ou implicite en vertu de la loi ou de toute autre manière, y compris notamment toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.** La manipulation, le stockage, le nettoyage et la stérilisation de cet instrument ainsi que les facteurs relatifs au patient, au diagnostic, au traitement, aux procédures chirurgicales et autres domaines hors du contrôle de Stryker Neurovascular, affectent directement l'instrument et les résultats obtenus par son utilisation. Les obligations de Stryker Neurovascular selon les termes de cette garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement de cet instrument. Stryker Neurovascular ne sera en aucun cas responsable des pertes, dommages ou frais accessoires ou indirects découlant de l'utilisation de cet instrument. Stryker Neurovascular n'assume, ni n'autorise aucune tierce personne à assumer en son nom, aucune autre responsabilité ou obligation supplémentaire liée à cet instrument. **Stryker Neurovascular ne peut être tenu responsable en cas de réutilisation, de retraitement ou de restérilisation des instruments et n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, y compris notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier concernant ces instruments.**

Trevo[®] Rückholvorrichtung

Rx ONLY

Vorsicht: Laut Bundesgesetz der USA darf diese Vorrichtung ausschließlich an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

WANRHINWEIS

Der Inhalt wurde mit Ethylenoxid (EO) STERILISIERT. Bei beschädigtem sterilen Verpackungssiegel nicht verwenden. Im Falle von Beschädigungen Kontakt mit einem Vertreter von Stryker Neurovascular aufnehmen. Für den einmaligen Gebrauch. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann eine Beeinträchtigung der strukturellen Unverhältnisse der Vorrichtung und/oder ein Versagen der Vorrichtung zur Folge haben, was wiederum zu Erkrankungen, Verletzungen oder zum Tod des Patienten führen kann. Eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation der Vorrichtung erhöht ebenfalls das Kontaminationsrisiko bzw. das Risiko einer Infektion des Patienten oder einer Kreuzinfektion. Hierzu gehört u. a. die Übertragung von Infektionskrankheiten von Patient zu Patient. Eine Kontamination der Vorrichtung kann zu Verletzungen, Erkrankungen oder zum Tod des Patienten führen.

Nach dem Gebrauch das Produkt und die Verpackung gemäß den Bestimmungen des Krankenhauses, administrativen und/oder örtlichen Regelungen entsorgen.

BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG

Die Rückholvorrichtung besteht aus einem flexiblen, sich verjüngenden Kerndraht mit einem geformten Abschnitt am distalen Ende. Platinnmarkierungen am distalen Ende ermöglichen die Visualisierung bei einer Röntgendarleuchtung. Darüber hinaus ist der geformte Abschnitt auch strahlenundurchlässig. Die Abmessungen der Rückholvorrichtung sind auf dem Produktetikett angegeben. Die Rückholvorrichtung verfügt über eine hydrophile Beschichtung, um die Reibung zu reduzieren. Die Rückholvorrichtung hat eine Schafmarkierung, mit der der Abstand von der Spitze der Rückholvorrichtung bis zur Spitze des Mikrokatheters erkennbar wird. Mit der Rückholvorrichtung wird eine Drehvorrichtung bereitgestellt, um die Manipulation zu erleichtern. Mithilfe der Drehvorrichtung wird der Kerndraht während des Eingriffs am Mikrokatheter fixiert. Durch die Verankerung der Drehvorrichtung am Draht können der Mikrokatheter und die Rückholvorrichtung bei der Gerinnungsentnahme gemeinsam als System zurückgezogen werden. Es wird ein Einführungsinstrument angeboten, mit dem die Rückholvorrichtung in einem Mikrokatheter eingeführt werden kann. Das Einführungsinstrument ist eine Schleuse, in welche die Rückholvorrichtung vorgeladen wird. Sobald die Rückholvorrichtung zur Hälfte in den Mikrokatheter eingeführt ist, wird das Einführungsinstrument entfernt. Rückholvorrichtungen verfügen über ein modifiziertes proximales Ende, das ein Anbringen der DOC-Führungsdrähterverlängerung (Ref. 22260) von Abbott Vascular ermöglicht. Das Anbringen der Führungsdrähterverlängerung an der Rückholvorrichtung erleichtert das Entfernen oder den Austausch eines Katheters, während die Rückholvorrichtung an ihrer Position in der Anatomie verbleibt. Nach dem Austausch kann die Verlängerung abgetrennt werden.

Informationen für den Anwender

Die Trevo Rückholvorrichtung darf ausschließlich von Ärzten verwendet werden, die in interventionellen endovaskulären Verfahren geschult sind.

Inhalt

Eine (1) Trevo Rückholvorrichtung

Eine (1) Drehvorrichtung

Ein (1) Einführungsinstrument

Kompatibilität

Größe der Rückholvorrichtung	Trevo Pro14 Mikrokatheter	Trevo Pro18 Mikrokatheter	Excelsior [®] XT-27 [®] Mikrokatheter (150 cm x 6 cm, gerade, Ref. XT275081)	Empfohlener Mindest-Gefäßinnen-durchmesser (mm)
Trevo XP ProVue 3 x 20 mm	✓	✓		2,5
Trevo XP ProVue 4 x 20 mm		✓		
Trevo ProVue 4 x 20 mm		✓		
Trevo XP ProVue 4 x 30 mm		✓	✓	
Trevo XP ProVue 6 x 25 mm			✓	

Die Kompatibilität der Rückholvorrichtung mit anderen Mikrokathetern ist noch nicht belegt. Die Leistungsmerkmale der Rückholvorrichtung können durch Verwendung eines anderen Mikrokatheters beeinträchtigt werden.

Für das Entfernen von Thromben werden Ballon-Führungs Katheter (wie z. B. der Merci[®] Ballon-Führungs Katheter und der FlowGate[®] Ballon-Führungs Katheter) empfohlen.

Rückholvorrichtungen sind mit hämostatischen Drehventilen von Boston Scientific (Ref. 421242) kompatibel.

Rückholvorrichtungen sind mit DOC-Führungsdrähterverlängerungen (Ref. 22260) von Abbott Vascular kompatibel.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN

1. Die Trevo Rückholvorrichtung ist für die Wiederherstellung des neurovaskulären Blutflusses indiziert, indem im Rahmen der Behandlung eines akuten ischämischen Schlaganfalls Thromben entfernt werden, um die Beeinträchtigung von Patienten mit persistenter, proximal anteriorer Zirkulation, Okklusion eines großen Gefäßes und kleineren Infarktkernregionen, die zuerst intravenös einen Gewebeplasminogenaktivator (IV t-PA) erhalten haben, zu reduzieren. Die endovaskuläre Therapie mit der Vorrichtung sollte spätestens 6 Stunden nach Auftreten der Symptome erfolgen.

2. Die Trevo Rückholvorrichtung ist für die Wiederherstellung des neurovaskulären Blutflusses vorgesehen, indem bei Patienten mit einem ischämischen Schlaganfall innerhalb von 8 Stunden nach Auftreten der Symptome Thromben entfernt werden. Patienten, die sich nicht für den intravenösen Gewebeplasminogenaktivator (IV t-PA) eignen oder bei denen die IV t-PA Therapie nicht wirksam ist, sind geeignete Kandidaten für die Behandlung.

3. Die Trevo Rückholvorrichtung ist für die Wiederherstellung des neurovaskulären Blutflusses indiziert, indem im Rahmen der Behandlung eines akuten ischämischen Schlaganfalls Thromben entfernt werden, um die Beeinträchtigung von Patienten mit persistenter, proximal anteriorer Zirkulation, Okklusion eines großen Gefäßes wie der A. carotis interna (ACI) oder der M1-Segmente der A. cerebri media (ACM) mit kleineren Infarktkernregionen (0–50 cc der Altersgruppe < 80 Jahre, 0–20 cc der Altersgruppe ≥ 80 Jahre) zu reduzieren. Die endovaskuläre Therapie mit der Vorrichtung sollte innerhalb von 6–24 Stunden, nachdem es Patienten zuletzt gut ging, bei Patienten erfolgen, die sich nicht für den intravenösen Gewebeplasminogenaktivator (IV t-PA) eignen oder bei denen die IV t-PA Therapie nicht wirksam ist.

KONTRAINDIKATIONEN

Keine bekannt.

WANRHINWEISE

SPEZIELLE WANRHINWEISE FÜR INDIKATION 1

- Die Sicherheit und Wirksamkeit der Trevo Rückholvorrichtung bei der Reduzierung von Beeinträchtigungen bei Patienten mit großen Infarktkernregionen (d. h. ASPECTS ≤ 7) ist nicht belegt. Bei diesen Patienten besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko, z. B. für eine intrazerebrale Blutung.
- Die Sicherheit und Wirksamkeit der Trevo Rückholvorrichtung bei der Reduzierung von Beeinträchtigungen bei Patienten mit Okklusionen in der posterioren Zirkulation (z. B. A. basilaris oder A. vertebralis) oder mit distaleren Okklusionen in der anterioren Zirkulation sind weder belegt noch wurden sie untersucht.

SPEZIELLE WANRHINWEISE FÜR INDIKATION 2

- Um das Risiko von Gefäßschäden zu reduzieren, muss die Rückholvorrichtung an der gewünschten Freisetzungsstelle unbedingt dem Gefäßdurchmesser entsprechen.

SPEZIELLE WANRHINWEISE FÜR INDIKATION 3

- Die Sicherheit und Wirksamkeit der Trevo Rückholvorrichtung bei der Reduzierung von Beeinträchtigungen bei Patienten mit großen Infarktkernregionen (d. h. ASPECTS ≤ 7) ist nicht belegt. Bei diesen Patienten besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko, z. B. für eine intrazerebrale Blutung.
- Die Sicherheit und Wirksamkeit der Trevo Rückholvorrichtung bei der Reduzierung von Beeinträchtigungen bei Patienten mit Okklusionen in der posterioren Zirkulation (z. B. A. basilaris oder A. vertebralis) oder mit distaleren Okklusionen in der anterioren Zirkulation sind weder belegt noch wurden sie untersucht.
- Anwender sollten ihre Analysemethoden mittels Bildgebungsoftware prüfen, um stichhaltige und einheitliche Ergebnisse für die Bewertung der Größe der Kerninfarktregion zu gewährleisten.

ALLGEMEINE WANRHINWEISE FÜR ALLE INDIKATIONEN

- Die Gabe von IV t-PA sollte innerhalb des von der FDA genehmigten Zeitfensters (innerhalb von 3 Stunden nach Auftreten der Schlaganfallsymptome) erfolgen.
- Um das Risiko von Gefäßschäden zu reduzieren, sind folgende Empfehlungen zu befolgen:
 - Nicht mehr als sechs (6) Rückholversuche im selben Gefäß mit Rückholvorrichtungen durchführen.
 - Beim Entfernen oder Austauschen des Mikrokatheters die Position der Rückholvorrichtung im Gefäß beibehalten.
- Um das Risiko eines Knicks/Bruchs zu reduzieren, sind folgende Empfehlungen zu befolgen:
 - Sofort nach dem Entfernen der Rückholvorrichtung aus dem Einführungsinstrument die Spitzmarkierung des Mikrokatheters unmittelbar proximal zum geformten Abschnitt positionieren. Die Spitzmarkierung des Mikrokatheters während der Manipulation und dem Entfernen unmittelbar proximal zum geformten Abschnitt belassen.
 - Die Rückholvorrichtung nicht drehen oder verdrehen.
 - Beim Vorschieben der Rückholvorrichtung durch Arterien mit Stents ist Vorsicht geboten.

- Die Rückholvorrichtung ist ein empfindliches Instrument, das sorgfältig behandelt werden muss. Die Vorrichtung vor dem Gebrauch und nach Möglichkeit auch während des Eingriffs gründlich auf Beschädigungen untersuchen. Keine Vorrichtungen verwenden, die beschädigt sind. Schäden können die Funktionsfähigkeit der Vorrichtung einschränken und Komplikationen verursachen.
- Die Rückholvorrichtung nicht gegen Widerstand oder signifikante Vasospasmen vorschieben oder zurückziehen. Bewegen oder Torquieren der Vorrichtung gegen Widerstand oder einen signifikanten Vasospasmus kann zu einer Beschädigung von Gefäß oder Vorrichtung führen. Die Ursache des Widerstands mittels Durchleuchtung untersuchen und bei Bedarf die Vorrichtung zum Zurückziehen wieder im Einführungsinstrument positionieren.
- Wenn ein Zurückziehen der Rückholvorrichtung aus dem Gefäß schwierig ist, die Vorrichtung nicht drehen. Den Mikrokatheter distal vorschlieben, die Rückholvorrichtung vorsichtig in den Mikrokatheter zurückziehen und Rückholvorrichtung und Mikrokatheter dann gemeinsam als ein System entfernen. Wenn beim Zurückziehen der Rückholvorrichtung in den Mikrokatheter ein unverhältnismäßiger Widerstand zu spüren ist, die Verlängerung der Rückholvorrichtung mittels der DOC-Führungsdrähterverlängerung (Ref. 22260) von Abbott Vascular in Erwägung ziehen, sodass der Mikrokatheter durch einen Katheter mit größerem Durchmesser ersetzt werden kann, wie etwa dem DAC® Katheter. Die Rückholvorrichtung vorsichtig in den Katheter mit größerem Durchmesser zurückziehen.
- Thrombozytenaggregationshemmer und Antikoagulanzen gemäß den Standardrichtlinien der Einrichtung verabreichen.
- Anwender sollten alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Röntgenstrahlung für Patienten und sich selbst zu beschränken, indem sie für eine ausreichende Abschirmung sorgen, die Durchleuchtungszeiten reduzieren und nach Möglichkeit die technischen Röntgenfaktoren modifizieren.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Kühl, trocken und vor Lichteinfall geschützt aufbewahren.
- Keine offenen oder beschädigten Verpackungen verwenden.
- Bis zum Verfallsdatum aufbrauchen.
- Temperaturen von über 54 °C (130 °F) können die Vorrichtung und das Zubehör beschädigen. Keinem Autoklav-Verfahren unterziehen.
- Die Rückholvorrichtung keinen Lösungsmitteln aussetzen.
- Die Rückholvorrichtung mit Röntgendifurchleuchtung und angemessenen Antikoagulanzen verwenden.
- Um die Entstehung von Thromben und Kontrastmittelkristallen zu vermeiden, konstant eine geeignete Spülösung sowohl zwischen Führungskatheter und Mikrokatheter als auch zwischen Mikrokatheter und Rückholvorrichtung oder Führungsdrähten infundieren.
- Keine Drehvorrichtung am geformten proximalen Ende der DOC-kompatiblen Rückholvorrichtung anbringen. Andernfalls können Schäden entstehen, die die Befestigung der DOC-Führungsdrähterverlängerung unmöglich machen.

UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

Verfahren, die das perkutane Einführen von Kathetern erfordern, dürfen nur von Ärzten durchgeführt werden, die mit den möglichen Komplikationen, welche während oder nach dem Eingriff eintreten können, vertraut sind. Zu den möglichen Komplikationen gehören u. a.:

- Luftembolie
- Hämatom oder Blutungen an der Punktionsstelle
- Infektion
- Distale Embolisierung
- Schmerzen/Kopfschmerzen
- Gefäßspasmus
- Thrombose
- Dissektion
- Perforation
- Embolien
- Akute Okklusion
- Ischämie
- Intrakranielle Blutungen
- Bildung von Pseudoaneurysmen
- Neurologische Störungen, einschließlich Schlaganfall
- Tod

Die Nutzung der Vorrichtung erfordert eine Durchleuchtung, die aufgrund der damit verbundenen Röntgenstrahlung eine potenzielle Gefahr für Ärzte und Patienten darstellt. Zu den möglichen Risiken gehören u. a.:

- Alopezie
- Verbrennungen, die von Hautrötungen bis hin zu Geschwüren reichen können
- Katarakte
- Verzögerte Neoplasie

Meldung unerwünschter Ereignisse

Bitte benachrichtigen Sie sofort einen Vertreter von Stryker Neurovascular, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Komplikationen oder Verletzungen beim Patienten auftreten oder vermutet werden. Bitte bewahren Sie fehlerverdächtige Vorrichtungen und deren Komponenten und Verpackung nach Möglichkeit auf und schicken Sie sie an Stryker Neurovascular zurück.

LIEFERFORM

Produkte von Stryker Neurovascular sind steril und nicht-pyrogen, solange die Verpackung, die die Sterilität bewahren soll, nicht geöffnet wird und der Beutel mit dem Hauptprodukt ungeöffnet und unbeschädigt ist.

Bei geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Bei unvollständigem oder unleserlichem Etikett nicht verwenden.

Handhabung und Lagerung

Kühl, trocken und vor Lichteinfall geschützt aufbewahren.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Empfohlene Vorbereitung

- Verpackungshülle der Rückholvorrichtung mit Kochsalzlösung spülen. Mindestens weitere 2 Minuten hydratisieren, bevor die Rückholvorrichtung aus der Hülle entnommen wird. Rückholvorrichtung feucht halten.
- Ballon-Führungskatheter oder Führungskatheter vorbereiten und wie in der Gebrauchsanweisung des Führungskatheters beschrieben in die A. carotis interna, A. carotis communis oder A. subclavia einführen.
- Das hämostatische Drehventil mit dem Anschluss des Mikrokatheters verbinden.
- Den Mikrokatheter mit konventionellen Katheterisierungsmethoden und einem neurovaskulären Standardführungsdrähten im Zielgefäß platzieren. Die Spitze des Mikrokatheters distal zum Thrombus positionieren, sofern es die Anatomie zulässt.
- Den Führungsdräht aus dem Mikrokatheter entfernen. Kontrastmittel durch den Mikrokatheter injizieren, um das Gefäß im distalen Bereich zu visualisieren. Den Mikrokatheter spülen.
- Das Einführungsinstrument entfernen und die vorgeladene Rückholvorrichtung als Einheit aus der Verpackungshülle nehmen. Die Rückholvorrichtung nicht über die Spitze des Einführungsinstruments hinausragen lassen oder weiter in das Einführungsinstrument zurückziehen.
- Wichtig:** Das Einführungsinstrument zur Hälfte in das hämostatische Drehventil vorschlieben und mit einer Spritze oder Infusionsleitung spülen, bis die Kochsalzlösung am proximalen Ende aus dem Einführungsinstrument austritt. Wird das Einführungsinstrument nicht ordnungsgemäß gespült, kann das Vorschlieben der Rückholvorrichtung durch das Einführungsinstrument erschwert werden.
- Das Einführungsinstrument in den Anschluss des Mikrokatheters einsetzen und das hämostatische Drehventil fest schließen, um das Einführungsinstrument zu fixieren.
- Die Rückholvorrichtung vorschlieben, bis sie zur Hälfte in den Mikrokatheter eingeführt ist. Das Einführungsinstrument entfernen.

Empfohlene Vorgehensweise beim Zurückholen

- Die Rückholvorrichtung vorschlieben, bis die distalen Spitzen von Rückholvorrichtung und Mikrokatheter aneinander ausgerichtet sind.

Hinweis: Die folgende Tabelle gibt an, wo sich die Spitze der Rückholvorrichtung (das distale Ende der Rückholvorrichtung) in Relation zur Spitze des Mikrokatheters (dem distalen Ende des Mikrokatheters) befindet, wenn:

- das distale Ende der Rückholvorrichtungs-Schaftmarkierung den Anschluss des Mikrokatheters erreicht **oder**
- das proximale Ende der Rückholvorrichtungs-Schaftmarkierung das proximale Ende des hämostatischen Drehventils erreicht

Tabelle für die Überwachung des distalen Endes

Trevo® ProVue 4 x 20 mm Trevo XP 4 x 20 mm Trevo XP 6 x 25 mm	• Innerhalb von 8 cm vom Austreten aus der Mikrokatherespitze
Trevo XP 3 x 20 mm	• Innerhalb von 15 cm vom Austreten aus der Mikrokatherespitze
Trevo XP 4 x 30 mm	Bei Verwendung mit Trevo Pro 18 MC (90238): • Innerhalb von 8 cm vom Austreten aus der Mikrokatherespitze Bei Verwendung mit Excelsior® XT-27® MC (XT275081): • Innerhalb von 15 cm vom Austreten aus der Mikrokatherespitze

- Den Mikrokatheter zurückziehen, während die Rückholvorrichtung vorsichtig vorgeschoben und mit dem geformten Abschnitt im Gerinnel platziert wird. Die Spitzenmarkierung des Mikrokatheters unmittelbar proximal zum geformten Abschnitt der Rückholvorrichtung positionieren.

WARNHINWEIS: Um das Risiko eines Knicks/Bruchs zu reduzieren, die Spitzenmarkierung des Mikrokatheters während der Manipulation und dem Entfernen unmittelbar proximal zum geformten Abschnitt belassen.

3. Nach dem Freisetzen der Rückholvorrichtung die Strebenausdehnung visualisieren und dem Gerinnsel ausreichend Zeit lassen (ca. 5 Minuten), um sich in die Rückholvorrichtung zu integrieren.
4. Bei einem Ballon-Führungs Katheter den Ballon wie in der Gebrauchsanweisung des Ballon-Führungs Katheters beschrieben aufdehnen, um das Gefäß zu verschließen.
5. Die Drehvorrichtung am Mikrokatheteranschluss der Rückholvorrichtung positionieren und fixieren.
6. Rückholvorrichtung und Mikrokatheter langsam als Einheit in die Spitze des Ballon-Führungs Katheters zurückziehen, während der Ballon-Führungs Katheter mit einer 60-mL-Spritze aufgedehnt wird.
7. Den Ballon-Führungs Katheter mit der 60-mL-Spritze ausreichend aufdehnen und Rückholvorrichtung und Mikrokatheter in den Führungskatheter zurückziehen. Die Aspiration beibehalten, bis die Rückholvorrichtung und der Mikrokatheter fast aus dem Katheter zurückgezogen sind.

Hinweis: Wenn sich das Zurückziehen in den Ballon-Führungs Katheter oder Führungskatheter schwierig gestaltet, den Ballon entleeren und gleichzeitig Führungskatheter, Mikrokatheter und Rückholvorrichtung als Einheit durch das Einführungsinstrument zurückziehen. Das Einführungsinstrument bei Bedarf entfernen.

8. Den Ballon des Ballon-Führungs Katheters entleeren.
9. Das hämostatische Drehventil von Ballon-Führungs Katheter entfernen und Rückholvorrichtung, Mikrokatheter und hämostatisches Drehventil als Einheit ganz aus dem Führungskatheter herausziehen.
10. Eine 60-mL-Spritze am Anschluss des Ballon-Führungs Katheters anbringen und aspirieren.
11. Die Vorrichtung mit Kochsalzlösung reinigen. Die Rückholvorrichtung auf Beschädigungen untersuchen. Die Rückholvorrichtung nicht wieder verwenden, wenn Kerndraht, geformter Abschnitt oder Platinspirale anders aussehen als beim ersten Entnehmen aus der Verpackung. Wenn keine Beschädigung vorliegt, kann die Rückholvorrichtung für bis zu drei (3) Rückholversuche eingesetzt werden. Ein Rückholversuch besteht aus einem (1) Vorschiebe- und kompletten Rückziehzyklus.

Empfohlener Austausch des Katheters

1. Die Gebrauchsanweisung für die DDC-Führungsdrähte Verlängerung von Abbott Vascular befolgen, mit der Ausnahme, dass die Rückholvorrichtung dort als Führungsdrähte bezeichnet wird.

KLINISCHE STUDIEN

Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit

DAWN™ Studie zur Unterstützung von Indikation 3

DAWN (DWI- und CTP-Bewertung mit klinischer Inkongruenz bei der Sichtung von den einer Neurointervention unterzogenen Aufwach- und spät präsentierenden Schlaganfällen) war eine prospektive, randomisierte, multizentrische, kontrollierte klinische Prüfung zur Bewertung der Hypothese, dass eine Thrombektomie mittels Trevo® Rückholvorrichtung plus medizinische Versorgung nach 90 Tagen zu besseren klinischen Ergebnissen im Vergleich zur medizinischen Versorgung allein führt, und zwar bei entsprechend ausgewählten Studienteilnehmern, die einen akuten ischämischen Schlaganfall erleiden, und wenn die Behandlung innerhalb von 6–24 Stunden, nachdem es ihnen zuletzt gut ging, begonnen wird. Es wurden insgesamt 206 Studienteilnehmer an 26 Prüfstellen aufgenommen: 107 Teilnehmer (51,9 %) wurden im Behandlungsbarm und 99 Teilnehmer (48,1 %) im Kontrollarm randomisiert. Die mittleren UW-mRS-Werte nach 90 Tagen betragen 5,5 im Behandlungsbarm und 3,4 im Kontrollarm. Die bereinigte Kerninfarkt-Differenz der Gruppen im folgendewichteten Grad der Beeinträchtigung betrug 2,0 (95 % Bayessches Glaubwürdigkeitsintervall, 1,1 bis 3,0, posteriore Wahrscheinlichkeit der Überlegenheit > 0,9999). Die Behandlung mit der Trevo Rückholvorrichtung führte zu höheren Raten der funktionalen Unabhängigkeit (mRS 0–2) nach 90 Tagen, 48,6 % vs. 13,1 %; die bereinigte Kerninfarkt-Differenz der Gruppen betrug 32,8 % (95 % Glaubwürdigkeitsintervall, 21,1 % bis 44,1 %, posteriore Wahrscheinlichkeit der Überlegenheit > 0,9999). Die Rate der symptomatischen intrakraniellen Blutungen nach 24 Stunden war bei Patienten mit einer endovaskulären Therapie höher. Patienten und/oder ihre gesetzlich autorisierten Vertreter sollten während der Behandlungsentscheidungsphase auf dieses Risiko hingewiesen werden. Es besteht eine größere Ungewissheit in den Ergebnissen bei Teilnehmern im 18–24-Stunden-Zeitraum ab dem Zeitpunkt, an dem es ihnen zuletzt gut ging.

Hauptausschlusskriterien

Akuter ischämischer Schlaganfall mit bestätigter Okklusion der intrakraniellen ACI und/oder M1, der für IV t-PA fehlschlug oder kontraindiziert war, Behandlung innerhalb von 6–24 Stunden, nachdem es dem Patienten zuletzt gut ging, Baseline NIHSS ≥ 10, Einverständniserklärung erteilt und mindestens 18 Jahre alt. Bei Patienten, die jünger als 80 Jahre sind, muss ein Schlaganfall-Score von größer gleich 10 bei einem Kernvolumen von weniger als 51 ml zugeordnet werden. Bei Patienten, die mindestens 80 Jahre alt sind, muss der Schlaganfall-Score größer als 10 sein und das Volumen weniger als 21 ml betragen. Klinische Kernendifferenz, die als der Unterschied zwischen dem Baseline-Infarktvolumen (oder Kern) auf dem CT- oder MRT-Bild und dem insgesamt gefährdeten Hirngewebe definiert wird. Das Infarktvolumen wurde mithilfe einer diffusionsgewichteten Magnetresonanzbildgebung (MRT) oder einem Perfusions-CT beurteilt und mit einem der kommerziell erhältlichen automatisierten Software-Pakete (RAPID, IschemiaView) gemessen.

Hauptausschlusskriterien

Schnelle Verbesserung des neurologischen Status auf NIHSS < 10 oder Nachweis der Gefäßrekanalisation vor der Randomisierung; arterieller Blutdruck > 185/110 mmHg; Labornachweis des Elektrolytungleichgewichts (d. h. Natrium < 130 mmol/L, Kalium < 3 mEq/l oder > 6 mEq/l); Labornachweis von Nierenversagen (d. h. Serumkreatinin > 3,0 mg/dL (264 µmol/l); Labornachweis von Koagulationsanomalien (d. h. Thrombozytenzahl < 50.000/µL, APTT > 3 Mal normal oder INR > 3,0, bei Gabe eines Faktor-Xa-Hemmers 24–48 Stunden zuvor muss PTT normal sein); Labornachweis von Blutungen (d. h. Hämoglobin < 7 mmol/L).

Der primäre Endpunkt war eine 90-Tage-Beeinträchtigung bewertet gemäß modifizierter Rankin-Skala (mRS). Das sekundäre Studienziel umfasst die Erbringung des Nachweises, dass endovaskuläre Reperfusions mit der Trevo Rückholvorrichtung 24 (-6/+24) Stunden nach der Randomisierung mit einer erheblichen Reduktion der medianen Infarktgröße im Vergleich zur Kontrollgruppe verbunden ist. Die sekundären Endpunkte beinhalten einen Anteil an Studienteilnehmern mit guten funktionellen Ergebnissen nach 90 Tagen (mRS von 0–2), einen Anteil an Teilnehmern mit einem NIHSS-Abfall um ≥ 10 Punkte seit der Baseline oder einem NIHSS-Score von 0 oder 1, einem Unterschied zwischen Behandlungs- und Kontrollarm in der Mortalität für alle Ursachen, einem Unterschied in der medianen endgültigen Infarktgröße nach 24 Stunden, einem Unterschied in den Revaskularisierungsraten nach 24 Stunden und einer Reperfusionsrate auf TICI > 2b.

Die Sicherheitsergebnisse umfassen die Incidenz der schlaganfallbedingten Mortalität nach 90 Tagen, die Incidenz von SICH, neurologische Verschlechterung sowie eingriffs- und vorrichtungsbedingte schwerwiegende unerwünschte Ereignisse.

90-Tage-Score auf der modifizierten Rankin-Skala, ITT-Patientengruppe

Modifizierte Rankin-Skala (mRS)	Behandlungsbarm N=107	Kontrollarm N=99
0 - Keine Symptome / UW = 10	9,3 % (10/107)	4,0 % (4/99)
1 - Keine signifikante Beeinträchtigung / UW = 9,1	22,4 % (24/107)	5,1 % (5/99)
2 - Leichte Beeinträchtigung / UW = 7,6	16,8 % (18/107)	4,0 % (4/99)
3 - Moderate Beeinträchtigung / UW = 6,5	13,1 % (14/107)	16,2 % (16/99)
4 - Mittelschwere Beeinträchtigung / UW = 3,3	13,1 % (14/107)	34,3 % (34/99)
5 - Schwere Beeinträchtigung / UW = 0	6,5 % (7/107)	18,2 % (18/99)
6 - Tot / UW = 0	18,7 % (20/107)	18,2 % (18/99)
90 Tage mRS [0-2]	48,6 % (52/107)	13,1 % (13/99)
90 Tage gewichtete mRS*		
Mittelwert ± SA (N)	5,5 ± 3,8 (107)	3,4 ± 3,2 (99)
Median (Q1, Q3)	6,5 (0,0; 9,1)	3,3 (0,0; 6,5)
Bereich (Minimum, Maximum)	(0,0; 10,0)	(0,0; 10,0)
[95 % Konf.-Intervall] ^h	[4,8; 6,3]	[2,7; 4,0]

*Durch normale Approximation

*mRS = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} wurde ein entsprechender numerischer Wert zugeordnet = (10; 9,1; 7,6; 6,5; 3,3; 0,0), der ihren klinischen Nutzen repräsentiert

Weitere primäre Ergebnisse, ITT-Patientengruppe

Ergebnis	Intervention (N=107)	Kontrollarm (N=99)	Mittlere absolute Differenz (95 % KI)	Posteriorer mittlerer Nutzen, kernbereinigt (95 % Glaubwürdigkeits- intervall)*	Wahrschein- lichkeit der Überlegenheit
Nutzengewichtetes mRS-Mittel (SA)	5,5 (3,8)	3,4 (3,1)	2,1 (1,2; 3,1)	2,0 (1,1; 3,0)	> 0,9999 ⁱ
Funktionelle Unabhängigkeit (mRS 0-2)	48,6 %	13,1 %	35,5 % (23,9 %; 47,0 %)	32,8 % (21,1 %; 44,1 %)	> 0,9999

*Geschätzt anhand des Bayessischen linearen Modells, bereinigt für Kerninfarkt

ⁱDie Gesamtwahrscheinlichkeit des Nutzens einer Vorrichtung ist dann der Durchschnitt der Nutzenwahrscheinlichkeiten für die unterstellten Datensätze, gewichtet nach den Anrechnungswahrscheinlichkeiten dieser Datensätze. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt 0,999986.

Der zweite sekundäre Wirksamkeitsendpunkt war der NIHSS-Abfall von ≥ 10 Punkten zur Baseline bzw. ein NIHSS-Score von 0 oder 1.

Frühes neurologisches Ansprechen nach Tag 5–7/Entlassung

Ergebnis	Intervention N=107	Kontrollarm N=99	Mittlere absolute Differenz (95 % KI)	Risikoquote (95 % KI)	p-Wert
Frühes Ansprechen	47,7 %	19,2 %	28,5 % (16,2 %; 40,7 %)	2,5 (1,6; 3,9)	< 0,001

^jDefiniert als NIHSS-Abfall von ≥ 10 Punkten zur Baseline bzw. NIHSS-Score von 0 oder 1 nach Tag 5–7 oder Entlassung (je nachdem, was früher eintritt). Der p-Wert wurde nicht an die Vielfalt angepasst.

Der sekundäre Wirksamkeitsnachweis waren die Revaskularisierungsraten nach 24 Stunden, definiert als das Vorhandensein einer teilweisen oder vollständigen Rekanalisation.

Revaskularisierungsraten nach 24 Stunden

	Insgesamt N=206	Behandlungsarm N=107	Kontrollarm N=99	Differenz [95 % KI] ^a	p-Wert
Differenz bei den Revaskularisierungsraten 24 (-6/+24) Stunden nach der Randomisierung	58,7 % (121/206)	76,6 % (82/107)	38,4 % (38/99)	40,2 % [27,1 %, 51,5 %]	<0,0001 ^a

Die Revaskularisierung nach 24 Stunden war als das Vorhandensein einer teilweisen oder vollständigen Rekanalisation definiert.

a. T-Test. Der p-Wert wurde nicht an die Vielfalt angepasst.

Der primäre Sicherheitspunkt war die Inzidenz einer schlaganfallbedingten Sterblichkeit nach 90 Tagen. Die sekundären Sicherheitsergebnisse für den Behandlungs- und den Kontrollarm sind die Inzidenz von SICH, gemäß ECASS-Definition, innerhalb von 24 (-6/+24) Stunden nach der Randomisierung (Zeitpunkt Null), und die Inzidenz der neurologischen Verschlechterung vom NIHSS-Score bei Baseline bis Tag 5–7/Entlassung (je nachdem, was zuerst eintritt) nach der Randomisierung. Neurologische Verschlechterung war als eine Erhöhung des NIHSS-Score von ≥ 4 Punkten vom Baseline-Score definiert.

Schlaganfallbedingte Mortalität nach 90 Tagen

	Insgesamt N=206	Behandlungsarm N=107	Kontrollarm N=99	Differenz [95 % KI] ^b	p-Wert
Inzidenz der gesamten schlaganfallbedingten Mortalität nach 90 Tagen	17,0 % (35/206)	15,9 % (17/107)	18,2 % (18/99)	-2,3 % [-12,6 %, 8,0 %]	0,7126 ^a

^bDurch normale Approximation

a. T-Test. Der p-Wert wurde nicht an die Vielfalt angepasst.

Das sekundäre Sicherheitsergebnis war die Inzidenz von SICH, gemäß ECASS-III-Definition, innerhalb von 24 (-6/+24) Stunden nach der Randomisierung (Zeitpunkt Null).

Inzidenz von SICH durch CEC-Adjudizierung

	Insgesamt N=206	Behandlungsarm N=107	Kontrollarm N=99	Differenz [95 % KI] ^b	p-Wert
SICH 24 (-6/+24) h nach der Randomisierung	4,4 % (9/206)	5,6 % (6/107)	3,0 % (3/99)	2,6 % [-2,9 %, 8,1 %]	0,5011 ^a

^bDurch normale Approximation

a. Exakter Test nach Fisher. Der p-Wert wurde nicht an die Vielfalt angepasst.

Inzidenz der neurologischen Verschlechterung war als eine Erhöhung des NIHSS-Score um ≥ 4 Punkte ab der Baseline bis Tag 5–7/Entlassung nach der Randomisierung (Zeitpunkt Null) definiert.

Inzidenz der neurologischen Verschlechterung durch CEC-Adjudizierung

	Insgesamt N=206	Behandlungsarm N=107	Kontrollarm N=99	Differenz [95 % KI] ^b	p-Wert
Inzidenz der neurologischen Verschlechterung zwischen Baseline und Tag 5 bis 7/Entlassung	19,9 % (41/206)	14,0 % (15/107)	26,3 % (26/99)	-12,2 % [-23,1 %, -1,4 %]	0,0358 ^a

^bDurch normale Approximation

a. T-Test. Der p-Wert wurde nicht an die Vielfalt angepasst.


Funktionelle Unabhängigkeit (90 Tage mRS 0–2) Untergruppe nach Zeit

TLSW-Intervalle	Behandlungsarm	Kontrollarm	Differenz	p-Wert
6–9 h	50,0 % (9/18)	14,3 % (3/21)	35,7 % [8,2 %, 63,2 %]	0,0346 ^a
9–12 h	58,1 % (18/31)	26,1 % (6/24)	33,1 % [8,5 %, 57,6 %]	0,0273 ^a
6–12 h insgesamt	55,1 % (27/49)	20,0 % (9/45)	35,1 % [16,9 %, 53,3 %]	0,0006^a
12–15 h	37,5 % (6/16)	9,1 % (2/22)	28,4 % [1,8 %, 55,0 %]	0,0498 ^a
15–18 h	50,0 % (13/26)	5,3 % (1/19)	44,7 % [23,1 %, 66,4 %]	0,0025 ^a
18–21 h	36,4 % (4/11)	0,0 % (0/8)	36,4 % [7,9 %, 64,8 %]	0,1032 ^a
21–24 h	40,0 % (2/5)	20,0 % (1/5)	20,0 % [-35,4 %, 75,4 %]	1,0000 ^a
12–24 insgesamt*	43,1 % (25/58)	7,4 % (4/54)	35,7 % [21,2 %, 50,2 %]	< 0,0001^a

a. Exakter Test nach Fisher.

* Größere Ungewissheit in den Ergebnissen bei Teilnehmern im 18–24-Stunden-Zeitraum nach dem Zeitpunkt, an dem es ihnen zuletzt gut ging.

Der p-Wert wurde nicht an die Vielfalt angepasst.

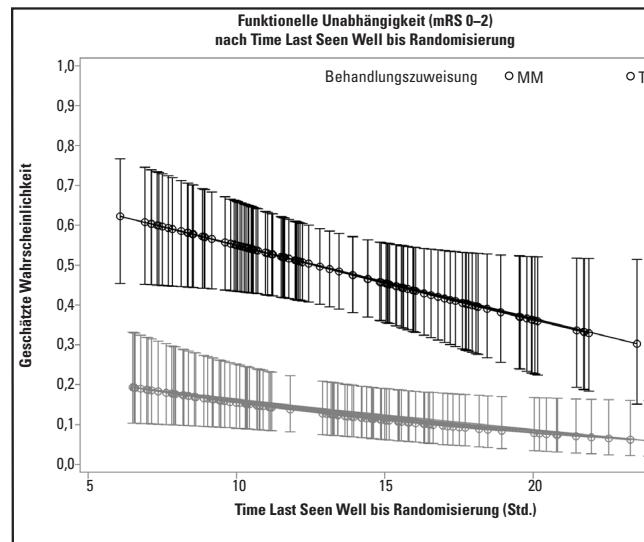

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über alle schwerwiegenden und nicht schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei allen Teilnehmern im Kontrollarm und im Behandlungsarm gemäß der Systemorganklassen des medizinischen Wörterbuchs für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung (MedDRA).

MedDRA* Systemorganklasse	Behandlungsarm N=107						Kontrollarm N=99					
	SUEs	Studienteilnehmer mit SUEs	Nicht-SUEs	Studienteilnehmer mit Nicht-SUEs	UEs insgesamt	Studienteilnehmer mit UEs insgesamt	SUEs	Studienteilnehmer mit SUEs	Nicht-SUEs	Studienteilnehmer mit Nicht-SUEs	UEs insgesamt	Studienteilnehmer mit UEs insgesamt
Jedes unerwünschte Ereignis (UE)	65	41 (38,3 %)	476	102 (95,3 %)	541	103 (96,3 %)	83	47 (47,5 %)	473	91 (91,9 %)	556	91 (91,9 %)
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems	0	0	11	10 (9,3 %)	11	10 (9,3 %)	1	1 (1,0 %)	8	8 (8,1 %)	9	8 (8,1 %)
Herzerkrankungen	8	7 (6,5 %)	37	29 (27,1 %)	45	33 (30,8 %)	6	5 (5,1 %)	29	24 (24,2 %)	35	28 (28,3 %)
Endokrine Erkrankungen	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	0	0	0	0
Augenerkrankungen	1	1 (0,9 %)	0	0	1	1 (0,9 %)	0	0	2	2 (2,0 %)	2	2 (2,0 %)
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	7	6 (5,6 %)	42	30 (28,0 %)	49	34 (31,8 %)	12	11 (11,1 %)	38	28 (28,3 %)	50	34 (34,3 %)
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort	0	0	22	18 (16,8 %)	22	18 (16,8 %)	0	0	17	15 (15,2 %)	17	15 (15,2 %)
Leber- und Gallenerkrankungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0 %)	1	1 (1,0 %)
Erkrankungen des Immunsystems	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0 %)	1	1 (1,0 %)
Infektionen und parasitäre Erkrankungen	6	6 (5,6 %)	46	34 (31,8 %)	52	38 (35,5 %)	7	7 (7,1 %)	54	41 (41,4 %)	61	43 (43,4 %)
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen	2	2 (1,9 %)	8	7 (6,5 %)	10	9 (8,4 %)	2	2 (2,0 %)	8	6 (6,1 %)	10	7 (7,1 %)
Untersuchungen	0	0	5	5 (4,7 %)	5	5 (4,7 %)	0	0	10	10 (10,1 %)	10	10 (10,1 %)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	0	0	76	47 (43,9 %)	76	47 (43,9 %)	0	0	62	34 (34,3 %)	62	34 (34,3 %)
Erkrankung des Bewegungsapparates und Bindegewebes	0	0	11	10 (9,3 %)	11	10 (9,3 %)	2	2 (2,0 %)	22	15 (15,2 %)	24	16 (16,2 %)
Gutartige, bösartige und unspezifische Neubildungen	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	0	0	0	0
Erkrankungen des Nervensystems	21	21 (19,6 %)	95	63 (58,9 %)	116	71 (66,4 %)	34	30 (30,3 %)	88	53 (53,5 %)	122	66 (66,7 %)
Psychiatrische Erkrankungen	1	1 (0,9 %)	26	24 (22,4 %)	27	24 (22,4 %)	2	2 (2,0 %)	30	27 (27,3 %)	32	28 (28,3 %)
Erkrankungen der Nieren und Harnwege	0	0	18	15 (14,0 %)	18	15 (14,0 %)	1	1 (1,0 %)	19	14 (14,1 %)	20	15 (15,2 %)
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brust	0	0	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	0	0	2	2 (2,0 %)	2	2 (2,0 %)
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums	14	11 (10,3 %)	33	28 (26,2 %)	47	33 (30,8 %)	11	9 (9,1 %)	42	34 (34,3 %)	53	37 (37,4 %)
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0	0	3	3 (2,8 %)	3	3 (2,8 %)	0	0	10	7 (7,1 %)	10	7 (7,1 %)
Chirurgische und medizinische Eingriffe	1	1 (0,9 %)	1	1 (0,9 %)	2	2 (1,9 %)	1	1 (1,0 %)	2	2 (2,0 %)	3	3 (3,0 %)
Gefäßerkrankungen	4	3 (2,8 %)	39	33 (30,8 %)	43	34 (31,8 %)	4	4 (4,0 %)	28	21 (21,2 %)	32	23 (23,2 %)

*Es wurde MedDRA v17.0 verwendet.

MR CLEAN Studie zur Unterstützung von Indikation 1

MR CLEAN war eine große, prospektive, randomisierte Open-Label-Multicenter-Studie, an der alle endovaskulären Krankenhauszentren in den Niederlanden teilnahmen. Eine intraarterielle Behandlung plus die übliche Versorgung (zu der die intravenöse Gabe von IV t-PA gehören könnte) wurde mit der gängigen Versorgung allein (Kontrollgruppe) verglichen, und zwar bei Patienten mit akutem ischämischen Schlaganfall und einer proximalen intrakraniellen Arterienokklusion der anterioren Zirkulation, die anhand von Gefäßbildung bestätigt wurde. MR CLEAN randomisierte 500 Patienten (233 im Behandlungsarm [„IAT“], 267 im Kontrollarm) in 16 medizinischen Zentren. Rückholbare Stents (einschließlich der Trevo® Retriever Produktfamilie) wurden bei 190 der 233 Patienten (81,5 %) des IAT-Arms verwendet, von denen 120/190 Teilnehmer primär eine intraarterielle Behandlung mit einer Trevo Rückholvorrichtung erhielten und 104/120 erhielten IV t-PA innerhalb von 3 Stunden nach Einsetzen der Symptome im Vergleich zur gesamten MR CLEAN Medical Management (MM) Kontrollgruppe, in der 224 von 249 Patienten mit IV t-PA gemäß dem FDA-Protokoll behandelt wurden. Von den 120 Studienteilnehmern, die primär eine intraarterielle Behandlung mit einer Trevo Rückholvorrichtung erhielten, hatten 24 gleichzeitig einen Carotis-Stent. Diese Teilnehmer wurden von der Wirksamkeitsübersicht unten ausgeschlossen, was zu einer primären Wirksamkeitsgruppe von 96 mit der Trevo Rückholvorrichtung behandelten Teilnehmern führte. Studienteilnehmer, die IA-Lytika oder andere mechanische Thrombektomie-Geräte nach der Trevo Rückholvorrichtung verwenden, wurden in den Wirksamkeitsübersichten unten als fehlgeschlagene Behandlungen gezählt.

Haupt einschlusskriterien für MR CLEAN

Akuter ischämischer Schlaganfall mit bestätigter Okklusion von ACI, M1, M2, A1 oder A2, Behandlung innerhalb von 6 Stunden nach Auftreten der Symptome und einem NIHSS > 2, CT- oder MRT-Scan schließt eine intrakranielle Blutung aus; Einverständnisserklärung erteilt; und mindestens 18 Jahre alt.

Haupt einschlusskriterien für Teilgruppe mit Trevo Rückholvorrichtung

Zusätzliche Hauteinklusskriterien für die Analyse der Teilgruppe mit Trevo Rückholvorrichtung (FDA-Gruppe) von MR CLEAN: primäre Behandlung mit Trevo Rückholvorrichtung und IV t-PA-Behandlung innerhalb von 3 Stunden nach Auftreten der Symptome.

Hauptausschlusskriterien für MR CLEAN

Arterieller Blutdruck > 185/110 mmHg; Blutzucker < 2,7 oder > 22,2 mmol/L; intravenöse Behandlung mit Thrombolytika mit einer Dosis größer als 0,9 mg/kg Alteplase oder 90 mg; intravenöse Behandlung mit Thrombolytika trotz Kontraindikationen (d.h. größere Operation, gastrointestinale Blutung oder Blutung im Harnweg innerhalb der letzten 2 Wochen oder arterielle Punktur an einer nicht komprimierbaren Stelle innerhalb der letzten 7 Tage; zerebraler Infarkt in der Verteilung der relevanten okkludierten Arterie innerhalb der letzten 6 Wochen; Labornachweis von Koagulationsanomalien (d.h. Thrombozytenzahl < 40 × 10⁹/L, APTT > 50 s oder INR > 3,0).

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt lag im Nachweis, dass bei geeigneten Teilnehmern mit akutem ischämischen Schlaganfall eine Thrombektomie mittels Trevo Rückholvorrichtung plus MM nach 90 Tagen zu einer überlegenen funktionellen Unabhängigkeit (mRS < 3) führt im Vergleich zu MM allein. Auf Grundlage der Analyse führte die IAT-Behandlung mit der Trevo Rückholvorrichtung zu einer höchst signifikanten Behandlungswirkung, wenn sie an Prüfzentren, IV t-PA Gebrauch und den Baseline-NIHSS angepasst wurde.

Primärer Wirksamkeitsendpunkt

Variable	Quotient für binäre Variablen	Quotenverhältnis [95 % KI]	p-Wert
Trevo® ohne gleichzeitigen Carotis-Stent	Trevo vs. MM	1,88 [1,07; 3,29]	0,014 ¹
IV t-PA	Ja vs. Nein	1,45 [0,60; 3,52]	0,4134 ²
NIHSS	> 14 oder ≤ 14	0,41 [0,24; 0,69]	0,0010 ²

¹Einseitiger T-Test.²Zweiseitiger T-Test.**Verteilung der 90-Tage-mRS***

mRS	Trevo ohne gleichzeitigen Carotis-Stent (N=96)	90 TAGE Mr Clean/Kontrollarm (N=249)
0	4,2 % (4/96)	0,4 % (1/249)
1	8,3 % (8/96)	5,2 % (13/249)
2	17,7 % (17/96)	13,7 % (34/249)
3	15,6 % (15/96)	16,5 % (41/249)
4	32,3 % (31/96)	31,3 % (78/249)
5	7,3 % (7/96)	10,4 % (26/249)
6	14,6 % (14/96)	22,5 % (56/249)
mRS [0, < 3] wobei jede IA-Lytika-Gabe als fehlgeschlagene Behandlung angesehen wird*	29,2 % (28/96)	19,3 % (48/249)

¹1 Teilnehmer mit IA-Lytika-Gabe wurde als eine fehlgeschlagene Behandlung gezählt.²Teilnehmer in beiden Armen erhielten IV tPA innerhalb von 3 Stunden (81 von 96 Teilnehmern in der Gruppe mit der Trevo Rückholvorrichtung und 224 von 249 Teilnehmern im Arm mit medizinischer Versorgung).

Die Analyse des primären Sicherheitsziels wurde als die Mortalitätsrate für alle Ursachen zwischen der Trevo Rückholvorrichtung plus medizinische Versorgung im Vergleich zur Mortalitätsrate für alle Ursachen in der Kontrollgruppe mit ausschließlicher medizinischer Versorgung definiert.

	Trevo FDA-Gruppe % (x/n) (LCL, UCL) ¹	MM % (x/n) (LCL, UCL) ¹
Mortalität nach 90 Tagen	13,33 (16/120) (7,82; 20,75)	22,89 (57/249) (17,82; 28,62)

¹Zweiseitige exakte 95%-Konfidenzintervalle gem. Clopper-Pearson.

Der erste sekundäre Wirksamkeitsendpunkt war der Prozentsatz an Patienten ohne intrakranielle Okklusion, übereinstimmend von bis zu drei Lesern nach 24 Stunden beurteilt. Der Endpunkt wurde durch CTA MRA mit der Arterial Occlusive Lesion (AOL) Skala beurteilt.

	Trevo ohne gleichzeitigen Carotis-Stent % (x/N) (LCL, UCL) ²	MM % (x/N) (LCL, UCL) ²
Okkusionsfrei (24 Stunden)	77,5 % (62/80) (66,8; 86,1)	33,51 (65/194) (26,90; 40,62)

¹Studienteilnehmer ohne CTA MRA nach 24 Stunden wurden von dieser Analyse ausgeschlossen²Zweiseitige exakte 95%-Konfidenzintervalle gem. Clopper-Pearson.

Der zweite sekundäre Wirksamkeitsendpunkt ist der Prozentsatz an mit der Trevo Rückholvorrichtung behandelten Patienten, die eine Rekanalisation erreichten (TICI 2a oder besser). Dieser Endpunkt wurde auch durch eine übereinstimmende Beurteilung von mindestens drei Lesern gestützt.

	Trevo ohne gleichzeitigen Carotis-Stent % (x/n) (LCL, UCL) ¹
Erfolgreiche Revaskularisierung (TICI ≥ 2a)	81,3 % (78/96) (72,0; 88,5)

¹Zweiseitige exakte 95%-Konfidenzintervalle gem. Clopper-Pearson.

Der dritte Wirksamkeitsendpunkt wurde als der Unterschied in den neurologischen Ergebnissen definiert, beurteilt durch NIHSS 24 Stunden und 5–7 Tage nach der Randomisierung zwischen Trevo Rückholvorrichtung plus medizinischer Versorgung im Vergleich zur MM-Kontrollgruppe.

NIHSS	Trevo ohne gleichzeitigen Carotis-Stent Mittelwert ± SA (N) Median (Min, Max) (LCL, UCL) ²	MM Mittelwert ± SA (N) Median (Min, Max) (LCL, UCL) ²
NIHSS (24 Stunden)	14,23 ± 9,23 (96) 14,00 (1, 42) (12,36; 16,10)	16,19 ± 7,77 (240) 16 (0, 42) (15,20; 17,18)
NIHSS (5–7 Tage) ¹	13,02 ± 12,16 (94) 12,00 (0, 42) (10,53; 15,51)	15,76 ± 11,49 (237) 15 (0, 42) (14,29; 17,23)

¹Studienteilnehmer ohne NIHSS wurden von dieser Analyse ausgeschlossen. Teilnehmer, die vor der Entlassung verschieden, erhielten einen NIHSS-Wert von 42.²Zweiseitige 95%-Konfidenzgrenzen durch normale Approximation.

Die folgende Tabelle fasst alle unerwünschten Ereignisse über einen Zeitraum von 90 Tagen nach der Randomisierung für die Teilnehmergruppe mit der Trevo Rückholvorrichtung unter Zuhilfenahme der MR CLEAN Studieneinteilung zusammen. Bei allen Sicherheitsanalysen werden alle mit der Trevo Rückholvorrichtung behandelten Studienteilnehmer mit und ohne Carotis-Stent eingeschlossen.

MR CLEAN Klasse	Trevo FDA-Gruppe 120 Teilnehmer mit 189 Ereignissen % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Anzahl an Ereignissen	MM 249 Teilnehmer mit 331 Ereignissen % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Anzahl an Ereignissen
Ischämischer Schlaganfall	2,5 % (3/120) [0,5 %, 7,1 %] 3	0,8 % (2/249) [0,1 %, 2,9 %] 2
Symptomatische intrakranielle Blutungen	7,5 % (9/120) [3,5 %, 13,8 %] 9	6,8 % (17/249) [4,0 %, 10,7 %] 17
Extrakranielle Blutungen	2,5 % (3/120) [0,5 %, 7,1 %] 3	4,4 % (11/249) [2,2 %, 7,8 %] 11
Kardiale Ischämie	0	2,0 % (5/249) [0,7 %, 4,6 %] 5
Allergische Reaktion	1,7 % (2/120) [0,2 %, 5,9 %] 2	0,4 % (1/249) [0,0 %, 2,2 %] 1
Lungenentzündung	18,3 % (22/120) [11,9 %, 26,4 %] 24	19,3 % (48/249) [14,6 %, 24,7 %] 52
Sonstige Infektionen	23,3 % (28/120) [16,1 %, 31,9 %] 34	13,7 % (34/249) [9,6 %, 18,6 %] 41
Sonstige Komplikationen	47,5 % (57/120) [38,3 %, 56,8 %] 89	38,6 % (96/249) [32,5 %, 44,9 %] 154
Fortschreiten des Schlaganfalls	20,8 % (25/120) [14,0 %, 29,2 %] 25	18,9 % (47/249) [14,2 %, 24,3 %] 48

¹Zweiseitige exakte 95%-Konfidenzintervalle gem. Clopper-Pearson

Die folgende Tabelle fasst alle unerwünschten Ereignisse bei MR CLEAN über einen Zeitraum von 90 Tagen nach der Randomisierung für die FDA-Gruppe unter Zuhilfenahme der MeDRA-Codierung zusammen.

MR CLEAN MeDRA v18.0 codierte unerwünschte Ereignisse für die FDA-Gruppe mit einer Häufigkeit von mehr als 1 %

In MedDRA bevorzugter Begriff	Trevo® FDA-Gruppe (N=120) Patienten mit Ereignissen (%)	Kontrollgruppe (N=249) Patienten mit Ereignissen (%)
Schlaganfall in der Entwicklung	19 (15,8 %)	41 (16,5 %)
Intrakranielle Blutung	13 (10,8 %)	20 (8,0 %)
Infektion der Harnwege	11 (9,2 %)	17 (6,8 %)
Vorhofflimmern	10 (8,3 %)	10 (4,0 %)
Pyrexie	6 (5,0 %)	6 (2,4 %)
Neurologische Dekompensation	6 (5,0 %)	6 (2,4 %)
Aspirationspneumonie	5 (4,2 %)	8 (3,2 %)
Delirium	4 (3,3 %)	6 (2,4 %)
Knochentransplantat	4 (3,3 %)	1 (0,4 %)
Herzinsuffizienz	3 (2,5 %)	7 (2,8 %)
Durchfall	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Urosepsis	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Sturz	3 (2,5 %)	4 (1,6 %)
Kopfschmerzen	3 (2,5 %)	1 (0,4 %)
Ischämischer Schlaganfall	3 (2,5 %)	1 (0,4 %)
Herzstillstand	2 (1,7 %)	0
Überempfindlichkeit	2 (1,7 %)	1 (0,4 %)
Infektion mit Clostridium difficile	2 (1,7 %)	0
Gicht	2 (1,7 %)	3 (1,2 %)
Dissektion der A. carotis	2 (1,7 %)	0
Epilepsie	2 (1,7 %)	3 (1,2 %)
Depression	2 (1,7 %)	4 (1,6 %)
Harnverhaltung	2 (1,7 %)	2 (0,8 %)
Lungenembolie	2 (1,7 %)	6 (2,4 %)
Hämatom	2 (1,7 %)	2 (0,8 %)
Anämie	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Bradykardie	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Krämpfanfälle	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Ateminsuffizienz	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Röhreneinführung in den Magen-Darm-Bereich	1 (0,8 %)	5 (2,0 %)
Hypotonie	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Phlebitis	1 (0,8 %)	3 (1,2 %)
Vasospasmus	1 (0,8 %)	0
Arrhythmie	0	3 (1,2 %)
Myokardischämie	0	3 (1,2 %)
Nierenversagen	0	3 (1,2 %)
Tiefe Venenthrombose	0	3 (1,2 %)

TREVO 2 Studie zur Unterstützung von Indikation 2

Die klinische Prüfung TREVO 2 (Thrombectomy REvascularization of large Vessel Occlusions in acute ischemic stroke) beurteilte die Sicherheit und Wirksamkeit der Trevo Rückholvorrichtung im Vergleich zur Merci® Rückholvorrichtung. Einhundertachtundsiebzig (178) Patienten wurden für eine Behandlung mit der Trevo Rückholvorrichtung (N=88) oder der Merci Rückholvorrichtung (N=90) aufgenommen und randomisiert. Die Haupt einschlusskriterien waren: Patienten mit einer Okklusion eines großen Blutgefäßes, die sich nicht für den intravenösen Gewebeplasminogenaktivator (IV t-PA) eignen oder bei denen die Therapie nicht wirksam ist und die innerhalb von 8 Stunden nach Auftreten der Symptome behandelt werden können; Alter 18–85; 8 ≤ NIHSS ≤ 29; und angiografische Bestätigung einer persistenten großen Gefäßokklusion in der A. carotis interna, A. cerebri media (Segmente M1 und/oder M2), A. basilaris und/oder A. vertebralis. Die Haupt ausschlusskriterien waren: Stenose in einem proximalen Blutgefäß, die behandelt werden muss oder die einen Zugang mit der ausgewiesenen Studienvorrichtung zum Thrombus verhindert.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt war die Revaskularisierung, definiert als ein Durchfluss von mindestens TICI 2 nach Verwendung der ausgewiesenen Vorrichtung, wie von einem Kernlabor gemessen. Studienteilnehmer mit einer Baseline TICI 2a laut Kernlabor und Teilnehmer, an denen die Vorrichtung niemals ausprobiert wurde, wurden von den Analysen in der Tabelle unten ausgeschlossen.

Der primäre Sicherheitsendpunkt war das Auftreten von eingriffsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (PRSAEs) in den 24 Stunden nach dem Eingriff, die folgendermaßen definiert sind: vaskuläre Perforation oder intramurale arterielle Dissektion, symptomatische ICH, Embolisation in einen zuvor nicht betroffenen Bereich, Komplikationen an der Zugangsstelle, die eine chirurgische Reparatur oder eine Bluttransfusion erfordern, Mortalität innerhalb von 24 Stunden, Gerätestörung (Bruch in-vivo) oder alle anderen Komplikationen, die vom Clinical Events Committee als im Zusammenhang mit dem Eingriff stehend beurteilt werden.

**TREVO 2 Studienendpunkte
(Patienten mit Baseline TICI 0 oder 1, Studiengerät ausprobiert)**

Endpunkt	Trevo N=79 Pkte	Merci N=81 Pkte	Differenz [95 % KI] ^b	p-Wert
Primärer Wirksamkeitsendpunkt				
Erfolgreiche Revaskularisierung nach Einsatz der Vorrichtung (TICI ≥ 2a)				
Jede zusätzliche Therapie, die als fehlgeschlagene Behandlung angesehen wird	79,7 % (63/79)	49,4 % (40/81)	30,4 %	< 0,0001 ^c
[95 % Konf.-Intervall] ^a	[69,2 %, 88,0 %]	[38,1 %, 60,7 %]	[15,0 %, 44,1 %]	< 0,0001 ^d
Erfolgreiche Revaskularisierung nach Einsatz der Vorrichtung (TICI ≥ 2a)				
Jede IA-Lytika-Gabe, die als fehlgeschlagene Behandlung angesehen wird	87,3 % (69/79)	58,0 % (47/81)	29,3 %	< 0,0001 ^c
[95 % Konf.-Intervall] ^a	[78,0 %, 93,8 %]	[46,5 %, 68,9 %]	[15,0 %, 42,4 %]	< 0,0001 ^d
Primärer Sicherheitsendpunkt				
Gemischte Ereignisse	13,9 % (11/79)	23,5 % (19/81)	-9,5 % [-22,1 %, 2,8 %]	0,1567 ^e
[95 % Konf.-Intervall] ^a	[7,2 %, 23,6 %]	[14,8 %, 34,2 %]		
Gefäßperforation	0,0 % (0/79)	9,9 % (8/81)	-9,9 % [-18,5 %, -3,9 %]	
Intramurale arterielle Dissektion	0,0 % (0/79)	1,2 % (1/81)	-1,2 % [-6,7 %, 3,5 %]	
Symptomatische ICH	5,1 % (4/79)	9,9 % (8/81)	-4,8 % [-14,1 %, 3,8 %]	
Embolisation in einen zuvor nicht betroffenen Bereich	7,6 % (6/79)	4,9 % (4/81)	2,7 % [-5,6 %, 11,4 %]	
Komplikation an der Zugangsstelle, die eine chirurgische Reparatur oder Bluttransfusion erfordert	1,3 % (1/79)	0,0 % (0/81)	1,3 % [-3,3 %, 6,9 %]	
Mortalität innerhalb von 24 h	1,3 % (1/79)	0,0 % (0/81)	1,3 % [-3,3 %, 6,9 %]	
Ausfall des Geräts in-vivo	0,0 % (0/79)	0,0 % (0/81)	0,0 % [-4,6 %, 4,6 %]	
Sonstige PR-SAE	0,0 % (0/79)	0,0 % (0/81)	0,0 % [-4,6 %, 4,6 %]	
mRS 0–2 nach 90 Tagen	38,2 % (29/76)	17,9 % (14/78)	20,2 % [6,4 %, 34,1 %]	0,0068 ^e

a: Exakte Konfidenzintervalle gem. Clopper-Pearson an individuellen Proportionen; b: Exakte Konfidenzintervalle zu Unterschieden in Proportionen berechnet mit StatKet Version 8; c: Äquivalente Hypothese mit der Blackwelder-Methode und einer Äquivalenzspanne von 10 %; d: Einseitiger exakter Überlegenheitstest nach Fisher; e: Zweiseitiger exakter Test nach Fisher.

GARANTIE

Stryker Neurovascular garantiert, dass bei der Konstruktion und Herstellung dieses Instruments mit angemessener Sorgfalt vorgegangen wurde. **Diese Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden gesetzlichen oder anderweitig implizierten Garantien, die hier nicht ausdrücklich erwähnt werden, und schließt diese aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, jegliche implizierten Zusicherungen in Bezug auf marktgängige Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck.** Die Handhabung, Aufbewahrung, Reinigung und Sterilisation dieses Instruments sowie andere Faktoren, die sich auf den Patienten, die Diagnose, die Behandlung, chirurgische Verfahren und andere Umstände beziehen, die außerhalb der Kontrolle von Stryker Neurovascular liegen, haben direkten Einfluss auf das Instrument und die Resultate aus seinem Einsatz. Die Verpflichtung von Stryker Neurovascular im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des betreffenden Instruments; Stryker Neurovascular ist nicht haftbar für beiläufige bzw. Folgeverluste, Schäden oder Kosten, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Instruments ergeben. Stryker Neurovascular übernimmt keine weitere Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit diesem Instrument und bevollmächtigt dazu auch keine anderen Personen. **Stryker Neurovascular übernimmt keine Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für wiederverwendete, wiederaufbereitete oder resterilisierte Instrumente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Garantien bezüglich ihrer marktgängigen Qualität oder ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck.**

Dispositivo di recupero Trevo®

Rx ONLY

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo prodotto esclusivamente su prescrizione medica.

AVVERTENZA

Il contenuto è STERILIZZATO mediante ossido di etilene (EO). Non utilizzare se la barriera sterile è stata compromessa. In caso si rilevino danni, rivolgersi al rappresentante Stryker Neurovascular.

Esclusivamente monouso. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Tali processi potrebbero compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o provocarne il guasto, con conseguente rischio di lesioni, malattia o morte del paziente. Potrebbero inoltre creare rischi di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni del paziente o infezioni crociate, inclusa, in modo non limitativo, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo può inoltre provocare lesioni, malattia o la morte del paziente.

Dopo l'uso, eliminare il prodotto e la confezione in conformità ai protocolli ospedalieri, alle normative amministrative e/o alle leggi locali vigenti.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo di recupero è costituito da un'anima interna conica e flessibile e da una sezione sagomata all'estremità distale. I marker in platino posti all'estremità distale consentono la visualizzazione in fluoroscopia. Inoltre, anche la sezione sagomata è radiopaca. Le dimensioni del dispositivo di recupero sono indicate sull'etichetta del prodotto. Il dispositivo di recupero è dotato di un rivestimento idrofilo che ne riduce l'attrito durante l'uso. L'asta del dispositivo di recupero è dotata di un marker che serve a indicarne la prossimità della punta rispetto a quella del microcatetere. Il dispositivo di recupero viene fornito con un dispositivo di torsione che ne facilita la manipolazione. Il dispositivo di torsione viene utilizzato durante la procedura per ancorare l'anima interna al microcatetere. L'ancoraggio del dispositivo di torsione sul filo consente di ritrarre il microcatetere e il dispositivo di recupero come un unico sistema durante il recupero del coagulo. Per inserire il dispositivo di recupero nel microcatetere, viene fornito un apposito introduttore. L'introduttore è composto da una guaina nella quale viene precaricato il dispositivo di recupero. Una volta inserito per metà della sua lunghezza il dispositivo di recupero nel microcatetere, sarà possibile rimuovere l'introduttore. L'estremità prossimale del dispositivo di recupero è modificata per consentire il fissaggio alla prolunga per filoguida Abbott Vascular DOC (RIF 22260). Collegando la prolunga per filoguida al dispositivo di recupero viene facilitata la rimozione o lo scambio di un catetere, pur mantenendo in posizione il dispositivo di recupero nella struttura anatomica. Completato lo scambio, la prolunga può essere distaccata.

Informazioni per l'utente

Il dispositivo di recupero Trevo deve essere usato esclusivamente da medici addestrati nelle procedure interventistiche endovascolari.

Contenuto

Un (1) dispositivo di recupero Trevo

Un (1) dispositivo di torsione

Un (1) introduttore

Compatibilità

Dimensione del dispositivo di recupero	Microcatetere Trevo Pro14	Microcatetere Trevo Pro18	Microcateteri Excelsior® XT-27® (150 cm x 6 cm dritto RIF XT275081)	Diametro interno minimo raccomandato del vaso (mm)
Trevo XP ProVue 3 X 20 mm	✓	✓		2,5
Trevo XP ProVue 4 X 20 mm		✓		
Trevo ProVue 4 X 20 mm		✓		
Trevo XP ProVue 4 X 30 mm		✓	✓	
Trevo XP ProVue 6 X 25 mm			✓	

La compatibilità del dispositivo di recupero con altri microcateteri non è stata stabilita. L'utilizzo di un diverso microcatetere può influenzare le prestazioni del dispositivo di recupero.

I catetere guida con palloncino (come il Catetere guida con palloncino Merci® e il Catetere guida con palloncino FlowGate®) sono raccomandati per l'uso in procedure di rimozione dei trombi.

I dispositivi di recupero sono compatibili con la Valvola emostatica girevole (RIF 421242) Boston Scientific.

I dispositivi di recupero sono compatibili con la prolunga per filoguida Abbott Vascular DOC (RIF 22260).

USO PREVISTO/INDICAZIONI PER L'USO

1. Il dispositivo di recupero Trevo è indicato per il ripristino del flusso sanguigno neurovascolare tramite rimozione di trombi durante il trattamento dell'ictus ischemico acuto, allo scopo di ridurre la disabilità in pazienti con estesa occlusione vascolare persistente nel circolo prossimale anteriore, e con core di infarto più piccoli trattati in prima linea con attivatore del plasminogeno tissutale (t-PA I.V.) per via endovenosa. La terapia endovascolare con il dispositivo deve essere avviata entro 6 ore dall'esordio dei sintomi.
2. Il dispositivo di recupero Trevo è stato progettato per ripristinare il flusso sanguigno nei vasi del sistema nervoso centrale, rimuovendo trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico entro 8 ore dall'insorgenza dei sintomi. Sono candidabili al trattamento pazienti non eleggibili alla terapia con attivatore del plasminogeno tissutale per via endovenosa (t-PA I.V.) o nei quali la terapia I.V. con t-PA non abbia avuto successo.
3. Il dispositivo di recupero Trevo è indicato per il ripristino del flusso sanguigno neurovascolare tramite rimozione di trombi durante il trattamento dell'ictus ischemico acuto, allo scopo di ridurre la disabilità in pazienti con estesa occlusione vascolare persistente nel circolo prossimale anteriore a carico dell'arteria carotide interna (ICA), o di segmenti dell'arteria cerebrale media (MCA)-M1 con core di infarto più piccoli (0-50 cc pazienti di età <80 anni, 0-20 cc per pazienti di età ≥80 anni). La terapia endovascolare con il dispositivo deve essere avviata entro 6-24 ore dall'ultima constatazione di buone condizioni in pazienti non eleggibili al trattamento endovenoso con attivatore del plasminogeno tissutale (t-PA I.V.) o nei quali la terapia I.V. con t-PA non abbia avuto esito favorevole.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

AVVERTENZE

SPECIFICHE AVVERTENZE RELATIVE ALL'INDICAZIONE PER L'USO 1

- I parametri di sicurezza ed efficacia del dispositivo di recupero Trevo nella riduzione della disabilità in pazienti con core di infarto di grandi dimensioni (cioè, ASPECTS ≤7), non sono stati stabiliti. Tali pazienti possono essere sottoposti a maggiori rischi, come quello di emorragia intracerebrale.
- I parametri di sicurezza ed efficacia del dispositivo di recupero Trevo nella riduzione della disabilità in pazienti con occlusioni a carico del circolo posteriore (ad es., arterie basilari o vertebrali) od occlusioni più distali nel circolo anteriore, non sono stati stabiliti né valutati.

SPECIFICHE AVVERTENZE RELATIVE ALL'INDICAZIONE PER L'USO 2

- Per ridurre il rischio di danno vascolare, fare attenzione a dimensionare correttamente il dispositivo di recupero rispetto al diametro vasale nel sito di dispiegamento previsto.

SPECIFICHE AVVERTENZE RELATIVE ALL'INDICAZIONE PER L'USO 3

- I parametri di sicurezza ed efficacia del dispositivo di recupero Trevo nella riduzione della disabilità in pazienti con core di infarto di grandi dimensioni (cioè, ASPECTS ≤7), non sono stati stabiliti. Tali pazienti possono essere sottoposti a maggiori rischi, come quello di emorragia intracerebrale.
- I parametri di sicurezza ed efficacia del dispositivo di recupero nella riduzione della disabilità in pazienti con occlusioni a carico del circolo posteriore (ad es., arterie basilari o vertebrali) od occlusioni più distali nel circolo anteriore, non sono stati stabiliti né valutati.
- Gli utenti dovrebbero convalidare le proprie tecniche di analisi del software di imaging per garantire risultati affidabili e coerenti durante la valutazione della dimensione del core di infarto.

AVVERTENZE GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE INDICAZIONI PER L'USO

- La somministrazione di t-PA I.V. deve essere condotta all'interno della finestra approvata dalla FDA (entro 3 ore dall'insorgenza dei sintomi di ictus).
- Per ridurre il rischio di danno vascolare, attenersi alle seguenti raccomandazioni:
 - Non eseguire più di sei (6) tentativi di recupero nella stessa vaso utilizzando dispositivi di recupero.
 - Durante la rimozione o lo scambio del microcatetere, mantenere la posizione del dispositivo di recupero nel vaso.
- Per ridurre il rischio di attorcigliamento/rottura, attenersi alle seguenti raccomandazioni:
 - Immediatamente dopo lo sguaianamento del dispositivo di recupero, posizionare il marker della punta del microcatetere appena prossimalmente alla sezione sagomata. Durante la manipolazione e il ritiro, mantenere il marker della punta del microcatetere appena prossimalmente alla sezione sagomata del dispositivo di recupero.
 - Non ruotare né torcere il dispositivo di recupero.
 - Prestare attenzione quando il dispositivo di recupero attraversa arterie in cui sia presente uno stent.

- Il dispositivo di recupero è delicato e deve essere manipolato con cautela. Prima dell'uso e quando possibile durante la procedura, ispezionare attentamente il dispositivo per verificare eventuali danni. Non utilizzare dispositivi che mostrino segni di danni. L'eventuale danneggiamento può impedire il funzionamento del dispositivo e causare complicanze.
- Non far avanzare o ritirare il dispositivo di recupero se oppone resistenza o in caso di vasospasmo significativo. Spostare o torcere il dispositivo se oppone resistenza o in caso di vasospasmo significativo può danneggiare il vaso o il dispositivo stesso. Valutare in fluoroscopia la causa della resistenza e, ove necessario, reintrodurre il dispositivo nella guaina per ritirarlo.
- Se il ritiro del dispositivo di recupero dal vaso risultasse difficile, non torcere il dispositivo. Far avanzare il microcatetere distalmente, ritirare delicatamente il dispositivo di recupero nel microcatetere e rimuovere dispositivo di recupero e microcatetere come fosse un'unica unità. In caso di indebita resistenza durante l'estrazione di dispositivo di recupero e microcatetere, prendere in considerazione di prolungare il dispositivo di recupero servendosi di una prolunga per filoguida Abbott Vascular DOC (RIF 22260), in modo da poter sostituire il microcatetere con un catetere di diametro maggiore, come il catetere DAC®. Ritirare con cautela il dispositivo di recupero nel catetere di diametro maggiore.
- Somministrare farmaci anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici secondo le linee guida standard dell'istituto.
- Gli utenti devono prendere ogni precauzione necessaria per limitare la dose di radiazioni X ai pazienti e a sé stessi utilizzando una sufficiente schermatura, riducendo i tempi della fluoroscopia e, ove possibile, modificando le specifiche tecniche dei raggi X.

PRECAUZIONI

- Conservare in un luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce.
- Non usare se la confezione è danneggiata o aperta.
- Usare entro la data di "Scadenza".
- L'esposizione a temperature superiori a 54 °C (130 °F) può danneggiare dispositivo e accessori. Non sterilizzare in autoclave.
- Non esporre il dispositivo di recupero a solventi.
- Utilizza il dispositivo di recupero in abbinamento alla visualizzazione in fluoroscopia e ad appropriati agenti anticoagulanti.
- Per prevenire la formazione di trombi e la cristallizzazione del mezzo di contrasto, mantenere un'infusione costante tra catetere guida e microcatetere e tra microcatetere e dispositivo di recupero/ filoguida utilizzando un'opportuna soluzione di irrigazione.
- Non applicare un dispositivo di torsione all'estremità prossimale sagomata del dispositivo di recupero DOC compatibile. Potrebbero verificarsi danni, precludendo il possibile collegamento della prolunga per filoguida DOC.

EFFETTI INDESIDERATI

Le procedure che richiedono l'introduzione percutanea di un catetere devono essere eseguite esclusivamente da personale medico che abbia maturato un'approfondita conoscenza delle possibili complicanze che possono verificarsi durante o dopo la procedura. Le possibili complicanze comprendono, in modo non limitativo:

- embolo gassoso
- sanguinamento o ematoma al sito di puntura
- infezione
- embolizzazione distale
- dolore/mal di testa
- vasospasmo
- trombosi
- dissezione
- perforazione
- emboli
- occlusione acuta
- ischemia
- emorragia intracranica
- formazione di pseudoaneurisma
- deficit neurologici, incluso l'ictus
- decesso

L'uso del dispositivo richiede l'ausilio della visualizzazione fluoroscopica con i potenziali rischi per medici e pazienti associati all'esposizione ai raggi X. I possibili rischi comprendono, in modo non limitativo:

- alopecia,
- ustioni di gravità variabile dall'arrossamento cutaneo a ulcere,
- cataratte,
- neoplasia differita

Notifica di effetti indesiderati

Notificare immediatamente al rappresentante Stryker Neurovascular la presenza o il sospetto di un malfunzionamento del dispositivo o di una complicanza o lesione al paziente. Si prega di conservare eventuali dispositivi potenzialmente difettosi, i loro componenti e la loro confezione, e di restituirli a Stryker Neurovascular.

MODALITÀ DI FORNITURA

I prodotti Stryker Neurovascular sono da considerarsi sterili e apirogeni se contenuti nella confezione integra concepita per mantenere la sterilità, purché il sacchetto primario non sia stato aperto o danneggiato.

Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta.

Non usare il prodotto se le etichette sono incomplete o illeggibili.

Manipolazione e conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Procedura di preparazione consigliata

- Irrigare la guaina di confezionamento con soluzione fisiologica. Idratate per almeno 2 minuti prima di estrarre il dispositivo di recupero dalla guaina. Mantenere idratato il dispositivo di recupero.
- Preparare e posizionare il catetere guida con palloncino o il catetere guida nell'arteria carotide interna, nell'arteria carotide comune o nell'arteria succavia come specificato nell'etichettatura del catetere guida.
- Collegare la valvola emostatica girevole al raccordo del microcatetere.
- Utilizzando tecniche di cateterizzazione convenzionali, posizionare il microcatetere nel vaso target usando un filoguida neurovascolare standard. Anatomia permettendo, posizionare la punta del microcatetere distalmente al trombo.
- Rimuovere il filoguida dal microcatetere. Iniettare il mezzo di contrasto tramite il microcatetere per visualizzare la vascularizzazione distale. Irrigare il microcatetere.
- Rimuovere insieme, dalla guaina di confezionamento, l'introdotore e il dispositivo di recupero precaricato come fossero un'unica unità. Non consentire al dispositivo di inserimento di fuoruscire dalla punta dell'introdotore o di ritrarsi ulteriormente nell'introdotore.
- Importante:** inserire l'introdotore a metà strada nella valvola emostatica girevole e servirsi di una siringa o di una linea di infusione per irrigare l'introdotore finché la soluzione fisiologica non fuoriesce dalla sua estremità distale. Se l'introdotore non è stato adeguatamente irrigato, potrebbe essere difficile far avanzare il dispositivo di recupero attraverso lo strumento di inserimento.
- Inserire lo strumento di inserimento nel raccordo del microcatetere e chiudere saldamente la valvola emostatica per fissare in posizione l'inseritore.
- Fare avanzare il dispositivo di recupero fino a metà delle sua lunghezza nel microcatetere. Rimuovere l'introdotore.

Procedura di recupero consigliata

- Fare avanzare il dispositivo di recupero fin quando la sua punta distale non risulta allineata alla punta distale del microcatetere.

Nota: la seguente tabella descrive dove si trova la punta del dispositivo di recupero (estremità distale del dispositivo di recupero) in rapporto alla punta del microcatetere (estremità distale del microcatetere) quando:

- l'estremità distale del marker dell'asta del dispositivo di recupero raggiunge il raccordo del microcatetere, o
- l'estremità prossimale del marker dell'asta del dispositivo di recupero raggiunge l'estremità prossimale della valvola emostatica.

Tabella di monitoraggio dell'estremità distale

Trevo® ProVue 4 x 20 mm Trevo XP 4 x 20 mm Trevo XP 6 x 25 mm	• Entro 8 cm dall'uscita della punta del microcatetere
Trevo XP 3 x 20 mm	• Entro 15 cm dall'uscita della punta del microcatetere
Trevo XP 4 x 30 mm	<p>Se utilizzato con Trevo Pro 18 MC (90238): • Entro 8 cm dall'uscita della punta del microcatetere</p> <p>Se utilizzato con Excelsior® XT-27® MC (XT275081): • Entro 15 cm dall'uscita della punta del microcatetere</p>

- Ritirare il microcatetere mentre si applica al dispositivo di recupero una leggera pressione in avanti per dispiegarne la sezione sagomata all'interno del coagulo. Posizionare il marker della punta del microcatetere appena prossimalmente alla sezione sagomata del dispositivo di recupero.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di attorcigliamento/rottura, durante la manipolazione e il ritiro mantenere il marker della punta del microcatetere appena prossimale alla sezione sagomata del dispositivo di recupero.

3. Dopo aver dispiegato il dispositivo di recupero, visualizzare l'espansione della maglia e lasciare trascorrere un tempo sufficiente per integrare il coagulo nel dispositivo di recupero (circa 5 minuti).
4. Se si utilizza un catetere guida con palloncino, gonfiare il palloncino per occludere il vaso come specificato nell'etichetta del palloncino guida con palloncino.
5. Posizionare e bloccare il dispositivo di torsione sul dispositivo di recupero in corrispondenza del raccordo del microcatetere.
6. Ritirare lentamente dispositivo di recupero e microcatetere come un'unica unità verso la punta del catetere guida con palloncino mentre si aspira dal catetere guida con palloncino con una siringa da 60 mL.
7. Aspirare vigorosamente dal catetere guida con palloncino utilizzando una siringa da 60 mL e ritirare il dispositivo di recupero e il microcatetere all'interno del catetere guida. Continuare ad aspirare fino a quando il dispositivo di recupero e il microcatetere non siano stati ritirati quasi del tutto dal catetere guida.

Nota: se il ritiro nel catetere guida o nel catetere guida con palloncino è difficile, sgonfiare il palloncino del catetere guida con palloncino e, contemporaneamente, ritirare catetere guida, microcatetere e dispositivo di recupero come fosse un'unica unità attraverso la guaina. Se necessario, rimuovere la guaina.

8. Sgonfiare il palloncino del catetere guida con palloncino.
9. Collegare catetere guida con palloncino, valvola emostatica girevole e rimuovere completamente dal catetere guida, come fosse un'unica unità, dispositivo di recupero, microcatetere e valvola emostatica girevole.
10. Collegare una siringa da 60 mL al raccordo del catetere guida con palloncino e aspirare.
11. Pulire il dispositivo con soluzione fisiologica. Verificare che il dispositivo di recupero non sia danneggiato. Non riutilizzare il dispositivo di recupero se l'anima interna, la sezione sagomata o la spirale di platino avessero un aspetto diverso da quello osservato inizialmente una volta estratti dalla confezione. In assenza di danni visibili, il dispositivo di recupero potrà essere usato per tre (3) tentativi di recupero. Per "tentativo di recupero" si intende un (1) ciclo completo di inserimento e ritiro.

Procedura consigliata di scambio del catetere

1. Seguire le Istruzioni per l'uso fornite con la prolunga per filoguida Abbott Vascular DOC; tuttavia, quando si seguono i passaggi previsti dalle IFU, non trattare il "dispositivo di recupero" come il "filo guida".

STUDI CLINICI

Informazioni sulla sicurezza e l'efficacia

Studio DAWN™ di supporto alle indicazioni per l'uso 3

Lo studio clinico prospettico, randomizzato, multicentrico, controllato DAWN (DWI or CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention with Trevo® [Valutazione DWI o CTP con mancata corrispondenza clinica nel Triage di risveglio e di comparsa tardiva di ictus in pazienti sottoposti ad approccio neurointerventistico con dispositivo di recupero Trevo]) ha valutato l'ipotesi di migliori risultati clinici a 90 giorni a seguito di un approccio congiunto composto da trombectomia con dispositivo di recupero Trevo e gestione clinica rispetto agli esiti prodotti dalla sola gestione clinica del caso, in pazienti opportunamente selezionati che hanno subito un ictus ischemico acuto entro 6-24 ore dall'avvio del trattamento dopo l'ultima constatazione di buone condizioni. Sono stati arruolati complessivamente 206 pazienti in 26 centri di studio: di questi, 107 pazienti (51,9%) sono stati randomizzati al Braccio di trattamento e 99 pazienti (48,1%) al Braccio di controllo. I valori medi UW-mRS (Utility-Weighted Modified Rankin Scale) a 90 giorni sono stati 5,5 per il Braccio di trattamento rispetto a 3,4 per il Braccio di controllo; la differenza di gruppo corretta per core di infarto riguardo al grado di disabilità, ponderato in base all'utilità, è stata 2,0 (95% dell'Intervallo di confidenza bayesiano, da 1,1 a 3,0, probabilità di superiorità a posteriori >0,9999). Il trattamento con dispositivo di recupero Trevo ha evidenziato tassi maggiori di indipendenza funzionale (mRS 0-2) a 90 giorni, 48,6% vs. 13,1%; differenza di gruppo corretta per core di infarto 32,8% (95% dell'Intervallo di credibilità, da 21,1% al 44,1%, probabilità di superiorità a posteriori >0,9999). Il tasso di emorragia intracranica sintomatica a 24 ore è stato più alto nei pazienti sottoposti a terapia endovascolare. I pazienti e/o i loro rappresentanti legalmente autorizzati dovrebbero essere informati di tale rischio durante il processo decisionale finalizzato all'opzione di trattamento. Esiste un maggiore livello di incertezza nei risultati mostrati dai pazienti nell'arco temporale di 18-24 ore dall'ultima constatazione di buone condizioni.

Criteri chiave di inclusione

Ictus ischemico acuto con occlusione confermata intracranica dell'arteria carotide interna (ICA) e/o del segmento M1 (dell'arteria cerebrale media), controindicato o non responsivo alla terapia endovenosa con attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA I.V.), trattato entro 6-24 ore dopo l'ultima osservazione nota, punteggio NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) al baseline ≥10, consenso informato fornito all'età di 18 anni o maggiore. Nei pazienti di età inferiore a 80 anni, un punteggio dell'ictus uguale o superiore a 10 deve essere associato a volume del core ischemico inferiore a 51 mL. Nei pazienti di età pari o superiore a 80 anni, il punteggio dell'ictus deve essere superiore a 10 con volume inferiore a 21 mL. Mancata

corrispondenza con il core clinico, definita come discrepanza tra il volume dell'infarto (o core) al baseline nell'imaging di TC o di RM e l'estensione totale del tessuto cerebrale a rischio. Il volume dell'infarto è stato valutato utilizzando l'imaging pesato di risonanza magnetica (RM) di diffusione o di perfusione TC, e misurato con uno dei pacchetti software automatizzati disponibili in commercio (RAPID, IschemiaView).

Criteri chiave di esclusione

Rapido miglioramento dello stato neurologico fino a un punteggio NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) <10 o evidenza di ricanalizzazione del vaso prima della randomizzazione; pressione arteriosa >185/110 mmHg; evidenza diagnostica di squilibrio elettrolitico (ad es., <130 mmol/L, potassio <3 mEq/L o >6 mEq/L); evidenza diagnostica di insufficienza renale (ad es., creatininemia sierica >3,0 mg/dL (264 µmol/L), evidenza diagnostica di anomalie della coagulazione (ad es., conta piastrinica <50.000/uL, APTT >3 volte il normale o INR >3,0; ove 24-48 ore prima fosse stato somministrato un inibitore del fattore Xa, il PTT deve essere normale); evidenza diagnostica di sanguinamento (vale a dire, emoglobina <7 mmol/L).

L'endpoint primario è stato il grado di invalidità a 90 giorni valutato in base alla scala di Rankin modificata (mRS).

L'obiettivo secondario è stato di dimostrare che la riperfusione endovascolare con dispositivo di recupero Trevo è associata a una significativa riduzione del valore mediano delle dimensioni dell'infarto rispetto al gruppo di controllo a 24 (-6+24) ore, dopo randomizzazione. Gli endpoint secondari includevano: la quota di pazienti con buon risultato funzionale a 90 giorni (mRS di 0-2); la quota di pazienti con calo del punteggio NIHSS a ≥10 punti rispetto al baseline, oppure con punteggio NIHSS di 0 o di 1; la differenza tra Braccio di trattamento e Braccio di controllo in rapporto a tutte le cause di mortalità; la differenza del valore mediano finale delle dimensioni dell'infarto a 24 ore; la differenza dei tassi di rivascolarizzazione a 24 ore; e il tasso di riperfusione a TICI >2b.

I risultati di sicurezza hanno incluso: l'incidenza di mortalità correlata a ictus a 90 giorni; l'incidenza di emorragia cerebrale sintomatica (sICH), il deterioramento neurologico, gli effetti indesiderati gravi correlati sia alla procedura che al dispositivo.

Popolazione ITT (intention-to-treat) a 90 giorni secondo la scala di Rankin modificata

Scala di Rankin modificata (mRS)	Braccio di trattamento N=107	Braccio di controllo N=99
0 - Nessuna sintomatologia / UW = 10	9,3% (10/107)	4,0% (4/99)
1 - Nessuna disabilità significativa / UW = 9,1	22,4% (24/107)	5,1% (5/99)
2 - Disabilità lieve / UW = 7,6	16,8% (18/107)	4,0% (4/99)
3 - Disabilità moderata: / UW = 6,5	13,1% (14/107)	16,2% (16/99)
4 - Disabilità moderatamente grave / UW = 3,3	13,1% (14/107)	34,3% (34/99)
5 - Disabilità grave / UW = 0	6,5% (7/107)	18,2% (18/99)
6 - Decesso / UW = 0	18,7% (20/107)	18,2% (18/99)
mRS a 90 giorni [0-2]	48,6% (52/107)	13,1% (13/99)
mRS ponderata a 90 giorni*		
Media ±DS (N)	5,5 ±3,8 (107)	3,4 ±3,2 (99)
Mediana (Q1, Q3)	6,5 (0,0, 9,1)	3,3 (0,0, 6,5)
Intervallo (min, max)	(0,0, 10,0)	(0,0, 10,0)
[95% Inter. di conf.] ¹	[4,8, 6,3]	[2,7, 4,0]

*Per approssimazione normale
*mRS = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} è stato assegnato un valore numerico corrispondente = {10, 9, 1, 7, 6, 5, 3, 3, 0, 0}, che rappresenta la sua utilità clinica

Esi co-primiaria della popolazione ITT

Risultato	Intervento (N=107)	Controllo (N=99)	Differenza media assoluta (95% IC)	Beneficio medio a posteriori, aggiustato in base al core (95% intervallo di credibilità)*	Probabilità di superiorità = 99,9%
mRS media ponderata secondo l'utilità (DS)	5,5 (3,8)	3,4 (3,1)	2,1 (1,2, 3,1)	2,0 (1,1, 3,0)	>0,9999 ¹
Indipendenza funzionale (mRS 0-2)	48,6%	13,1%	35,5% (23,9%, 47,0%)	32,8% (21,1%, 44,1%)	>0,9999

*Regolazione prevista del core di infarto secondo il modello lineare generale Bayesiano

¹La probabilità complessiva di beneficio del dispositivo è quindi la media delle probabilità di beneficio per i set di dati imputati, ponderata secondo le probabilità di imputazione di tali serie di dati. Tale probabilità è 0,999986.

Il secondo endpoint di efficacia secondario è stato la diminuzione del punteggio NIHSS a ≥10 punti rispetto al baseline, oppure con punteggio NIHSS di 0 o di 1.

Risposta neurologica precoce al Giorno 5-7/Dimissione

Risultato	Intervento N=107	Controllo N=99	Differenza media assoluta (95% IC)	Rapporto di rischio (95% IC)	Valore p
Risposta precoce	47,7%	19,2%	28,5% (16,2%, 40,7%)	2,5 (1,6, 3,9)	<0,001

TDefinito come diminuzione di NIHSS a ≥10 punti rispetto al baseline o con punteggio NIHSS 0 o 1 al Giorno 5-7 o alla dimissione (a seconda di quale delle due circostanze si è verificata per prima). Il valore p non è stato aggiustato per la molteplicità.

L'esito secondario di efficacia ha riguardato i tassi di rivascolarizzazione a 24 ore, definiti come presenza di ricanalizzazione parziale o completa.

Tassi di rivascolarizzazione a 24 ore

	Totale N=206	Braccio di trattamento N=107	Braccio di controllo N=99	Differenza [95% CI] ¹	Valore p
Differenze tra i tassi di rivascolarizzazione a 24 (-6/+24) ore dalla randomizzazione	58,7% (121/206)	76,6% (82/107)	38,4% (38/99)	40,2% [27,1%, 51,5%]	<0,0001 ^a

La rivascolarizzazione a 24 ore è stata definita come presenza di ricanalizzazione, parziale o completa.

a. Test t. Il valore p non è stato aggiustato per la molteplicità.

L'endpoint primario di sicurezza è stato l'incidenza della mortalità correlata a ictus a 90 giorni. Gli esiti secondari di sicurezza del Braccio di trattamento e del Braccio di controllo sono stati l'incidenza di sICH, secondo la definizione ECASS, entro 24 (-6/+24) ore dalla randomizzazione (tempo zero) e l'incidenza di deterioramento neurologico rispetto al punteggio NIHSS al baseline al Giorno 5-7/dimissione (a seconda di quale delle due circostanze si è verificata per prima) dopo la randomizzazione. Il deterioramento neurologico è stato definito come aumento di ≥4 punti del punteggio NIHSS rispetto al baseline.

Mortalità a 90 giorni correlata all'ictus

	Totale N=206	Braccio di trattamento N=107	Braccio di controllo N=99	Differenza [95% CI] ¹	Valore p
Incidenza a 90 giorni della mortalità complessiva correlata all'ictus	17,0% (35/206)	15,9% (17/107)	18,2% (18/99)	-2,3% [-12,6%, 8,0%]	0,7126 ^a

¹Per approssimazione normale

a. Test esatto di Fisher. Il valore p non è stato aggiustato per la molteplicità.

L'esito secondario di sicurezza è stato l'incidenza di sICH, secondo la definizione ECASS III, entro 24 (-6/+24) ore dopo la randomizzazione (tempo zero).

Incidenza di sICH su valutazione del CEC

	Totale N=206	Braccio di trattamento N=107	Braccio di controllo N=99	Differenza [95% CI] ¹	Valore p
sICH a 24 (-6/+24) ore dopo randomizzazione	4,4% (9/206)	5,6% (6/107)	3,0% (3/99)	2,6% [-2,9%, 8,1%]	0,5011 ^a

¹Per approssimazione normale

a. Test esatto di Fisher. Il valore p non è stato aggiustato per la molteplicità.

L'incidenza del deterioramento neurologico è stata definita come aumento di ≥4 punti del punteggio NIHSS dal baseline fino al Giorno 5-7/dimissione dopo la randomizzazione (tempo zero).

Incidenza del deterioramento su valutazione del CEC

	Totale N=206	Braccio di trattamento N=107	Braccio di controllo N=99	Differenza [95% CI] ¹	Valore p
Incidenza del deterioramento neurologico tra baseline e Giorno da 5 a 7/ Dimissione	19,9% (41/206)	14,0% (15/107)	26,3% (26/99)	-12,2% [-23,1%, -1,4%]	0,0358 ^a

¹Per approssimazione normale

a. Test t. Il valore p non è stato aggiustato per la molteplicità.


Indipendenza funzionale (mRS 0-2 a 90 giorni) sottoraggruppata in base al tempo

Intervalli TLSW	Trattamento	Controllo	Differenza	Valore p
6-9 ore	50,0% (9/18)	14,3% (3/21)	35,7% [8,2%, 63,2%]	0,0346 ^a
9-12 ore	58,1% (18/31)	26,1% (6/24)	33,1% [8,5%, 57,6%]	0,0273 ^a
Totale 6-12 ore	55,1% (27/49)	20,0% (9/45)	35,1% [16,9%, 53,3%]	0,0006^a
12-15 ore	37,5% (6/16)	9,1% (2/22)	28,4% [1,8%, 55,0%]	0,0498 ^a
15-18 ore	50,0% (13/26)	5,3% (1/19)	44,7% [23,1%, 66,4%]	0,0025 ^a
18-21 ore	36,4% (4/11)	0,0% (0/8)	36,4% [7,9%, 64,8%]	0,1032 ^a
21-24 ore	40,0% (2/5)	20,0% (1/5)	20,0% [-35,4%, 75,4%]	1,0000 ^a
Totale 12-24*	43,1% (25/58)	7,4% (4/54)	35,7% [21,2%, 50,2%]	<0,0001^a

a. Test esatto di Fisher.

** Maggiore livello di incertezza di risultati mostrato per i pazienti nell'arco temporale di 18-24 ore dall'ultima constatazione di buone condizioni*

Il valore p non è stato aggiustato per la molteplicità.

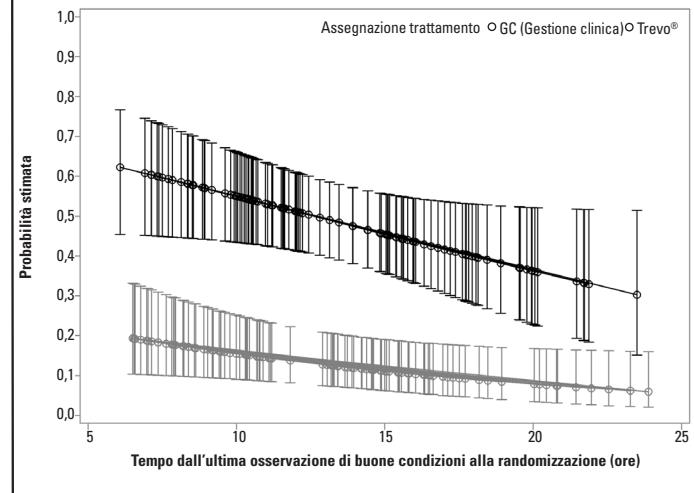Indipendenza funzionale (mRS 0-2) dall'ultima osservazione di buona condizione alla randomizzazione

La seguente tabella riepiloga tutti gli effetti indesiderati, gravi e non gravi, relativi a ogni paziente incluso nel Braccio di controllo e nel Braccio di trattamento secondo MedDRA Dictionary System Organ Classes (SOC) (Classificazione sistematica organica secondo MedDRA).

MedDRA* System Organ Class	Braccio di trattamento N=107					Braccio di controllo N=99						
	EIG	Pazienti con EIG	Non EIG	Pazienti con non EIG	El totali	Pazienti con El totali	Effetti indesiderati gravi (EIG)	Pazienti con EIG	Non EIG	Pazienti con non EIG	El totali	Pazienti con El
Qualsiasi effetto indesiderato (El)	65	41 (38,3%)	476	102 (95,3%)	541	103 (96,3%)	83	47 (47,5%)	473	91 (91,9%)	556	91 (91,9%)
Disturbi del sistema emolinfopoietico	0	0	11	10 (9,3%)	11	10 (9,3%)	1	1 (1,0%)	8	8 (8,1%)	9	8 (8,1%)
Disturbi cardiaci	8	7 (6,5%)	37	29 (27,1%)	45	33 (30,8%)	6	5 (5,1%)	29	24 (24,2%)	35	28 (28,3%)
Disturbi endocrini	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	0	0	0	0
Disturbi oculari	1	1 (0,9%)	0	0	1	1 (0,9%)	0	0	2	2 (2,0%)	2	2 (2,0%)
Disturbi gastrointestinali	7	6 (5,6%)	42	30 (28,0%)	49	34 (31,8%)	12	11 (11,1%)	38	28 (28,3%)	50	34 (34,3%)
Disturbi generici e condizioni del sito di somministrazione	0	0	22	18 (16,8%)	22	18 (16,8%)	0	0	17	15 (15,2%)	17	15 (15,2%)
Disturbi epatobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0%)	1	1 (1,0%)
Disturbi del sistema immunitario	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0%)	1	1 (1,0%)
Infezioni e infestazioni	6	6 (5,6%)	46	34 (31,8%)	52	38 (35,5%)	7	7 (7,1%)	54	41 (41,4%)	61	43 (43,4%)
Lesioni, avvelenamento e complicanze correlate alla procedura	2	2 (1,%)	8	7 (6,5%)	10	9 (8,4%)	2	2 (2,0%)	8	6 (6,1%)	10	7 (7,1%)
Indagini	0	0	5	5 (4,7%)	5	5 (4,7%)	0	0	10	10 (10,1%)	10	10 (10,1%)
Disturbi del metabolismo e della nutrizione	0	0	76	47 (43,9%)	76	47 (43,9%)	0	0	62	34 (34,3%)	62	34 (34,3%)
Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo	0	0	11	10 (9,3%)	11	10 (9,3%)	2	2 (2,0%)	22	15 (15,2%)	24	16 (16,2%)
Neoplasie benigne, maligne e non specificate	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	0	0	0	0
Disturbi del sistema nervoso centrale	21	21 (19,6%)	95	63 (58,9%)	116	71 (66,4%)	34	30 (30,3%)	88	53 (53,5%)	122	66 (66,7%)
Disturbi psichiatrici	1	1 (0,9%)	26	24 (22,4%)	27	24 (22,4%)	2	2 (2,0%)	30	27 (27,3%)	32	28 (28,3%)
Disturbi renali e urinari	0	0	18	15 (14,0%)	18	15 (14,0%)	1	1 (1,0%)	19	14 (14,1%)	20	15 (15,2%)
Disturbi del sistema riproduttivo e mammari	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	2	2 (2,0%)	2	2 (2,0%)
Disturbi respiratori, toracici e mediastinici	14	11 (10,3%)	33	28 (26,2%)	47	33 (30,8%)	11	9 (9,1%)	42	34 (34,3%)	53	37 (37,4%)
Disturbi del tessuto cutaneo e sottocutaneo	0	0	3	3 (2,8%)	3	3 (2,8%)	0	0	10	7 (7,1%)	10	7 (7,1%)
Procedure mediche e chirurgiche	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	2	2 (1,9%)	1	1 (1,0%)	2	2 (2,0%)	3	3 (3,0%)
Disturbi vascolari	4	3 (2,8%)	39	33 (30,8%)	43	34 (31,8%)	4	4 (4,0%)	28	21 (21,2%)	32	23 (23,2%)

*È stata utilizzata la versione 17.0 di MedDRA.

Studio MR CLEAN di supporto alle indicazioni per l'uso 1

L'ampio studio clinico multicentrico, controllato, in aperto, randomizzato, prospettico MR CLEAN ha coinvolto tutti i centri ospedalieri endovascolari dei Paesi Bassi. Sono stati messi a confronto un trattamento combinato di terapia endovenosa e cure sanitarie di routine (tra cui la somministrazione endovenosa di attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA I.V.) e il solo trattamento con cure sanitarie di routine (gruppo di controllo) in pazienti con ictus ischemico acuto e occlusione arteriosa prossimale intracranica a carico del circolo anteriore confermata dall'imaging vascolare. Nello studio MR CLEAN sono stati randomizzati 500 pazienti (233 trattamento ("IAT"), 267 controllo) presso 16 centri medici. Sono stati applicati stent recuperabili (inclusi i dispositivi della famiglia di dispositivi di recupero Trevo®) a 190 dei 233 (81,5%) pazienti assegnati al braccio IAT; di questi, 120/190 hanno ricevuto un trattamento intrarterioso di prima linea con un dispositivo di recupero Trevo e 104/120 hanno ricevuto un trattamento endovenoso con attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA I.V.) entro 3 ore dall'insorgenza dei sintomi, rispetto all'intero gruppo di controllo dello studio MR CLEAN sottoposti a gestione clinica (GC), di tali pazienti, conformemente all'etichettatura della FDA, 224 su 249 sono stati trattati con attivatore tissutale del plasminogeno via endovenosa (t-PA I.V.). Sui 120 pazienti che hanno ricevuto un trattamento intrarterioso di prima linea con un dispositivo di recupero Trevo, 24 erano stati sottoposti a procedura concomitante di stenting carotideo. Tali pazienti sono stati esclusi dal riepilogo di efficacia riportato qui di seguito, a dare una coorte di efficacia primaria composta da 96 pazienti trattati con dispositivo di recupero Trevo I pazienti sottoposti a trombolisi I.A. o ad altro trattamento di trombectomia meccanica dopo dispositivo di recupero Trevo sono stati annoverati tra i casi non a buon fine nei riepiloghi di efficacia riportati di seguito.

Criteri chiave di inclusione per MR CLEAN

Ictus ischemico acuto con occlusione confermata a carico di ICA, M1, M2, A1 o A2, trattamento entro 6 ore dall'insorgenza dei sintomi, punteggio NIHSS >2, esclusione di emorragia intracranica confermata dall'imaging TC o RM; fornitura di consenso informato; età pari o superiore a 18 anni.

Criteri chiave di inclusione per il sottogruppo con dispositivo di recupero Trevo

Ulteriori criteri chiave di inclusione per l'analisi del sottogruppo trattato con il dispositivo di recupero Trevo (coorte FDA) nello studio MR CLEAN: trattamento di prima linea con dispositivo di recupero Trevo e trattamento endovenoso con attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA I.V.) entro 3 ore dall'insorgenza dei sintomi.

Criteri chiave di esclusione per MR CLEAN

Pressione arteriosa >185/110 mm Hg; glicemia <2,7 o >22,2 mmol/L; trattamento endovenoso con terapia trombolitica in dose superiore a 0,9 mg/kg di Alteplase o 90 mg; trattamento endovenoso con terapia trombolitica nonostante le controindicazioni (ad es., chirurgia maggiore, sanguinamento gastrointestinale o sanguinamento del tratto urinario entro le 2 settimane precedenti, o puntura arteriosa in un sito non compromibile nei 7 giorni precedenti; infarto cerebrale nell'area di distribuzione dell'arteria oclusa entro le 6 settimane precedenti, evidenza diagnostica di anomalie della coagulazione (ad es., conta piastrinica <40 x 10^3/L, APTT >50 sec., o INR >3,0).

L'endpoint di efficacia primario è stato quello di dimostrare che procedura di trombectomia con dispositivo di recupero Trevo più gestione clinica (GC) porta a una maggiore indipendenza funzionale (mRS <3) a 90 giorni rispetto alla sola gestione clinica (GC) in pazienti eleggibili che sono andati incontro a ictus ischemico acuto. Sulla base dell'analisi, il trattamento IAT dispositivo di recupero Trevo ha comportato un effetto di trattamento molto significativo se aggiustato per sito, trattamento endovenoso con attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA I.V.) e punteggio NIHSS al baseline.

Endpoint primario di efficacia

Variabile	Rapporto per variabili binarie	Odds Ratio [95% IC]	Valore p
Trevo® con esclusione di stenting carotideo concomitante	Trevo vs GC	1,88 [1,07, 3,29]	0,014 ¹
t-PA I.V.	Si vs No	1,45 [0,60, 3,52]	0,4134 ²
NIHSS	>14 o ≤14	0,41 [0,24, 0,69]	0,0010 ²

¹Test t unilaterale.²Test t bilaterale.**Distribuzione di mRS a 90 giorni***

mRS	Trevo con esclusione di stenting carotideo concomitante (N=96)	MR CLEAN/Controllo a 90 giorni (N=249)
0	4,2% (4/96)	0,4% (1/249)
1	8,3% (8/96)	5,2% (13/249)
2	17,7% (17/96)	13,7% (34/249)
3	15,6% (15/96)	16,5% (41/249)
4	32,3% (31/96)	31,3% (78/249)
5	7,3% (7/96)	10,4% (26/249)
6	14,6% (14/96)	22,5% (56/249)
mRS [0, <3] con qualsiasi trattamento da trombolisi I.A. considerato non a buon fine*	29,2% (28/96)	19,3% (48/249)

^{*}I pazienti con trattamento di trombolisi I.A. considerato non a buon fine^{*}Pazienti di entrambi i bracci che hanno ricevuto il trattamento endovenoso con attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA I.V.) entro 3 ore (81 pazienti su 96 nella coorte del dispositivo di recupero Trevo e 224 su 249 nel braccio di gestione clinica).

L'analisi dell'obiettivo di sicurezza primario è stata definita come il tasso di mortalità per qualsiasi causa tra dispositivo di recupero Trevo più gestione clinica e il tasso di mortalità per qualsiasi causa nel gruppo di controllo con sola gestione clinica.

	Corte Trevo FDA % (x/n) (LCL, UCL) ¹	GC (Gestione clinica) % (x/n) (LCL, UCL) ¹
Mortalità a 90 giorni	13,33 (16/120) (7,82, 20,75)	22,89 (57/249) (17,82, 28,62)

¹Intervalli di confidenza bilaterale al 95% secondo il metodo esatto di Clopper-Pearson.

Il primo endpoint secondario di efficacia è stato la percentuale di pazienti senza occlusione intracranica verificata tramite riesame di consenso da parte di un massimo di 3 revisori, a 24 ore. L'endpoint è stato verificato con CTA (tomografia computerizzata angiografica) e MRA (risonanza magnetica angiografica) utilizzando la scala Arterial Occlusive Lesion (AOL).

	Trevo con esclusione di stenting carotideo concomitante % (x/N) (LCL, UCL) ²	GC % (x/N) (LCL, UCL) ²
Senza occlusione (24 ore)	77,5% (62/80) (66,8, 86,1)	33,51 (65/194) (26,90, 40,62)

¹I pazienti non sottoposti a CTA e MRA a 24 ore sono stati esclusi da questa analisi²Intervalli di confidenza bilaterale al 95% secondo il metodo esatto di Clopper-Pearson.

Il secondo endpoint secondario di efficacia è stato la percentuale di pazienti con dispositivo di recupero Trevo che hanno conseguito la ricalanizzazione (TICI 2a o superiore). Questo endpoint è stato verificato anche tramite riesame di consenso da parte di almeno tre revisori.

	Trevo con esclusione di stenting carotideo concomitante % (x/N) (LCL, UCL) ¹
Successi di rivascolarizzazione (TICI ≥2a)	81,3% (78/96) (72,0, 88,5)

¹Intervalli di confidenza bilaterale al 95% secondo il metodo esatto di Clopper-Pearson.

Il terzo endpoint di efficacia è stato definito come la differenza tra risultati neurologici valutati secondo il punteggio NIHSS a 24 ore e dopo 5-7 giorni dalla randomizzazione tra trattamento con dispositivo di recupero Trevo più gestione clinica e gruppo di controllo GC (gestione clinica).

NIHSS	Trevo con esclusione di stenting carotideo concomitante Media ± DS (N) Mediana (Min, Max) (LCL, UCL) ²	MM Media ± DS (N) Mediana (Min, Max) (LCL, UCL) ²
NIHSS (24 ore)	14,23 ±9,23 (96) 14,00 (1, 42) (12,36, 16,10)	16,19 ±7,77 (240) 16 (0, 42) (15,20, 17,18)
NIHSS (5-7 giorni) ¹	13,02 ±12,16 (94) 12,00 (0, 42) (10,53, 15,51)	15,76 ±11,49 (237) 15 (0, 42) (14,29, 17,23)

¹I pazienti senza punteggio NIHSS sono stati esclusi da questa analisi. Ai pazienti deceduti prima della dimissione è stato assegnato un punteggio NIHSS di 42.²Limi di confidenza bilaterale al 95% per approssimazione normale.

La seguente tabella riassume tutti gli effetti indesiderati occorsi nei 90 giorni successivi alla randomizzazione ai pazienti nella coorte del dispositivo di recupero Trevo, utilizzando la categorizzazione adottata nello studio MR CLEAN. In tutte le analisi di sicurezza sono stati inclusi pazienti sottoposti a dispositivo di recupero Trevo, con o senza stent carotideo.

Classe MR CLEAN	Coorte Trevo FDA 120 pazienti con/189 eventi % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Numero di eventi	GC (Gestione clinica) 249 pazienti con/331 eventi % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Numero di eventi
Ictus ischemico	2,5% (3/120) [0,5%, 7,1%] 3	0,8% (2/249) [0,1%, 2,9%] 2
Emorragia sintomatica intracranica	7,5% (9/120) [3,5%, 13,8%] 9	6,8% (17/249) [4,0%, 10,7%] 17
Emorragia extracranica	2,5% (3/120) [0,5%, 7,1%] 3	4,4% (11/249) [2,2%, 7,8%] 11
Ischemia cardiaca	0	2,0% (5/249) [0,7%, 4,6%] 5
Reazione allergica	1,7% (2/120) [0,2%, 5,9%] 2	0,4% (1/249) [0,0%, 2,2%] 1
Polmonite	18,3% (22/120) [11,9%, 26,4%] 24	19,3% (48/249) [14,6%, 24,7%] 52
Altra infezione	23,3% (28/120) [16,1%, 31,9%] 34	13,7% (34/249) [9,6%, 18,6%] 41
Altra complicanza	47,5% (57/120) [38,3%, 56,8%] 89	38,6% (96/249) [32,5%, 44,9%] 154
Progressione dell'ictus	20,8% (25/120) [14,0%, 29,2%] 25	18,9% (47/249) [14,2%, 24,3%] 48

¹Intervalli di confidenza bilaterale al 95% secondo il metodo esatto di Clopper-Pearson

La seguente tabella riassume tutti gli effetti indesiderati dello studio MR CLEAN occorsi nei 90 giorni successivi alla randomizzazione, per la coorte FDA, secondo la codifica MeDRA.

Eventi avversi dello studio MR CLEAN codificati secondo MeDRA versione 18.0 per la coorte FDA oltre l'1% di frequenza

Termine MedDRA preferito	Corte Trevo® FDA (N=120) Pazienti con eventi (%)	Controllo (N=249) Pazienti con eventi (%)
Ictus in evoluzione	19 (15,8%)	41 (16,5%)
Emorragia intracranica	13 (10,8%)	20 (8,0%)
Infezione dell'apparato urinario	11 (9,2%)	17 (6,8%)
Fibrillazione atriale	10 (8,3%)	10 (4,0%)
Piressia	6 (5,0%)	6 (2,4%)
Scompenso neurologico	6 (5,0%)	6 (2,4%)
Polmonite da aspirazione	5 (4,2%)	8 (3,2%)
Delirio	4 (3,3%)	6 (2,4%)
Innesto osseo	4 (3,3%)	1 (0,4%)
Insufficienza cardiaca	3 (2,5%)	7 (2,8%)
Diarrea	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Urosepsi	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Caduta	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Cefalea	3 (2,5%)	1 (0,4%)
Ictus ischemico	3 (2,5%)	1 (0,4%)
Arresto cardiaco	2 (1,7%)	0
Reazioni di ipersensibilità	2 (1,7%)	1 (0,4%)
Infezione da Clostridium difficile	2 (1,7%)	0
Gotta	2 (1,7%)	3 (1,2%)
Disseccazione carotidea	2 (1,7%)	0
Epilessia	2 (1,7%)	3 (1,2%)
Depressione	2 (1,7%)	4 (1,6%)
Ritenzione urinaria	2 (1,7%)	2 (0,8%)
Embolia polmonare	2 (1,7%)	6 (2,4%)
Ematoma	2 (1,7%)	2 (0,8%)
Anaemia	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Bradicardia	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Convulsioni	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Insufficienza respiratoria	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Intubazione gastrointestinale	1 (0,8%)	5 (2,0%)
Ipotensione	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Flebite	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Vasospasmo	1 (0,8%)	0
Aritmia	0	3 (1,2%)
Ischemia miocardica	0	3 (1,2%)
Insufficienza renale	0	3 (1,2%)
Trombosi venosa profonda	0	3 (1,2%)

Studio TREVO 2 di supporto all'indicazione per l'uso 2

Lo studio clinico TREVO 2 [Thrombectomy REvascularization of large Vessel Occlusions in acute ischemic stroke (Trombectomy Rivascolarizzazione di estese Occlusioni Vascolari nell'ictus ischemico acuto)] ha valutato la sicurezza e l'efficacia del dispositivo di recupero Trevo rispetto al dispositivo di recupero Merci® Retriever. Centosettantotto (178) pazienti sono stati arruolati e randomizzati per il trattamento con dispositivo di recupero Trevo (N = 88) o dispositivo di recupero Merci (N = 90). I criteri chiave di inclusione sono stati: pazienti con estesa occlusione vascolare non elegibili o non responsivi al trattamento endovenoso con attivatore tissutale del plasminogeno (t-PA I.V.) che potevano essere trattati entro 8 ore dall'insorgenza dei sintomi di ictus; età 18-85; ≤ NIHSS ≤ 29; e conferma angiografica di estesa occlusione vascolare persistente a carico di carotide interna, arterie cerebrale media (segmenti M1 e/o M2), arterie basilari e/o vertebrali. I criteri chiave di esclusione sono stati: stenosi in un vaso prossimale che richiede trattamento o che impedisce l'accesso al trombo con il dispositivo di studio assegnato.

L'endpoint primario di efficacia è stato la rivascolarizzazione, definita come flusso di punteggio TICI almeno 2, rilevato da un Laboratorio Centralizzato, dopo applicazione del dispositivo assegnato. I pazienti a cui il Laboratorio Centralizzato ha assegnato un punteggio TICI 2a al baseline e i pazienti mai sottoposti a trattamento con il dispositivo sono stati esclusi dalle analisi mostrate nella tabella seguente.

L'endpoint primario di sicurezza è stato l'incidenza di eventi avversi gravi correlati alla procedura (PREIG) nelle 24 ore successive alla procedura, definiti come: perforazione vascolare o dissezione arteriosa intramurale, emorragia cerebrale sintomatica sintomatica (sICH), embolizzazione in un'area precedentemente indenne, complicanze al sito di accesso che abbiano richiesto la riparazione chirurgica o una trasfusione di sangue, decesso nelle 24 ore, guasto del dispositivo (rottura *in vivo*) o qualsiasi altra complicanza giudicata come correlata alla procedura dalla Commissione per gli eventi clinici.

Endpoint dello studio TREVO 2

(Pazienti con punteggio TICI 0 o 1 al baseline, tentativo di studio dispositivo)

Endpoint	Trevo N=79 paz.	Merci N=81 paz.	Differenza [95% IC] ^b	Valore p
Endpoint primario di efficacia				
Successi di rivascolarizzazione post-dispositivo (TICI ≥2a)				
<i>Qualsiasi terapia aggiuntiva utilizzata considerata come non andata a buon fine</i>	79,7% (63/79)	49,4% (40/81)	30,4%	<0,0001 ^c
[95% Inter. Conf.] ^a	[69,2%, 88,0%]	[38,1%, 60,7%]	[15,0%, 44,1%]	<0,0001 ^d
Successi di rivascolarizzazione post-dispositivo (TICI ≥2a)				
<i>Qualsiasi trattamento di trombolisi I.A. considerato come non andato a buon fine</i>	87,3% (69/79)	58,0% (47/81)	29,3%	<0,0001 ^c
[95% Inter. Conf.] ^a	[78,0%, 93,8%]	[46,5%, 68,9%]	[15,0%, 42,4%]	<0,0001 ^d
Endpoint primario di sicurezza				
Eventi compositi	13,9% (11/79)	23,5% (19/81)	-9,5% [-22,1%, 2,8%]	0,1567 ^e
[95% Inter. Conf.] ^a	[7,2%, 23,6%]	[14,8%, 34,2%]		
Perforazione del vaso	0,0% (0/79)	9,9% (8/81)	-9,9% [-18,5%, -3,9%]	
Dissezione arteriosa intramurale	0,0% (0/79)	1,2% (1/81)	-1,2% [-6,7%, 3,5%]	
ICH sintomatica	5,1% (4/79)	9,9% (8/81)	-4,8% [-14,1%, 3,8%]	
Embolizzazione di una area precedentemente indenne	7,6% (6/79)	4,9% (4/81)	2,7% [-5,6%, 11,4%]	
Complicanza al sito di accesso che esige riparazione chirurgica o trasfusione di sangue	1,3% (1/79)	0,0% (0/81)	1,3% [-3,3%, 6,9%]	
Mortalità entro le 24 ore	1,3% (1/79)	0,0% (0/81)	1,3% [-3,3%, 6,9%]	
Guasto del dispositivo in vivo	0,0% (0/79)	0,0% (0/81)	0,0% [-4,6%, 4,6%]	
Altri PR-EIG	0,0% (0/79)	0,0% (0/81)	0,0% [-4,6%, 4,6%]	
mRS 0-2 a 90 giorni	38,2% (29/76)	17,9% (14/78)	20,2% [6,4%, 34,1%]	0,0068 ^e

a: Intervalli di confidenza esatti di Clopper-Pearson su singole proporzioni; Intervalli di confidenza esatti sulle differenze di proporzioni calcolate con StatXact versione 8; c: Ipotesi di non inferiorità usando il metodo di Blackwelder con margine di non inferiorità del 10%; d: Test esatto di superiorità di Fisher monolaterale; e: Test esatto di Fisher bilaterale.

GARANZIA

Stryker Neurovascular garantisce che questo strumento è stato progettato e costruito con cura ragionevole. La presente garanzia sostituisce ed esclude tutte le altre garanzie non espressamente stabilite nella presente, siano esse esplicite o implicite ai sensi di legge o altrimenti, compresa, in modo non esclusivo, qualsiasi garanzia implicita di commercialibilità o idoneità a uno scopo particolare. Le condizioni di trattamento, conservazione, pulizia e sterilizzazione di questo strumento, nonché altri fattori relativi al paziente, alla diagnosi, al trattamento, agli interventi chirurgici e altri elementi al di là del controllo di Stryker Neurovascular, influiscono direttamente sullo strumento stesso e sui risultati del suo impiego. L'obbligo di Stryker Neurovascular in base alla presente garanzia è limitato alla riparazione o sostituzione di questo strumento. Stryker Neurovascular non potrà essere ritenuta responsabile di perdite, spese o danni diretti o indiretti, derivanti direttamente o indirettamente dall'uso di questo strumento. Stryker Neurovascular non si assume, né autorizza alcuno ad assumerisi a suo nome, alcun altro tipo di obbligo o responsabilità in relazione a questo strumento. **Stryker Neurovascular non si assume alcuna responsabilità per strumenti riutilizzati, ritrattati o risterilizzati e non offre alcuna garanzia, né implicita né esplicita, inclusa, in modo non limitativo, ogni garanzia di commercialibilità o di idoneità a scopo particolare, per tali strumenti.**

Trevo® verwijderinstrument

Rx ONLY

Let op: De Amerikaanse federale wetgeving bepaalt dat dit hulpmiddel slechts door of namens een arts kan worden gekocht.

WAARSCHUWING

De inhoud is gesteriliseerd volgens een ethyleenoxide(EO)-proces en wordt STERIEL geleverd. Niet gebruiken indien de steriele barrière is beschadigd. Neem contact op met uw Stryker Neurovascular-vertegenwoordiger als er schade wordt aangetroffen.

Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan de structurele integriteit van het hulpmiddel aantasten en/of het defect raken van het hulpmiddel tot gevolg hebben, hetgeen kan resulteren in letsel, ziekte of de dood van de patiënt. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren brengt tevens het gevaar van verontreiniging van het hulpmiddel met zich mee en/of kan infectie of kruisinfeksie van de patiënt veroorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overdracht van (een) besmettelijke ziekte(s) tussen patiënten. Verontreiniging van het hulpmiddel kan letsel, ziekte of de dood van de patiënt veroorzaken.

Werp dit product en het verpakkingsmateriaal na gebruik weg volgens het hiervoor geldende beleid van de instelling en de overheid.

BESCHRIJVING VAN HULPMIDDEL

Het verwijderinstrument bestaat uit een flexibele, taps toelopende kern met een gevormd gedeelte aan het distale uiteinde. De platinamarkeringen aan het distale uiteinde zorgen voor fluoroscopische visualisering. Bovendien is het gevormde deel radiopaak. De afmetingen van het verwijderinstrument zijn aangegeven op het productetiket. Het verwijderinstrument heeft een hydrofiele coating om frictie tijdens het gebruik te reduceren. Het verwijderinstrument heeft een hulsmarkering die aangeeft hoe dicht de tip van het verwijderinstrument bij de microkathetertip is. Een met het verwijderinstrument meegeleverd torsie-instrument maakt het hanteren gemakkelijker. Het torsie-instrument wordt gebruikt om de kerndraad aan de microkatheter te koppelen tijdens de procedure. Door koppeling van het torsie-instrument met de draad kunnen de microkatheter en het verwijderinstrument als een systeem worden teruggetrokken tijdens het verwijderen van de prop. Voor het inbrengen van het verwijderinstrument in een microkatheter wordt een inbrenginstrument geleverd. Het inbrenginstrument is een huls waarin het verwijderinstrument is voorgeladen. Wanneer het verwijderinstrument voor de helft in de microkatheter is ingebracht, wordt het inbrenginstrument verwijderd. Verwijderinstrumenten hebben een gemodificeerde proximaal uiteinde waaraan de Abbott Vascular DOC voerdraadextensie kan worden bevestigd (REF 22260). Het koppelen van de voerdraadextensie aan het verwijderinstrument vergemakkelijkt het verwijderen of vervangen van een katheter terwijl het verwijderinstrument op zijn plaats blijft. Als de vervanging is voltooid, kan de extensie worden losgemaakt.

Informatie voor de gebruiker

Het Trevo verwijderinstrument mag alleen gebruikt worden door artsen met een opleiding in endovasculaire interventieprocedures.

Inhoud

Een (1) Trevo verwijderinstrument

Een (1) torsie-instrument

Een (1) inbrenginstrument

Compatibiliteit

Maat verwijderinstrument	Trevo Pro14 microkatheter	Trevo Pro18 microkatheter	Excelsior® XT-27® microkatheters (150 x 6 cm recht REF XT275081)	Aanbevolen minimale binnendiameter bloedvat (mm)
Trevo XP ProVue 3 X 20 mm	✓	✓		
Trevo XP ProVue 4 X 20 mm		✓		
Trevo ProVue 4 X 20 mm		✓		
Trevo XP ProVue 4 X 30 mm		✓	✓	
Trevo XP ProVue 6 X 25 mm			✓	2,5

Het verwijderinstrument is niet compatibel met andere microkatheters. Het verwijderinstrument functioneert mogelijk minder goed bij gebruik van andere microkatheters.

Ballongeleidekatheters (zoals de Merci® en de FlowGate®) worden aanbevolen voor gebruik bij procedures voor trombusverwijdering.

Verwijderinstrumenten zijn compatibel met de Boston Scientific draaibare hemostaseklep (REF 421242).

Verwijderinstrumenten zijn compatibel met de Abbott Vascular DOC voerdraadextensie (REF 22260).

BEHOOG GEBRUIK/INDICATIES VOOR GEBRUIK

1. Het Trevo verwijderinstrument is geïndiceerd voor het herstellen van de bloedstroom in de neurovasculatuur door trombusverwijdering ter behandeling van een acute ischemische beroerte, om beperkingen te reduceren bij patiënten met aanhoudende grote bloedvatocclusie in de proximale anterieure circulatie of infarcten met kleinere kern die eerst intraveneus weefselplasminogenactivator (IV t-PA) hebben ontvangen. Endovasculaire therapie met het instrument moet binnen 6 uur na aanvang van de symptomen, worden begonnen.
2. Het Trevo verwijderinstrument is geïndiceerd voor gebruik bij het herstel van de bloedstroom in de neurovasculatuur binnen 8 uur na aanvang van de symptomen, door trombus te verwijderen bij patiënten die een ischemische beroerte hebben gehad. Patiënten die niet in aanmerking komen voor intraveneus weefselplasminogenactivator (IV t-PA) en patiënten die niet op IV t-PA-behandeling reageren, komen in aanmerking voor behandeling.
3. Het Trevo verwijderinstrument is geïndiceerd voor gebruik bij het herstel van de bloedstroom in de neurovasculatuur door trombusverwijdering ter behandeling van een acute ischemische beroerte, om beperkingen te reduceren bij patiënten met aanhoudende grote bloedvatocclusie in de proximale anterieure circulatie van de a. carotis interna of segmenten van de a. cerebi media (MCA)-M1-segmenten met kleinere kerninfarcten (0-50 cc voor leeftijden < 80 jaar, 0-20 cc voor leeftijden ≥ 80 jaar). Endovasculaire therapie met het instrument moet beginnen binnen 6 - 24 uur na 'last-seen-well' bij patiënten die niet in aanmerking komen voor intraveneus weefselplasminogenactivator (IV t-PA) of die niet op IV t-PA reageren.

CONTRA-INDICATIES

Geen bekend.

WAARSCHUWINGEN

SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR INDICATIE 1

- De veiligheid en werkzaamheid van de Trevo verwijderinstrumenten voor het reduceren van beperkingen is niet bewezen voor patiënten met grote kerninfarcten (d.w.z. ASPECTS ≤ 7). Bij deze patiënten kunnen risico's zoals intracerebrale bloeding groter zijn.
- De veiligheid en werkzaamheid van de Trevo verwijderinstrumenten voor het reduceren van beperkingen is niet bewezen voor patiënten met oclusies in de posterieve circulatie (zoals in de basilaire en vertebrale arteriën) of voor meer distale oclusies in de anterieure circulatie.

SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR INDICATIE 2

- Om de kans op bloedvatletsel te beperken is het belangrijk het verwijderinstrument af te stemmen op de bloedvatdiameter op de beoogde gebruikslocatie.

SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR INDICATIE 3

- De veiligheid en werkzaamheid van de Trevo verwijderinstrumenten voor het reduceren van beperkingen is niet bewezen voor patiënten met grote kerninfarcten (d.w.z. ASPECTS ≤ 7). Bij deze patiënten kunnen risico's zoals intracerebrale bloeding groter zijn.
- De veiligheid en werkzaamheid van de Trevo verwijderinstrumenten voor het beperken van handicaps is niet bewezen voor patiënten met oclusies in de posterieve circulatie (zoals in de basilaire en vertebrale arteriën) of voor meer distale oclusies in de anterieure circulatie.
- Gebruikers moeten de analysetechnieken van hun beeldvormingssoftware valideren om zeker te zijn van robuuste en consistente resultaten voor het beoordelen van de grootte van een kerninfarct.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN BIJ ALLE INDICATIES

- Toediening van IV t-PA moet plaatsvinden binnen het door de FDA goedgekeurde tijdsbestek (binnen 3 uur na aanvang van de symptomen van de het infarct).
- Houd u aan de volgende aanbevelingen om de kans op bloedvatbeschadiging te reduceren:
 - Doe niet meer dan zes (6) verwijderingspogingen in hetzelfde bloedvat met verwijderinstrumenten.
 - Laat het verwijderinstrument in het bloedvat op zijn plaats wanneer u een microkatheter verwijdert of vervangt.
- Houd u aan de volgende aanbevelingen om de kans op knikken/breken te beperken:
 - Positioneer de marker van de microkathetertip net proximaal van het gevormde gedeelte onmiddellijk nadat het verwijderinstrument uit de huls is. Houd de marker van de microkathetertip net proximaal van het gevormde gedeelte van het verwijderinstrument tijdens het manipuleren en het terugtrekken.
 - Het verwijderinstrument niet roteren of draaien.
 - Voorzichtig bij het passeren van het verwijderinstrument door arteriën met stent.

- Het verwijderinstrument is een delicate instrument dat voorzichtig moet worden behandeld. Inspecteer het instrument voor, en zo mogelijk tijdens gebruik om beschadigingen. Gebruik geen instrumenten die tekenen van beschadiging vertonen. Beschadigingen kunnen ertoe leiden dat het instrument niet functioneert en kunnen complicaties veroorzaken.
- Het verwijderinstrument niet opvoeren of terugtrekken bij weerstand of bij significant vasospasme. Het bewegen of draaien tegen weerstand of significant vasospasme in kan het bloedvat en het instrument beschadigen. Beoordeel de oorzaak van de weerstand met behulp van de fluoroscoop en voer het instrument zo nodig terug in de huls om het terug te trekken.
- Draai het verwijderinstrument niet als hij moeilijk uit het bloedvat terug te trekken is. Voer de microkatheter distaal op en trek het verwijderinstrument voorzichtig terug in de microkatheter en verwijder het verwijderinstrument en de microkatheter als een geheel. Als bij het terugtrekken van het verwijderinstrument weerstand wordt ondervonden, overweeg dan het verwijderinstrument te verlengen met de Abbott Vascular DOC voerdraadextensie (REF 22260), zodat de microkatheter kan worden vervangen door een andere met groter diameter, zoals een DAC®-katheter. Trek het verwijderinstrument voorzichtig terug in de katheter met de grotere diameter.
- Dien anticoagulante en trombocytenaggregatiemmers toe volgens de standaard richtlijnen van uw instelling.
- Gebruikers dienen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de röntgenstralingsdosis voor de patiënt en henzelf te beperken door gebruik te maken van afdoende afscherming, beperken van de fluoroscopietijd en waar mogelijk het modificeren van röntgentechnische factoren.

VOORZORGSMAAATREGELEN

- Koel, droog en donker bewaren.
- Geopende of beschadigde verpakkingen niet gebruiken.
- Gebruiken vóór de uiterste gebruiksdatum.
- Blootstelling aan temperaturen boven de 54 °C (130 °F) kan het instrument en de accessoires beschadigen. Niet autoclaveren.
- Verwijderinstrument niet blootstellen aan oplosmiddelen.
- Gebruik het verwijderinstrument in combinatie met fluoroscopische beeldvorming en adequate anticoagulantia.
- Handhaaf een constante infusie van een geschikte spoelvloeistof tussen de geleidekatheter en de microkatheter en tussen de microkatheter en het verwijderinstrument of de voerdraad, om trombusvorming en kristallisatie van contrastmedium te voorkomen.
- Bevestig geen torsie-instrument aan het gevormde proximale uiteinde van het DOC-compatibele verwijderinstrument. Er kan schade optreden, waardoor het bevestigen van een DOC voerdraadextensie onmogelijk wordt.

COPMPLICATIES

Procedures waarvoor percutane katheterintroductie nodig is moeten niet worden uitgevoerd door artsen die niet vertrouwd zijn met de mogelijke complicaties die kunnen optreden tijdens en na de procedure. Mogelijke complicaties zijn onder meer, maar niet uitsluitend:

- luchtembolie
- hematoom of bloeding op de punctielocatie
- infectie
- distale embolisatie
- pijn/hoofdpijn
- vaatspasme
- trombose
- dissectie
- perforatie
- embolie
- acute occlusie
- ischemie
- intracraniële bloeding
- ontstaan van pseudoaneurysma
- neurologische deficits, waaronder beroerte
- overlijden

Het gebruik van dit instrument vereist fluoroscopie, wat risico's door blootstelling aan röntgenstraling met zich meebrengt voor artsen en patiënten. De risico's zijn onder meer, maar niet uitsluitend:

- alopecia,
- verbranding, variërend in ernst van rode huid tot ulceraties,
- cataract,
- vertraagde neoplasie

Melding van complicaties

Informeer onmiddellijk uw contactpersoon bij Stryker Neurovascular als een instrument defecten vertoont of als zich bij de patiënt een complicatie of letsel voordoet of wordt vermoed. Probeer als het enigszins mogelijk ieder verdacht instrument, de bijbehorende componenten en al het verpakkingsmateriaal te bewaren voor terugzending naar Stryker Neurovascular.

LEVERING

De producten van Stryker Neurovascular zijn steriel en niet-pyrogeen in de ongeopende verpakking, die zo is ontworpen dat de steriliteit gehandhaafd blijft totdat de binnenste productverpakking wordt geopend of beschadigd raakt.

Niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is.

Niet gebruiken als de etikettering onvolledig of onleesbaar is.

Hantering en opslag

Koel, droog en donker bewaren.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Anbevolen voorbereidingsprocedure

- Spoel de verpakkingsring van het verwijderinstrument met zoutoplossing. Hydreer gedurende minimaal 2 minuten voor u het verwijderinstrument uit de ring neemt. Houd het verwijderinstrument gehydrereerd.
- Prepareer en plaats de ballongeleidekatheter of de geleidekatheter in de a. carotis interna, de a. carotis communis of de a. subclavia volgens de instructie op de katherverpakking.
- Verbind de draaibare hemostaseklep met de connector van de microkatheter.
- Gebruik conventionele katheterisatietechnieken om de microkatheter in het doelbloedvat te plaatsen met behulp van een standaard neurovasculaire voerdraad. Plaats de tip van de microkatheter, als de anatomie dat toelaat, distaal van de trombus.
- Neem de voerdraad uit de microkatheter. Injecteer contrastvloeistof via de microkatheter voor visualisatie van de distale vasculatuur. Spoel de microkatheter door.
- Verwijder het inbrenginstrument en het voorgeladen verwijderinstrument samen als eenheid uit de verpakkingsring. Laat het verwijderinstrument niet uit het inbrenginstrument steken of verder teruggetrokken in het inbrenginstrument.
- Belangrijk:** Breng het inbrenginstrument halverwege in de draaibare hemostaseklep en gebruik een injectiespuit of infusilijn om het inbrenginstrument door te spoelen totdat zoutoplossing uit het proximale uiteinde van het inbrenginstrument komt. Als het inbrenginstrument niet goed wordt doorgespoeld, kan het moeilijk zijn het verwijderinstrument door het inbrenginstrument op te voeren.
- Plaats het inbrenginstrument in de connector van de microkatheter en draai de draaibare hemostaseklep stevig dicht om het inbrenginstrument op zijn plaats te houden.
- Voer het verwijderinstrument op tot de helft van zijn lengte zich in de microkatheter bevindt. Verwijder het inbrenginstrument.

Anbevolen verwijderprocedure

- Voer het verwijderinstrument op tot de distale tip op één lijn is met de distale tip van de microkatheter.

Opmaking: De volgende tabel beschrijft waar de tip van de verwijderinstrument (het distale uiteinde van het instrument) zich bevindt ten opzichte van de tip van de microkatheter (het distale uiteinde van de microkatheter) wanneer:

- het distale uiteinde van de hulsmarkering op het verwijderinstrument de connector van de microkatheter bereikt, of
- de hulsmarkering van het proximale uiteinde van het verwijderinstrument het proximale einde van de draaibare hemostaseklep bereikt.

Controletafel distale uiteinde

Trevo® ProVue 4 x 20 mm Trevo XP 4 x 20 mm Trevo XP 6 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> Minder dan 8 cm buiten de microkathetertip
Trevo XP 3 x 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> Minder dan 15 cm buiten de microkathetertip
Trevo XP 4 x 30 mm	<p>Bij gebruik in combinatie met Trev Pro 18 MC (90238):</p> <ul style="list-style-type: none"> Minder dan 8 cm buiten de microkathetertip <p>Bij gebruik in combinatie met Excelsior® XT-27® MC (XT275081):</p> <ul style="list-style-type: none"> Minder dan 15 cm buiten de microkathetertip

- Trek de microkatheter terug terwijl u zachtjes voorwaartse druk uitoefent op het verwijderinstrument om het gevormde gedeelte van het verwijderinstrument in de prop te activeren. Plaats de markering van de microkathetertip net proximaal van het gevormde deel van het verwijderinstrument.

WAARSCHUWING: Houd de markering van de microkathetertip net proximaal van het gevormde gedeelte van het verwijderinstrument tijdens het manipuleren en het terugtrekken.

3. Breng na activeren van het verwijderinstrument het uitvouwen van de steunen in beeld, en laat voldoende tijd om de prop in het verwijderinstrument te laten integreren (ongeveer 5 minuten).
4. Als u een ballongeleidekatheret gebruikt, vul dan de ballon zo dat het bloedvat is afgesloten, zoals aangegeven op het etiket van de ballongeleidekatheret.
5. Plaats en vergrendel het torsie-instrument op het verwijderinstrument bij de connector van de microkatheret.
6. Trek het verwijderinstrument en de microkatheret langzaam als een geheel terug naar de tip van de ballongeleidekatheret, onder toediening van aspiratie op de ballongeleidekatheret met een 60 mL-injectiespuit.
7. Oefen krachtige aspiratie uit op de ballongeleidekatheret met een 60 mL-injectiespuit en trek het verwijderinstrument en de microkatheret terug in de geleidekatheret. Ga door met aspireren tot het verwijderinstrument en de microkatheret bijna uit de geleidekatheret zijn getrokken.

Opmerking: Als terugtrekken in de ballongeleidekatheret of geleidekatheret moeilijk gaat, laat de ballongeleidekatheret en leeglopen en trek tegelijk de geleidekatheret, de microkatheret en het verwijderinstrument als een geheel door de huls. Verwijder zo nodig de huls.

8. Laat de ballon van de ballongeleidekatheret leeglopen.
9. Ontkoppel de draaibare hemostaseklep van de ballongeleidekatheret en verwijder verwijderinstrument en de microkatheret en de draaibare hemostaseklep als een geheel uit de geleidekatheret.
10. Bevestig een 60 mL-injectiespuit aan de connector van de ballongeleidekatheret en aspireer.
11. Reinig het instrument met zoutoplossing. Inspecteer het verwijderinstrument op beschadigingen. Gebruik het verwijderinstrument niet opnieuw als de kerndraad, het gevormde deel of de platinaspiraal er anders uitzen dan toen ze niet uit de verpakking kwamen. Het verwijderinstrument mag voor maximaal drie (3) verwijderingspogingen worden gebruikt, mits onbeschadigd. Een verwijderingspoging is een (1) cyclus van opvoeren en volledige terugtrekking.

Procedure voor verwisselen van de ballonkatheret

1. Volg de gebruiksaanwijzingen van de Abbott Vascular DOC voerdraadextensie, maar behandel 'verwijderinstrument' als de 'voerdraad' bij het volgen van de stappen in de gebruiksaanwijzing.

KLINISCHE ONDERZOEKEN

Veiligheids- en werkzaamheidsinformatie

DAWN™ onderzoek ter ondersteuning van indicatie 3

DAWN (DWI and CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention) was een prospectief, gerandomiseerd, multicenter, gecontroleerd onderzoek op de hypothese dat trombectomie met het Trevo® verwijderinstrument plus medicamenteuze behandeling betere klinische resultaten oplevert na 90 dagen dan alleen medische behandeling bij geschikt geselecteerde testpersonen die een acute cerebrale vasculair incident hebben ondervonden, wanneer de behandeling binnen 6-24 uur na last-seen-well wordt begonnen. In totaal 206 testpersonen werden in het onderzoek opgenomen op 26 onderzoekslocaties: 107 testpersonen (51,9%) werden random aan de behandelsconditie toegevoegd, 99 testpersonen (48,1%) werden aan de controleconditie toegevoegd. De gemiddelde UW-mRS-waarden na 90 dagen waren 5,5 in de behandelsconditie versus 3,4 in de controleconditie; het voor kerninfarct gecorrigeerde groepsverschil in naar utiliteit gewogen beperking was 2,0 (bij een 95% Bayesiërs geloofwaardigheidsinterval van 1,1 tot 3,0 en een *a posteriori*-waarschijnlijkheid van superioriteit > 0,9999). Behandeling met het Trevo verwijderinstrument leidde tot hogere scores van functionele onafhankelijkheid (mRS 0-2) na 90 dagen, 48,6% versus 13,1%; voor kerninfarct gecorrigeerde groepsverschil bedroeg 32,8% (bij een 95% Bayesiërs geloofwaardigheidsinterval van 21,1 tot 44,1%) en een *a posteriori*-waarschijnlijkheid van superioriteit > 0,9999. De frequentie van symptomatische intracraniele bloeding na 24 uur lag hoger bij patiënten die endovasculaire therapie kregen. Patiënten en/of hun wettelijk bevoegde vertegenwoordigers dienen van dit risico op de hoogte gesteld te worden tijdens het behandelingsbeslissingsproces. Het onzekerheidsniveau van de getoonde resultaten ligt hoger voor testpersonen in de groep 18-24 uur sinds last-seen-well.

Belangrijkste opnamecriteria

Patiënten met een acute ischemische beroerte met bevestigde oclusie van intracraniele a. carotis interna en/of M1 die niet op IV-t-PA reageerden of daarvoor gecontra-indiceerd waren, behandeling binnen 6-24 uur na tijdstip van last-seen-well, baseline NIHSS ≥ 10, geïnformeerde toestemming gegeven en leeftijd 18 jaar of ouder; patiënten onder de 80 met een herseninfarctscore van 10 of hoger moeten gekoppeld zijn met een kernvolume van minder dan 51 ml. Bij patiënten van 80 jaar of ouder moet de infarctscore groter zijn dan 10 en het volume minder dan 21 ml zijn. Klinische kern-mismatch, gedefinieerd als de afwijking tussen baseline-infarctvolume (of kern) op CT of MRI en de totale omvang van het bedreigde hersenweefsel. Het infarctvolume werd beoordeeld met behulp van een diffusie-gewogen kernspintomogram (MRI) of een perfusie-CT, en gemeten met een van de commercieel beschikbare geautomatiseerde softwarepakketten (RAPID, IschemiaView).

Belangrijkste uitsluitingscriteria

Snelle verbetering van de neurologische toestand naar een NIHSS < 10 of evidentie van bloedvatrecanalisatie voor de randomisatie; arteriële bloeddruk > 185/110 mmHg; laboratoriumevidentie van elektrolyt-onbalans (i.e. natrium < 130 mmol/L, kalium < 3 mEq/L of > 6 mEq/L); laboratoriumevidentie van nierinsufficiëntie (i.e. serumcreatinine > 3,0 mg/dL (264 µmol/L); laboratoriumevidentie van coagulatieafwijkingen (i.e. bloedplaatjes < 50.000/µL, APTT > 3 x normaal of INR > 3,0, indien Xa inhibitor gegeven 24-48 uur geleden moet PTT normaal zijn); laboratoriumevidentie van bloeding (i.e. hemoglobine < 7mmol/L).

Het primaire eindpunt was de beperking na 90 dagen, beoordeeld aan de hand van de gemonificeerde Rankin-schaal (mRS).

Het secundaire doel was het leveren van evidentie dat endovasculaire reperfusie met het Trevo verwijderinstrument samenhangt met een significante reductie in de mediene infarctgrootte vergeleken met de controlegroep na 24 (-6/+24) uur na randomisatie. De secundaire eindpunten omvatten een gedeelte van de testpersonen met goede functionele uitkomsten na 90 dagen (mRS van 0-2); een gedeelte van de testpersonen met NIHSS-afname van ≥ 10 punten van de baseline of een NIHSS-score van 0 of 1; verschil tussen behandelsconditie en controleconditie veroorzaakt mortaliteit; verschil in mediane finale infarctgrootte na 24 uur; verschil in revascularisatiefrequentie na 24 uur; en reperfusiefrequentie volgens TICI > 2b.

De veiligheidsuitkomsten omvatten incidentie van infarctgerelateerde mortaliteit na 90 dagen; incidentie van SICH, neurologische verslechtering, proceduregerelateerde en instrumentgerelateerde ernstige ongewenste voorvalen.

90-dagen gemonificeerde Rankin-schaal ITT-populatie

Gemonificeerde Rankin-schaal (mRS)	Behandelsconditie N=107	Controleconditie N=99
0 - geen symptomen / UW = 10	9,3% (10/107)	4,0% (4/99)
1 - geen significante beperkingen / UW = 9,1	22,4% (24/107)	5,1% (5/99)
2 - lichte beperking / UW = 7,6	16,8% (18/107)	4,0% (4/99)
3 - matige beperking / UW = 6,5	13,1% (14/107)	16,2% (16/99)
4 - vrij ernstige beperking / UW = 3,3	13,1% (14/107)	34,3% (34/99)
5 - ernstige beperking / UW = 0	6,5% (7/107)	18,2% (18/99)
6 - overleden / UW = 0	18,7% (20/107)	18,2% (18/99)
90-dagen mRS [0-2]	48,6% (52/107)	13,1% (13/99)
90-dagen gewogen mRS*		
Gemiddelde ± SD (N)	5,5 ± 3,8 (107)	3,4 ± 3,2 (99)
Mediaan (01, 03)	6,5 (0,0; 9,1)	3,3 (0,0; 6,5)
Bereik (min, max)	(0,0; 10,0)	(0,0; 10,0)
[95% betr.-interval] ¹	[4,8; 6,3]	[2,7; 4,0]

*Door normaalapproximatie

*mRS = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} werd een corresponderende numerieke waarde toegewezen = (10; 9,1; 7,6; 6,5; 3,3; 0,0) die de klinische bruikbaarheid weergeeft

Co-primaire uitkomsten ITT-populatie

Uitkomst	Interventie (N=107)	Controle (N=99)	Gemiddeld absoluut verschil (95% BI)	A posteriorigemiddelde voordeel, kern- gecorrigeerd (95% geloofwaardig- heidsinterval)	Superioriteits- waarschijnlijkheid
Naar utiliteit gewogen mRS-gemiddelde (SD)	5,5 (3,8)	3,4 (3,1)	2,1 (1,2; 3,1)	2,0 (1,1; 3,0)	> 0,9999 ¹
Functionele onafhankelijkheid (mRS 0-2)	48,6%	13,1%	35,5% (23,9%; 47,0%)	32,8% (21,1%; 44,1%)	> 0,9999

¹Geschat aan de hand van het Bayesiërs algemene lineaire model, gecorrigeerd voor kerninfarct

¹De gehele waarschijnlijkheid van een instrumentvoordeel wordt zodoende de voordeelwaarschijnlijkheid voor de aangerekende datasets, gewogen naar de aantrekkelijkheid van die datasets. Deze waarschijnlijkheid bedraagt 0,999986.

Het tweede secundaire werkzaamheidseindpunt was een NIHSS-afname van ≥ 10 punten van de baseline, of een NIHSS van 0 of 1.

Vroege neurologische respons op dag 5-7/ontslag

Uitkomst	Interventie N=107	Controle N=99	Gemiddeld absoluut verschil (95% BI)	Risicoverhouding (95% BI)	p-waarde
Vroege respons†	47,7%	19,2%	28,5% (16,2%; 40,7%)	2,5 (1,6; 3,9)	< 0,001

[†]Gedefinieerd als NIHSS-afname van ≥ 10 punten t.o.v. de baseline of NIHSS 0 of 1 op dag 5-7 of ontslag (wat het eerste optrat). De p-waarde werd niet gecorrigeerd voor multipliciteit.

De secundaire werkzaamheidsuitkomst was de revascularisatiefrequentie na 24 uur, gedefinieerd als de aanwezigheid van gedeeltelijke of volledige recanalisatie.

Revascularisatiefrequentie na 24 uur

	Totaal N=206	Behandelingsconditie N=107	Controleconditie N=99	Verschil [95% BI] ⁱ	p-waarde
Verschil in revascularisatiefrequentie na 24 (-6/+24) uur na randomisatie.	58,7% (121/206)	76,6% (82/107)	38,4% (38/99)	40,2% [27,1%, 51,5%]	< 0,0001 ^a

Revascularisatie na 24 uur was gedefinieerd als de aanwezigheid van gedeeltelijke of volledige recanalisatie

a. t-test. De p-waarde was niet gecorrigeerd voor multipliciteit.

Het primaire veiligheidspunt was de incidentie van infarctgerelateerde mortaliteit na 90 dagen. De secundaire veiligheidsuitkomsten voor zowel de behandelingsconditie als de controleconditie zijn de incidentie van SICH volgens ECASS-definitie binnen 24 (-6/+24) uur na randomisatie (tijdstip nul) en de incidentie van neurologische verslechtering van de baseline NIHSS-score tot aan dag 5-7/ontslag (wat het eerste optreden) na randomisatie. Neurologische verslechtering was gedefinieerd als een toename van ≥ 4 punten in NIHSS-score ten opzichte van de baseline.

Infarctgerelateerde mortaliteit na 90 dagen

	Totaal N=206	Behandelingsconditie N=107	Controleconditie N=99	Verschil [95% BI] ⁱ	p-waarde
Incidentie van alle infarctgerelateerde mortaliteit na 90 dagen	17,0% (35/206)	15,9% (17/107)	18,2% (18/99)	-2,3% [-12,6%, 8,0%]	0,7126 ^a

ⁱDoor normaalapproximatie

a. t-test. De p-waarde was niet gecorrigeerd voor multipliciteit.

De secundaire veiligheidsuitkomsten voor zowel de behandelingsconditie als de controleconditie zijn de incidentie van SICH volgens ECASS III-definitie binnen 24 (-6/+24) uur na randomisatie (tijdstip nul).

Incidentie van SICH volgens CEC-beoordeling

	Totaal N=206	Behandelingsconditie N=107	Controleconditie N=99	Verschil [95% BI] ⁱ	p-waarde
SICH na 24 (-6/+24) uur na randomisatie	4,4% (9/206)	5,6% (6/107)	3,0% (3/99)	2,6% [-2,9%, 8,1%]	0,5011 ^a

ⁱDoor normaalapproximatie

a. Fishers exact-test. De p-waarde was niet gecorrigeerd voor multipliciteit.

Incidentie van neurologische verslechtering was gedefinieerd als een toename van ≥ 4 punten in NIHSS-score ten opzichte van de baseline op dag 5-7/ontslag na randomisatie.

Incidentie van neurologische verslechtering volgens CEC-beoordeling

	Totaal N=206	Behandelingsconditie N=107	Controleconditie N=99	Verschil [95% BI] ⁱ	p-waarde
Incidentie van neurologische verslechtering tussen baseline en dag 5 tot 7/ontslag	19,9% (41/206)	14,0% (15/107)	26,3% (26/99)	-12,2% [-23,1%, -1,4%]	0,0358 ^a

ⁱDoor normaalapproximatie

a. t-test. De p-waarde was niet gecorrigeerd voor multipliciteit.


Functionele onafhankelijkheid 90-dagen mRS [0-2] subgroepen volgens tijd.

TLSW-intervallen	Behandeling	Controle	Verschil	p-waarde
6-9 uur	50,0% (9/18)	14,3% (3/21)	35,7% [8,2%, 63,2%]	0,0346 ^a
9-12 uur	58,1 % (18/31)	26,1% (6/24)	33,1% [8,5%, 57,6%]	0,0273 ^a
6-12 uur totaal	55,1% (27/49)	20,0% (9/45)	35,1% [16,9%, 53,3%]	0,0006^a
12-15 uur	37,5% (6/16)	9,1% (2/22)	28,4% [1,8%, 55,0%]	0,0498 ^a
15-18 uur	50,0% (13/26)	5,3% (1/19)	44,7% [23,1%, 66,4%]	0,0025 ^a
18-21 uur	36,4% (4/11)	0,0% (0/8)	36,4% [7,9%, 64,8%]	0,1032 ^a
21-24 uur	40,0% (2/5)	20,0% (1/5)	20,0% [-35,4%, 75,4%]	1,0000 ^a
12-24 uur totaal*	43,1% (25/58)	7,4% (4/54)	35,7% [21,2%, 50,2%]	< 0,0001^a

a. Fishers exact-test

* Een hoger niveau van onzekerheid in de getoonde resultaten voor testpersonen in de groep 18-24 uur sinds last-seen-well.

De p-waarde was niet gecorrigeerd voor multipliciteit.

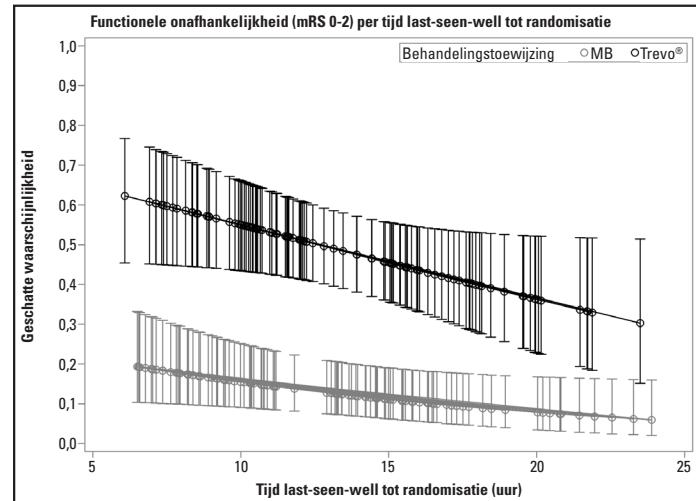

In onderstaande tabel zijn alle ernstige en niet-ernstige ongewenste voorvalen samengevat voor alle testpersonen in de controlegroep en de behandelingsgroep per MedDRA Dictionary systeemorgaanklasse (SOC).

MedDRA* System Organ Class	Behandelingsconditie N=107						Controleconditie N=99					
	Ernstige ongewenste voorvalen	Testpersonen met ernstige ongewenste voorvalen	Niet-ernstige ongewenste voorvalen	Testpersonen met niet-ernstige ongewenste voorvalen	Totaal ongewenste voorvalen	Testpersonen met totaal OV	Ernstige ongewenste voorvalen	Testpersonen met ernstige ongewenste voorvalen	Niet-ernstige ongewenste voorvalen	Testpersonen met niet-ernstige ongewenste voorvalen	Totaal ongewenste voorvalen	Testpersonen met totaal OV
Enig ongewenst voorval (OV)	65	41 (38,3%)	476	102 (95,3%)	541	103 (96,3%)	83	47 (47,5%)	473	91 (91,9%)	556	91 (91,9%)
Stoornissen in bloed- en lymfesysteem	0	0	11	10 (9,3%)	11	10 (9,3%)	1	1 (1,0%)	8	8 (8,1%)	9	8 (8,1%)
Hartstoornissen	8	7 (6,5%)	37	29 (27,1%)	45	33 (30,8%)	6	5 (5,1%)	29	24 (24,2%)	35	28 (28,3%)
Endocriene stoornissen	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	0	0	0	0
Oogaandoeningen	1	1 (0,9%)	0	0	1	1 (0,9%)	0	0	2	2 (2,0%)	2	2 (2,0%)
Gastro-intestinale stoornissen	7	6 (5,6%)	42	30 (28,0%)	49	34 (31,8%)	12	11 (11,1%)	38	28 (28,3%)	50	34 (34,3%)
Algemene stoornissen en condities van de toedieningslocatie	0	0	22	18 (16,8%)	22	18 (16,8%)	0	0	17	15 (15,2%)	17	15 (15,2%)
Hepatobiliaire stoornissen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0%)	1	1 (1,0%)
Stoornissen van het immuunsysteem	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0%)	1	1 (1,0%)
Infecties en besmettingen	6	6 (5,6%)	46	34 (31,8%)	52	38 (35,5%)	7	7 (7,1%)	54	41 (41,4%)	61	43 (43,4%)
Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties	2	2 (1,9%)	8	7 (6,5%)	10	9 (8,4%)	2	2 (2,0%)	8	6 (6,1%)	10	7 (7,1%)
Onderzoeken	0	0	5	5 (4,7%)	5	5 (4,7%)	0	0	10	10 (10,1%)	10	10 (10,1%)
Metabolisme en voedingsstoornissen	0	0	76	47 (43,9%)	76	47 (43,9%)	0	0	62	34 (34,3%)	62	34 (34,3%)
Musculoskeletale en bindweefsel/aandoeningen	0	0	11	10 (9,3%)	11	10 (9,3%)	2	2 (2,0%)	22	15 (15,2%)	24	16 (16,2%)
Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en ongespecificeerd	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	0	0	0	0
Aandoeningen van het zenuwstelsel	21	21 (19,6%)	95	63 (58,9%)	116	71 (66,4%)	34	30 (30,3%)	88	53 (53,5%)	122	66 (66,7%)
Psychiatrische stoornissen	1	1 (0,9%)	26	24 (22,4%)	27	24 (22,4%)	2	2 (2,0%)	30	27 (27,3%)	32	28 (28,3%)
Aandoeningen van nieren en urinewegen	0	0	18	15 (14,0%)	18	15 (14,0%)	1	1 (1,0%)	19	14 (14,1%)	20	15 (15,2%)
Aandoeningen van het voortplantingssysteem en borsten	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	2	2 (2,0%)	2	2 (2,0%)
Respiratoire, thoracale en mediastinale aandoeningen	14	11 (10,3%)	33	28 (26,2%)	47	33 (30,8%)	11	9 (9,1%)	42	34 (34,3%)	53	37 (37,4%)
Aandoeningen van huid en subcutaan weefsel	0	0	3	3 (2,8%)	3	3 (2,8%)	0	0	10	7 (7,1%)	10	7 (7,1%)
Chirurgische en medische procedures	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	2	2 (1,9%)	1	1 (1,0%)	2	2 (2,0%)	3	3 (3,0%)
Vasculaire aandoeningen	4	3 (2,8%)	39	33 (30,8%)	43	34 (31,8%)	4	4 (4,0%)	28	21 (21,2%)	32	23 (23,2%)

*MedDRA v17.0 werd gebruikt.

MR CLEAN onderzoek ter ondersteuning van indicatie 1

MR CLEAN was een groot, prospectief, gerandomiseerd, open-label, gecontroleerd multicenter onderzoek waar ieder endovaskulair ziekenhuiscentrum in Nederland aan deelnam. Intra-arteriële behandeling plus gebruikelijke zorg (dit kon intraveneuze toediening van IV t-PA omvatten) werd vergeleken met de gebruikelijke zorg alleen (controlegroep) bij patiënten met acute ischemische beroerte en een proximale intracraniële arteriële oclusie of de anterieure circulatie die bevestigd was door middel van bloedaf-imaging. MR CLEAN randomiseerde 500 patiënten (233 behandeling ("AT"), 267 controle) in 16 medische centra. Verwijderbare stents (inclusief de productfamilie van Trevo® verwijderinstrumenten) werden gebruikt bij 190 van de 233 patiënten (81,5%) in de behandelingsgroep, waarvan 120/190 testpersonen als eerste de intra-arteriële behandeling kregen met een Trevo verwijderinstrument, en 104/120 IV t-PA ontving binnen 3 uur na aanvang van de symptomen, vergeleken met de volledige MR CLEAN medicamenteuze behandeling (MB) controlegroep, waarvan 224 van de 249 met IV t-PA werden behandeld in overeenstemming met de FDA-etikettering. Van de meer dan 120 testpersonen die als eerste de intra-arteriële behandeling kregen met een Trevo verwijderinstrument, hadden 24 bijkomende carotisstents. Deze testpersonen zijn uitgesloten van het werkzaamheidsoverzicht; hieronder, hetgeen resulteert in een primair werkzaamheidscohort van 96 met het Trevo verwijderinstrument behandelde testpersonen. Testpersonen die IA Lytic gebruikten, of andere mechanische trombectomie-instrumenten na het Trevo verwijderinstrument werden als mislukking geteld in de werkzaamheidsoverzichten hieronder.

Belangrijkste opnamecriteria voor MR CLEAN

Acute ischemische beroerte met bevestigde oclusie van de a. carotis interna, M1, M2, A1 of A2, behandeling binnen 6 uur na aanvang van de symptomen en een NIHSS-score van > 2, uitsluiting van intracraniële bloeding middels CT of MRI; geïnformeerde toestemming verleend; leeftijd 18 jaar of ouder.

Belangrijkste opnamecriteria voor subgroep Trevo verwijderinstrument

Aanvullende opnamecriteria voor de subgroep voor het Trevo verwijderinstrument (het FDA-cohort) van MR CLEAN: eerste behandeling met Trevo verwijderinstrument en IV t-PA-behandeling binnen 3 uur na aanvang van symptomen.

Belangrijkste uitsluitingscriteria voor MR CLEAN

Arteriële bloeddruk > 185/110 mmHg; bloedglucose < 2,7 or > 22,2 mmol/L; intraveneuze trombolytische behandeling met doses van meer dan 0,9 mg/kg alteplase of 90 mg; intraveneuze trombolytische behandeling ondanks contra-indicaties (d.w.z. grotere operatieve ingreep, gastro-intestinale of urinewegbloeding in de afgelopen 2 weken of arteriële punctie op een niet-comprimeerbare locatie gedurende de afgelopen 7 dagen; cerebraal infarct in de distributie van de relevante geoclodeerde arterie gedurende de afgelopen 6 weken; laboratoriumevidentie van coagulatieafwijkingen (i.e. bloedplaatjes < 40 x 10⁹/L, APTT > 50 sec of INR > 3,0).

Het primaire eindpunt voor werkzaamheid was aan te tonen dat trombectomie met het Trevo verwijderinstrument plus MB betere resultaten voor functionele onafhankelijkheid (mRS < 3) oplevert na 90 dagen dan alleen MB, voor in aanmerking komende testpersonen die een acute ischemische beroerte hebben gehad. Uitgaande van de analyse resulteerde de intra-arteriële behandeling met het Trevo verwijderinstrument tot een zeer significant behandelingseffect na correctie voor locaties, IV t-PA-gebruik en baseline NIHSS.

Primair eindpunt effectiviteit

Variabele	Verhouding voor binaire variabelen	Odds ratio [95% BI]	p-waarde
Trevo® bij uitsluiting van carotisstents	Trevo vs. MB	1,88 [1,07; 3,29]	0,014 ¹
IV t-PA	Ja vs. Nee	1,45 [0,60; 3,52]	0,4134 ²
NIHSS	> 14 of ≤ 14	0,41 [0,24; 0,69]	0,0010 ²

¹Eenzijdige t-test.²Tweezijdige t-test.**Verdeling 90-dagen mRS***

mRS	Trevo bij uitsluiting van carotisstents (N=96)	90-dagen Mr Clean/Controle (N=249)
0	4,2% (4/96)	0,4% (1/249)
1	8,3% (8/96)	5,2% (13/249)
2	17,7% (17/96)	13,7% (34/249)
3	15,6% (15/96)	16,5% (41/249)
4	32,3% (31/96)	31,3% (78/249)
5	7,3% (7/96)	10,4% (26/249)
6	14,6% (14/96)	22,5% (56/249)
mRS [0, <3] met enig gebruik van IA Lytic beschouwd als mislukte behandeling*	29,2% (28/96)	19,3% (48/249)

¹J testpersoon die IA lytic gebruikte werd als mislukking geteld.²Testpersonen in beide onderzoeksgroepen ontvingen binnen 3 uur IV tPA (81 van de 96 testpersonen in het cohort van het Trevo verwijderinstrument en 224 van de 249 testpersonen in de groep Medicamenteuze Behandeling).

Analyse van de primaire veiligheidsdoelstellingen was gedefinieerd als de mortaliteitsverhouding voor alle oorzaken tussen de condities Trevo verwijderinstrument plus Medicamenteuze Behandeling en Medicamenteuze Behandeling alleen.

	Trevo FDA-cohort % (x/n) (LCL, UCL) ¹	MB % (x/n) (LCL, UCL) ¹
Mortaliteit na 90 dagen	13,33 (16/120) (7,82; 20,75)	22,89 (57/249) (17,82; 28,62)

¹Tweezijdig 95% Exact Clopper Pearson betrouwbaarheidsinterval.

Het eerste secundaire werkzaamheidseindpunt was het percentage patiënten zonder intracraniële oclusie, geschat door een consensusbeoordeling door maximaal drie beoordeelaars na 24 uur. Het eindpunt werd geschat met behulp van CTA MRA met gebruikmaking van de Arterial Occlusive Lesion (AOL) schaal.

	Trevo bij uitsluiting van carotisstents % (x/N) (LCL, UCL) ²	MB % (x/N) (LCL, UCL) ²
Occlusievrij (24 uur)	77,5% (62/80) (66,8; 86,1)	33,51 (65/194) (26,90; 40,62)

¹Testpersonen zonder CTA MRA na 24 uur werden uitgesloten van deze analyse²Tweezijdig 95% Exact Clopper Pearson betrouwbaarheidsinterval.

Het tweede secundaire veiligheidseindpunt is het percentage patiënten van het Trevo verwijderinstrument dat recanalisatie bereikte (TICI 2a of beter). Dit eindpunt werd ook geschat aan de hand van een consensusbeoordeling door minstens drie beoordeelaars.

	Trevo bij uitsluiting van carotisstents % (x/N) (LCL, UCL) ¹
Revascularisatiesucces (TICI ≥ 2a)	81,3% (78/96) (72,0; 88,5)

¹Tweezijdig 95% Exact Clopper Pearson betrouwbaarheidsinterval.

Het derde werkzaamheidseindpunt was gedefinieerd als het verschil in neurologische uitkomst geschat met de NIHSS na 24 uur en na 5-7 dagen na randomisatie tussen Trevo verwijderinstrument plus medicamenteuze behandeling en MB alleen.

NIHSS	Trevo Bij uitsluiting van carotisstents Gemiddelde ± SD (N) Mediaan (Min, Max) (LCL, UCL) ²	MB Gemiddelde ± SD (N) Mediaan (Min, Max) (LCL, UCL) ²
NIHSS (24 uur)	14,23 ± 9,23 (96) 14,00 (1, 42) (12,36; 16,10)	16,19 ± 7,77 (240) 16 (0, 42) (15,20; 17,18)
NIHSS (5-7 dagen) ¹	13,02 ± 12,16 (94) 12,00 (0, 42) (10,53; 15,51)	15,76 ± 11,49 (237) 15 (0, 42) (14,29; 17,23)

¹Testpersonen zonder NIHSS werden uitgesloten van deze analyse. Testpersonen die voor ontslag overleden kregen een NIHSS-score van 42.²Tweezijdige 95% betrouwbaarheidslimiet bij normaalapproximatie.

De volgende tabel vat alle ongewenste voorvallen samen over de 90 dagen na randomisatie voor het cohort van het Trevo verwijderinstrument bij toepassing van de onderzoekscategorisatie van MR CLEAN. Voor alle veiligheidsanalyses werden alle testpersonen ingesloten die behandeling met het Trevo verwijderinstrument ondergingen, met en zonder stentplaatsing.

MR CLEAN-klasse	Trevo FDA-cohort 120 testpersonen met 189 voorvallen % (x/N) [LCL, UCL] ¹ aantal voorvallen	MB 249 testpersonen met 331 voorvallen % (x/N) [LCL, UCL] ¹ aantal voorvallen
Ischemische beroerte	2,5% (3/120) [0,5%, 7,1%] 3	0,8% (2/249) [0,1%, 2,9%] 2
Symptomatische intracraniële bloeding	7,5% (9/120) [3,5%, 13,8%] 9	6,8% (17/249) [4,0%, 10,7%] 17
Extracraniële bloeding	2,5% (3/120) [0,5%, 7,1%] 3	4,4% (11/249) [2,2%, 7,8%] 11
Hartischemie	0	2,0% (5/249) [0,7%, 4,6%] 5
Allergische reactie	1,7% (2/120) [0,2%, 5,9%] 2	0,4% (1/249) [0,0%, 2,2%] 1
Longontsteking	18,3% (22/120) [11,9%, 26,4%] 24	19,3% (48/249) [14,6%, 24,7%] 52
Andere infectie	23,3% (28/120) [16,1%, 31,9%] 34	13,7% (34/249) [9,6%, 18,6%] 41
Andere complicatie	47,5% (57/120) [38,3%, 56,8%] 89	38,6% (96/249) [32,5%, 44,9%] 154
Progressie van infarct	20,8% (25/120) [14,0%, 29,2%] 25	18,9% (47/249) [14,2%, 24,3%] 48

¹Tweezijdig 95% Exact Clopper Pearson betrouwbaarheidsinterval

De volgende tabel vat alle ongewenste voorvalen van MR CLEAN samen voor de 90 dagen na randomisatie bij het FDA-cohort volgens MeDRA-codering.

MR CLEAN MeDRA v18.0 gecodeerde ongewenste voorvalen voor het FDA-cohort met een frequentie van 1% of hoger

MedDRA voorkeursterm	Trevo® FDA-cohort (N=120) patiënten met voorvalen (%)	Controlegroep (N=249) patiënten met voorvalen (%)
Infarct in ontwikkeling	19 (15,8%)	41 (16,5%)
Intracraanische bloeding	13 (10,8%)	20 (8,0%)
Urineweginfectie	11 (9,2%)	17 (6,8%)
Atriumfibrilleren	10 (8,3%)	10 (4,0%)
Pyrexie	6 (5,0%)	6 (2,4%)
Neurologische decompensatie	6 (5,0%)	6 (2,4%)
Aspiratiepneumonie	5 (4,2%)	8 (3,2%)
Delirium	4 (3,3%)	6 (2,4%)
Bottransplantatie	4 (3,3%)	1 (0,4%)
Hartfalen	3 (2,5%)	7 (2,8%)
Diarree	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Urosepsis	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Vallen	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Hoofdpijn	3 (2,5%)	1 (0,4%)
Ischemische beroerte	3 (2,5%)	1 (0,4%)
Hartstilstand	2 (1,7%)	0
Hypergevoeligheid	2 (1,7%)	1 (0,4%)
Clostridium difficile-infectie	2 (1,7%)	0
Jicht	2 (1,7%)	3 (1,2%)
Carotidissectie	2 (1,7%)	0
Epilepsie	2 (1,7%)	3 (1,2%)
Depressie	2 (1,7%)	4 (1,6%)
Urineretentie	2 (1,7%)	2 (0,8%)
Pulmonaire embolie	2 (1,7%)	6 (2,4%)
Hematoom	2 (1,7%)	2 (0,8%)
Anemie	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Bradycardie	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Epileptische aanval	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Ademhalingsinsufficiëntie	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Gastro-intestinale intubatie	1 (0,8%)	5 (2,0%)
Hypotensie	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Aderontstekeng	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Vaatspasme	1 (0,8%)	0
Aritmie	0	3 (1,2%)
Myocardischemie	0	3 (1,2%)
Nierinsufficiëntie	0	3 (1,2%)
Diep-veneuse trombose	0	3 (1,2%)

TREVO 2 onderzoek ter ondersteuning van indicatie 2

Het klinische onderzoek TREVO 2 (Thrombectomy REvascularization of large Vessel Occlusions in acute ischemic stroke) (trombectomie revascularisatie van grote bloedvatenoclusies bij acute ischemische beroerte) onderzocht de veiligheid en werkzaamheid van het Trevo verwijderinstrument in vergelijking met het Merci® verwijderinstrument. Honderdachtenzeventig (178) patiënten werden opgenomen en random toegewezen aan behandeling met het Trevo verwijderinstrument (N=88) of het Merci verwijderinstrument (N=90). Belangrijkste opnamecriteria waren: patiënten met grote bloedvatenocclusie waarbij intraveneus weefselplasminogeenactivator (IV t-PA) mislukt was of die daarvoor niet in aanmerking kwamen en die binnen 8 uur na symptoombegin konden worden behandeld; leeftijd 18-85 jaar; 8 ≤ NIHSS ≤ 29; en angiografische bevestiging van aanhoudende grote bloedvatenocclusie in de carotis interna, media cerebri (segmenten van M1 en/of M2), arteria basilaris en/of vertebrales. Belangrijkste uitsluitingscriteria waren: stenose van een proximaal bloedvat waarvoor behandeling noodzakelijk is of die toegang tot de trombus met het toegewezen onderzoeksinstrument verhindert.

Het primaire werkzaamheidsendpunt was revascularisatie, gedefinieerd als ten minste TICI 2 flow na gebruik van het toegewezen instrument, gemeten met een Core Lab. Testpersonen met een baseline TICI 2a gemeten met Core Lab, en testpersonen voor wie het instrument niet werd geprobeerd, werden uitgesloten van de onderstaande analyses.

Het primaire eindpunt voor veiligheid was de incidentie van proceduregerelateerde ernstige ongewenste voorvalen tot 24 uur na de procedure, gedefinieerd als volgt: vasculaire perforatie of intramurale arteriedissectie, symptomatische intracraniële bloeding, embolisatie van een eerder niet getroffen gebied, complicatie op de toegangslocatie waarvoor chirurgisch herstel of bloedtransfusie noodzakelijk is, mortaliteit binnen 24 uur, storing van het instrument (breken *in-vivo*) en alle andere complicaties die door de Clinical Events Committee als proceduregerelateerd worden beschouwd.

TREVO 2 onderzoeksindelpunten (patiënten met baseline TICI 0 of 1, onderzoeksinstrument geprobeerd)

Eindpunt	Trevo N=79 punten	Merci N=81 punten	Verschil [95% BI] ^b	p-waarde
Primair eindpunt effectiviteit				
Revascularisatiesucces na instrumentgebruik (TICI ≥ 2a)				
<i>Iedere aanvullende behandeling werd beschouwd als mislukte behandeling</i> [95% betr.-interval] ^a	79,7% (63/79)	49,4% (40/81)	30,4%	< 0,0001 ^c
<i>[69,2%, 88,0%]</i> <i>[38,1%, 60,7%]</i> <i>[15,0%, 44,1%]</i> <i>< 0,0001^d</i>				
Revascularisatiesucces na instrumentgebruik (TICI ≥ 2a)				
<i>Ieder gebruik van IA Lytic werd beschouwd als mislukte behandeling</i> [95% betr.-interval] ^a	87,3% (69/79)	58,0% (47/81)	29,3%	< 0,0001 ^c
<i>[78,0%, 93,8%]</i> <i>[46,5%, 68,9%]</i> <i>[15,0%, 42,4%]</i> <i>< 0,0001^d</i>				
Primair eindpunt veiligheid:				
Samengestelde voorvalen	13,9% (11/79)	23,5% (19/81)	-9,5% [-22,1%, 2,8%]	0,1567 ^e
[95% betr.-interval] ^a	[7,2%, 23,6%]	[14,8%, 34,2%]		
Vaatperforatie	0,0% (0/79)	9,9% (8/81)	-9,9% [-18,5%, -3,9%]	
Intramurale arteriële dissectie	0,0% (0/79)	1,2% (1/81)	-1,2% [-6,7%, 3,5%]	
Symptomatische intracraniële bloeding	5,1% (4/79)	9,9% (8/81)	-4,8% [-14,1%, 3,8%]	
Embolisatie in eerder niet getroffen gebied	7,6% (6/79)	4,9% (4/81)	2,7% [-5,6%, 11,4%]	
Complicatie aan toegangslocatie waarvoor chirurgisch herstel of bloedtransfusie noodzakelijk was				
1,3% (1/79)	0,0% (0/81)	1,3% [-3,3%, 6,9%]		
Mortaliteit binnen 24 uur	1,3% (1/79)	0,0% (0/81)	1,3% [-3,3%, 6,9%]	
In-vivo instrumentuitval	0,0% (0/79)	0,0% (0/81)	0,0% [-4,6%, 4,6%]	
Andere proceduregerelateerde ernstige ongewenste voorvalen	0,0% (0/79)	0,0% (0/81)	0,0% [-4,6%, 4,6%]	
mRS 0-2 na 90 dagen	38,2% (29/76)	17,9% (14/78)	20,2% [6,4%, 34,1%]	0,0068 ^e

a: Exact Clopper Pearson betrouwbaarheidsinterval voor individuele proporties; b: Exact betrouwbaarheidsinterval voor verschil in proporties berekend met StatExact versie 8; c: Niet-inferioriteitshypothese bij toepassing van Blackwelders methode met een niet-inferioriteitsmarge van 10%; d: Eenzijdige Fishers exact-test voor superioriteit; e: Tweezijdige Fishers exact-test.

GARANTIE

Stryker Neurovascular garandeert dat er redelijke zorg is betracht bij het ontwerpen en vervaardigen van dit instrument. **Deze garantie vervangt en ontkracht alle andere garanties die hier niet worden vermeld, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet door de werking van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geïmpliede garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.** Hanteren, opslag, schoonmaken en sterilisatie van dit instrument alsmede andere factoren in verband met de patiënt, diagnose, behandeling, chirurgische ingrepen en andere zaken die buiten de macht van Stryker Neurovascular vallen, zijn direct van invloed op het instrument en de resultaten die ermee worden verkregen. De aansprakelijkheid van Stryker Neurovascular volgens deze garantievoorwaarden is beperkt tot het repareren of vervangen van dit instrument; Stryker Neurovascular aanvaardt geen aansprakelijkheid voor incidentele of bijkomende schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit gebruik van dit instrument. Stryker Neurovascular aanvaardt geen, en geeft niemand de bevoegdheid tot het in naam van Stryker Neurovascular aanvaarden van, andere of aanvullende aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in verband met dit instrument. **Stryker Neurovascular aanvaardt geen aansprakelijkheid voor instrumenten die opnieuw zijn gebruikt, verwerkt of gesteriliseerd en biedt geen uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties in verband met zulke instrumenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.**

Dispositivo de Extração Trevo®

Bx ONLY

Cuidado: A lei federal (EUA) só permite a venda deste dispositivo sob receita médica.

ADVERTÊNCIA

O conteúdo é fornecido ESTERILIZADO por óxido de etileno (EO). Não utilize se o selo de esterilização estiver danificado. Se verificar a presença de quaisquer danos no produto, contacte o seu representante da Stryker Neurovascular.

Apenas para uma única utilização. Não reutilize, reprocesse nem reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou provocar a sua falha, o que, por sua vez, pode causar lesões, doença ou a morte do paciente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização também acarretam o risco de contaminação do dispositivo e/ou o risco de infecção no paciente ou infecção cruzada incluindo mas não se limitando à transmissão de doença(s) contagiosa(s) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode causar lesões, doença ou a morte do paciente.

Depois de utilizar, deite fora o produto e a embalagem de acordo com a política do hospital, administrativa e/ou do governo local.

Descrição do Dispositivo

O Dispositivo de Extração consiste num fio-núcleo cônico e flexível com uma secção moldada na ponta distal. Os marcadores de platina na ponta distal permitem visualização fluoroscópica. Além disso, a secção moldada também é radiopaca. As dimensões do dispositivo de extração estão indicadas no rótulo do produto. O Dispositivo de Extração tem um revestimento hidrofílico para reduzir a fricção durante a utilização. O Dispositivo de Extração tem um marcador na haste para indicar a proximidade da ponta do dispositivo relativamente à ponta do microcateter. Um dispositivo de torção é fornecido com o Dispositivo de Extração para facilitar a manipulação. O dispositivo de torção é utilizado para bloquear o fio-núcleo no microcateter durante o procedimento. O bloqueio do dispositivo de torção no fio permite que o microcateter e o dispositivo de extração sejam retraidos como um sistema durante a extração. Um insensor é fornecido para introduzir o dispositivo de extração num microcateter. O insensor é uma bainha na qual o dispositivo de extração vem pré-carregado. Assim que metade do comprimento do dispositivo de extração é inserido no microcateter, o insensor é removido. Os dispositivos de extração possuem uma ponta proximal modificada que permite a fixação na Extensão do Fio-guia DOC Vascular da Abbott (REF 22260). A junção da extensão do fio-guia ao dispositivo de extração facilita a remoção ou troca de um cateter, ao mesmo tempo que mantém o dispositivo de extração em posição na anatomia. Após a troca ter sido realizada, a extensão pode ser separada.

Informações para o utilizador

O Dispositivo de Extração Trevo deve ser utilizado apenas por médicos com formação em procedimentos endovasculares de intervenção.

Conteúdo

Um (1) Dispositivo de Extração Trevo

Um (1) Dispositivo de Torção

Um (1) Insensor

Compatibilidade

Tamanho do Dispositivo de Extração	Microcateter Trevo Pro14	Microcateter Trevo Pro18	Microcateteres Excelsior® XT-27® (150 cm x 6 cm retos REF XT275081)	D.I. do Vaso Mínimo Recomendado (mm)
Trevo XP ProVue 3X20 mm	✓	✓		2,5
Trevo XP ProVue 4X20 mm		✓		
Trevo ProVue 4X20 mm		✓		
Trevo XP ProVue 4X30 mm		✓	✓	
Trevo XP ProVue 6X25 mm			✓	

A compatibilidade do Dispositivo de Extração com outros microcateteres não foi estabelecida. O desempenho do Dispositivo de Extração pode ser influenciado se for utilizado um microcateter diferente.

Os cateteres-guia de balão (como o Cateter-guia de balão Merci® e o Cateter-guia de Balão FlowGate® Balloon Guide Catheter) são recomendados para utilização durante procedimentos de remoção de trombos. Os Dispositivos de Extração são compatíveis com a Válvula Hemostática Rotativa (REF 421242) da Boston Scientific.

Os Dispositivos de Extração são compatíveis com a Extensão de Fio-guia DOC Vascular (REF 22260) da Abbott.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. O Dispositivo de Extração Trevo é indicado para utilização para restaurar o fluxo sanguíneo na neurovasculatura removendo os trombos para o tratamento de acidente vascular cerebral isquémico agudo de forma a reduzir a incapacidade em pacientes com uma circulação anterior proximal e persistente, oclusão grande dos vasos e enfartes de núcleo mais pequenos que receberam primeiro ativador de plasminogénio de tecido intravenoso (IV t-PA). A terapêutica endovascular com o dispositivo deve começar nas 6 horas seguintes após o início dos sintomas.
2. O Dispositivo de Extração Trevo destina-se a restaurar o fluxo sanguíneo na neurovasculatura removendo trombos em pacientes que sofram um acidente vascular cerebral isquémico nas 8 horas seguintes após o início dos sintomas. Pacientes inelegíveis para o ativador de plasminogénio de tecido intravenoso (IV t-PA) ou que falharam a terapêutica com IV t-PA são candidatos para tratamento.
3. O Dispositivo de Extração Trevo é indicado para utilização para restaurar o fluxo sanguíneo na neurovasculatura removendo os trombos para o tratamento de acidente vascular cerebral isquémico agudo de forma a reduzir a incapacidade em pacientes com uma circulação anterior proximal e persistente, oclusão grande dos vasos da arteria carótida interna (ACI) ou segmentos M1 da artéria cerebral média (ACM) com enfartes de núcleo mais pequenos (0-50 cc para idade <80 anos, 0-20 cc para idade ≥80 anos). A terapêutica endovascular com o dispositivo deve começar nas 6-24 horas seguintes à última vez vistos bem nos pacientes que são inelegíveis para o ativador de plasminogénio de tecido intravenoso (IV t-PA) ou que falharam a terapêutica com IV t-PA.

CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma conhecidas.

ADVERTÊNCIAS

ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO 1

- A segurança e a eficácia dos Dispositivos de Extração Trevo na redução da incapacidade não foi estabelecida em pacientes com enfartes de núcleo grandes (i.e., ASPETOS ≤ 7). Podem existir riscos aumentados, como hemorragia intracerebral, nestes pacientes.
- A segurança e a eficácia dos Dispositivos de Extração Trevo na redução da incapacidade não foi estabelecida ou avaliada em pacientes com oclusões na circulação posterior (por exemplo, artérias basilar ou vertebral) ou para oclusões mais distais na circulação anterior.

ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO 2

- Para reduzir o risco de danos nos vasos, tenha cuidado ao dimensionar adequadamente o dispositivo de extração para o diâmetro do vaso no local de implantação pretendido.

ADVERTÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO 3

- A segurança e a eficácia dos Dispositivos de Extração Trevo na redução da incapacidade não foi estabelecida em pacientes com enfartes de núcleo grandes (i.e., ASPETOS ≤ 7). Podem existir riscos aumentados, como hemorragia intracerebral, nestes pacientes.
- A segurança e a eficácia dos Dispositivos de Extração Trevo na redução da incapacidade não foi estabelecida ou avaliada em pacientes com oclusões na circulação posterior (por exemplo, artérias basilar ou vertebral) ou para oclusões mais distais na circulação anterior.
- Os utilizadores devem validar as suas técnicas de análise do software de imagem para garantir resultados robustos e consistentes para avaliar a dimensão dos enfartes de núcleo.

ADVERTÊNCIAS GERAIS APLICADAS A TODAS AS UTILIZAÇÕES

- A administração de IV t-PA deve ser dentro do intervalo aprovado pela FDA (nas 3 horas seguintes ao início dos sintomas).
- Para reduzir o risco de danos nos vasos, cumpra as seguintes recomendações:
 - Não realize mais de seis (6) tentativas de extração no mesmo vaso com os dispositivos de extração.
 - Mantenha a posição do dispositivo de extração no vaso quando remover ou trocar o microcateter.
- Para reduzir o risco de dobras/fraturas, cumpra as seguintes recomendações:
 - Imediatamente após desembainhar o dispositivo de extração, posicione o marcador da ponta do microcateter proximalmente à secção moldada. Mantenha o marcador da ponta do microcateter mesmo proximalmente à secção moldada do dispositivo de extração durante a manipulação e retirada.
 - Não rode ou torça o dispositivo de extração.
 - Tenha cuidado quando passar o dispositivo de extração através de artérias com stents.
- O dispositivo de extração é um instrumento delicado e deve ser manuseado cuidadosamente. Antes da utilização e sempre que possível durante o procedimento, inspecione o dispositivo cuidadosamente quando a danos. Não utilize um dispositivo que apresente sinais de danos. Os danos podem impedir que o dispositivo funcione e causar complicações.

- Não avance ou retire o dispositivo de extração contra resistência ou vasoespasmso significativo. Qualquer torção ou movimentação do dispositivo contra uma resistência ou vasoespasmso significativo podem resultar em lesões no vaso ou danificar o dispositivo. Avalie a causa da resistência através de fluoroscopia e, se necessário, volte a embrinhar o dispositivo para retirada.
- Se o dispositivo de extração for difícil de retirar do vaso, não torça o dispositivo de extração. Avance o microcateter distalmente, com cuidado puxe para trás o dispositivo de extração no microcateter, e remova o dispositivo e o microcateter como uma unidade. Se encontrar resistência indevida quando retirar o dispositivo de extração no microcateter, considere o prolongamento do dispositivo utilizando a extensão do fio-guia DOC vascular (REF 22260) da Abbott para que o microcateter possa ser trocado para um cateter de diâmetro maior, como um Cateter DAC®. Com cuidado, retire o dispositivo de extração no cateter de diâmetro maior.
- Administre medicamentos anticoagulantes e antiplaquetários de acordo com as orientações institucionais padrão.
- Os utilizadores devem tomar todas as precauções necessárias para limitar as doses de radiação X aos pacientes e a eles próprios utilizando proteção suficiente, reduzindo os tempos de fluoroscopia e modificando os fatores técnicos dos raios-X, sempre que possível.

PRECAUÇÕES

- Guarde num local seco, escuro e fresco.
- Não utilize se as embalagens estiverem abertas ou danificadas.
- Utilize até à data de validade.
- A exposição a temperaturas superiores a 54 °C (130 °F) pode danificar o dispositivo e os acessórios. Não esterilize em autoclave.
- Não exponha o dispositivo de extração a solventes.
- Utilize o dispositivo de extração em conjunto com visualização fluoroscópica e agentes anticoagulantes adequados.
- Para evitar a formação de trombos e a formação de cristais nos meios de contraste, mantenha uma infusão constante de solução de irrigação apropriada entre o cateter-guia e o microcateter e entre o microcateter e o dispositivo de extração ou fio-guia.
- Não fixe um dispositivo de torção à extremidade proximal moldada do Dispositivo de Extração Compative DOC. Podem ocorrer danos, impedindo a capacidade de fixação à Extensão do Fio-guia DOC.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Os procedimentos que requeriam a introdução percutânea do cateter só devem ser executados por médicos familiarizados com as complicações possíveis que possam ocorrer durante ou após o procedimento. As complicações possíveis incluem, mas não se limitam às seguintes:

- embolia gássica
- hematoma ou hemorragia no local de punção
- infecção
- embolização distal
- dor/dor de cabeça
- espasmo do vaso
- trombose
- dissecção
- perfuração
- êmbolos
- oclusão aguda do vaso
- isquemia
- hemorragia intracraniana
- formação de falso aneurisma
- deficiência neurológica incluindo acidente vascular cerebral
- morte

A utilização do dispositivo requer fluoroscopia que apresenta potenciais riscos para médicos e pacientes associados à exposição a raios-X. Os riscos possíveis incluem, mas não se limitam aos seguintes:

- alopecia,
- queimaduras, variando em gravidade, de vermelhidão da pele a úlceras,
- cataratas,
- neoplasia retardada.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Notifique imediatamente o seu representante da Stryker Neurovascular se um dispositivo não estiver a funcionar corretamente, se o paciente apresentar complicações ou lesões, ou se houver suspeita destas. Guarda qualquer dispositivo suspeito, os seus componentes e as respetivas embalagens, para devolução à Stryker Neurovascular.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os produtos da Stryker Neurovascular são esterilizados e apirogénicos quando conservados numa embalagem que não foi aberta, concebida para manter a esterilidade, a não ser que a bolsa principal do produto tenha sido aberta ou danificada.

Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Não utilize se a etiquetagem estiver incompleta ou ilegível.

Manuseamento e armazenamento

Guarde num local fresco, seco e escuro.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Procedimento de Preparação Recomendado:

- Irrigue o aro acondicionador do dispositivo de extração com solução salina. Hidrate durante 2 minutos, no mínimo, antes de remover o dispositivo de extração do aro. Mantenha o dispositivo de extração hidratado.
- Prepare e coloque o cateter-guia de balão ou cateter-guia na artéria carótida interna, artéria carótida comum ou artéria subclávia, conforme especificado na rotulagem do cateter-guia.
- Ligue a válvula hemostática rotativa ao encaixe do microcateter.
- Utilizando técnicas de cateterização convencionais, coloque o microcateter no vaso alvo com um fio-guia neurovascular padrão. Se a anatomia permitir, posicione a ponta do microcateter distalmente ao trombo.
- Remova o fio-guia do microcateter. Injeite meio de contraste através do microcateter para visualizar a vasculatura distal. Irrigue o microcateter.
- Remova o insensor e o dispositivo de extração pré-carregado, como uma unidade, do aro acondicionador. Não permita que o dispositivo de extração saia da ponta do insensor ou retraia mais no insensor.
- Importante:** introduza o insensor até metade na válvula hemostática rotativa e utilize uma seringa ou o tubo de infusão para irrigar o insensor até a solução salina sair na extremidade proximal do insensor. Se o insensor não for irrigado adequadamente, pode ser difícil fazer avançar o dispositivo de extração através do insensor.
- Asente o insensor no encaixe do microcateter e feche bem a válvula hemostática rotativa para manter o insensor no lugar.
- Faça avançar o dispositivo de extração até metade do seu comprimento ter sido inserido no microcateter. Remova o insensor.

Procedimento de Extração Recomendado

- Avance o dispositivo de extração até a ponta distal alinhar com a ponta distal do microcateter.

Nota: a tabela seguinte descreve onde a ponta do dispositivo de extração (a extremidade distal do dispositivo de extração) se encontra em relação à ponta do microcateter (a extremidade distal do microcateter) quando:

- a extremidade distal do marcador da haste do dispositivo de extração alcança o encaixe do microcateter ou
- a extremidade proximal do marcador da haste do dispositivo de extração alcança a extremidade proximal da válvula hemostática rotativa.

Tabela de Monitorização da Extremidade Distal

Trevo® ProVue 4x20 mm Trevo XP ProVue 4X20 mm Trevo XP ProVue 6X25 mm	<ul style="list-style-type: none"> A 8 cm de sair da ponta do microcateter
Trevo XP 3x20 mm	<ul style="list-style-type: none"> A 15 cm de sair da ponta do microcateter
Trevo XP 4x30 mm	<p>Quando utilizado com Trevo Pro 18 MC (90238):</p> <ul style="list-style-type: none"> A 8 cm de sair da ponta do microcateter <p>Quando utilizado com Excelsior® XT-27® MC (XT275081):</p> <ul style="list-style-type: none"> A 15 cm de sair da ponta do microcateter

- Retraia o microcateter enquanto exerce força suavemente para a frente para o dispositivo de extração implantar a secção moldada do dispositivo no coágulo. Posicione o marcador da ponta do microcateter mesmo proximalmente à secção moldada do dispositivo de extração.

ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de dobras/fraturas, mantenha o marcador da ponta do microcateter mesmo proximalmente à secção moldada do dispositivo de extração durante a manipulação e retirada.

- Após implantar o dispositivo de extração, visualize a expansão do suporte e dê tempo suficiente para o coágulo integrar no dispositivo de extração (aproximadamente 5 minutos).

- Se utilizar um cateter-guia de balão, encha o balão para ocluir o vaso, conforme especificado na rotulagem do cateter-guia de balão.

- Posicione e bloquee o dispositivo de torção no dispositivo de extração no encaixe do microcateter.
- Lentamente retire o dispositivo de extração e o microcateter, como uma unidade, para a ponta do cateter-guia de balão, enquanto aplica aspiração ao cateter-guia de balão com uma seringa de 60 mL.
- Aplique aspiração intensa ao cateter-guia de balão com uma seringa de 60 mL e retire o dispositivo de extração e o microcateter no interior do cateter-guia. Continue a aspirar até o dispositivo de extração e o microcateter estarem quase retirados do cateter-guia.

Nota: se a retirada no cateter-guia de balão ou cateter-guia é difícil, esvazie o balão do cateter-guia de balão e, simultaneamente, retire o cateter-guia, microcateter e dispositivo de extração, como uma unidade, através da bainha. Se necessário, remova a bainha.

- Esvazie o balão do cateter-guia de balão.
- Desligue a válvula hemostática rotativa do cateter-guia de balão e remova completamente o dispositivo de extração, microcateter e válvula hemostática rotativa, como uma unidade, do cateter-guia.
- Prenda a seringa de 60 mL ao encaixe do cateter-guia de balão e aspire.
- Lime o dispositivo com solução salina. Verifique se o dispositivo de extração apresenta danos. Não reutilize o dispositivo de extração, se o fio-núcleo, secção moldada ou bobina de platina parecem diferentes de quando foram removidos pela primeira vez da embalagem. Se existirem danos, o dispositivo de extração pode ser utilizado até três (3) tentativas de extração. Uma tentativa de extração é um (1) ciclo de avanço e retirada completa.

Procedimento de Troca de Cateter Recomendado

- Siga as Instruções de Utilização fornecidas com a Extensão do Fio-guia DOC Vascular da Abbott, exceto trate o "dispositivo de extração" como o "fio-guia" quando seguir os passos das instruções de utilização.

ESTUDOS CLÍNICOS

Informação sobre Segurança e Eficácia

Estudo DAWN™ para suportar a Utilização 3

DAWN (Avaliação IMD e PTC com Discrepança Clínica na Triagem de Acidentes Vasculares Cerebrais ao Despertar e de Apresentação Tardia Submetidos a Neurointervenção) foi um ensaio controlado, multicêntrico, aleatorizado e prospectivo desenhado para avaliar a hipótese da trombectomia com Dispositivo de Extração Trevo® mais gestão médica originar resultados clínicos superiores aos 90 dias em comparação com apenas gestão médica em participantes adequadamente selecionados que sofreram um acidente vascular cerebral isquémico agudo quando o tratamento é iniciado nas 6-24 horas após a última vez que foram vistos bem. Um total de 206 participantes foi inscrito em 26 centros de investigação: 107 participantes (51,9%) foram aleatorizados para o Braço de Tratamento e 99 (48,1%) foram aleatorizados para o Braço de Controlo. Os valores UW-mRS médios aos 90 dias foram 5,5 no Braço de Tratamento vs. 3,4 no Braço de Controlo; a diferença ajustada do grupo de enfarte de núcleo em grau ponderado/utilidade de incapacidade foi de 2,0 (Intervalo Credível de Bayesian de 95%, 1,1 a 3,0, probabilidade posterior de superioridade >0,9999). O tratamento com o Dispositivo de Extração Trevo originou taxas mais elevadas de independência funcional (mRS 0-2) aos 90 dias, 48,6% vs. 13,1%; diferença ajustada do grupo de enfarte de núcleo 32,8% (Intervalo Credível de 95%, 21,1% a 44,1%, probabilidade posterior de superioridade >0,9999). A taxa de hemorragia intracraniana sintomática às 24 horas foi mais elevada em pacientes submetidos a terapêutica endovascular. Os pacientes e/ou os seus representantes legalmente autorizados devem ser avisados deste risco durante o processo de tomada de decisão de tratamento. Existe um maior nível de incerteza nos resultados mostrados para participantes no período de 18-24 desde a última vez vistos bem.

Critérios Principais de Inclusão

Acidente vascular cerebral isquémico agudo com oclusão confirmada da ACI intracraniana e/ou M1, que falhou ou era contraindicado para IV t-PA, tratamento nas 6-24 horas após última vez vistos bem, NIHSS de base ≥10, consentimento informado dado e com 18 anos ou mais; em pacientes com menos de 80, um resultado de acidente vascular cerebral igual ou maior do que o do 10 deve ser associado a um volume de núcleo inferior a 51 mL. Em pacientes com 80 anos ou mais velhos, o resultado de acidente vascular cerebral deve ser superior a 10 e o volume inferior a 21 mL. A discrepança clínica/núcleo que é definida como o descrepança entre o volume de enfarte de base (ou núcleo) na imagem de TC ou RM e a extensão do tecido cerebral total em risco. O volume de enfarte foi avaliado com a utilização de imagens de ressonância magnética ponderada/difusão (RM) ou CT de perfusão e foi medido com um dos pacotes de software automático (RAPID, IschemiaView) comerciais.

Critérios Principais de Exclusão

Melhoria rápida no estado neurológico para um NIHSS <10 ou prova de recanalização do vaso antes da aleatorização; tensão arterial > 185/110 mmHg; prova laboratorial de desequilíbrio de eletrólitos (i.e. sódio <130 mmol/L, potássio<3 mEq/l ou >6 mEq/l); resultado laboratorial de insuficiência renal (i.e. creatinina sérica >3,0 mg/dL (264 µmol/l); resultado laboratorial de anomalias de coagulação (i.e., contagem de plaquetas <50 000/µL, APTT>3 vezes normal ou INR>3,0, se determinado fator do inibidor Xa 24-48 horas atrás tem de ter PTT normal); resultado laboratorial de hemorragia (i.e. hemoglobina <7 mmol/L).

O objetivo principal foi incapacidade de 90 dias avaliada pela escala de Rankin modificada (mRS).

O objetivo secundário é providenciar provas de que a reperfusão endovascular com o Dispositivo de Extração Trevo está associada a uma redução significativa na dimensão do enfarte mediana em comparação com o grupo de controlo às 24 (-6/+24) horas pós-aleatorização. Os objetivos secundários incluem a proporção de participantes com um bom resultado funcional aos 90 dias (mRS de 0-2); proporção de participantes com queda de NIHSS de ≥10 pontos da base ou resultado de NIHSS 0 ou 1; diferença entre braço de tratamento e de controlo em todos causa mortalidade; diferença na dimensão do enfarte final mediana às 24 horas; diferença nas taxas de revascularização às 24 horas; e taxa de reperfusão para TICI >2b.

Os resultados de segurança incluem incidência de mortalidade relacionada com acidente vascular cerebral aos 90 dias; incidência de hemorragia intracerebral espontânea (HICE), deterioração neurológica, efeitos indesejáveis graves relacionados com o dispositivo e procedimentos.

População ITT na Escala de Rankin Modificada aos 90 Dias

Escala de Rankin Modificada (mRS)	Braço de Tratamento N=107	Braço de Controlo N=99
0 - Sem sintomas / UW = 10	9,3% (10/107)	4,0% (4/99)
1 - Sem incapacidade significativa / UW = 9,1	22,4% (24/107)	5,1% (5/99)
2 - Incapacidade leve / UW = 7,6	16,8% (18/107)	4,0% (4/99)
3 - Incapacidade moderada / UW = 6,5	13,1% (14/107)	16,2% (16/99)
4 - Incapacidade moderadamente grave / UW = 3,3	13,1% (14/107)	34,3% (34/99)
5 - Incapacidade grave / UW = 0	6,5% (7/107)	18,2% (18/99)
6 - Morte / UW = 0	18,7% (20/107)	18,2% (18/99)
mRS 90 dias [0-2]	48,6% (52/107)	13,1% (13/99)
mRS ponderada 90 dias*		
Média ± SD (N)	5,5 ± 3,8 (107)	3,4 ± 3,2 (99)
Mediana (Q1, Q3)	6,5 (0,0, 9,1)	3,3 (0,0, 6,5)
Intervalo (mín., máx.)	(0,0, 10,0)	(0,0, 10,0)
[Intervalo Conf. 95%]*	[4,8, 6,3]	[2,7, 4,0]

*Por aproximação normal

*mRS = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} foi atribuída ao valor numérico correspondente = {10, 9, 1, 7, 6, 5, 3, 0, 0}, que representa a sua utilidade clínica

Resultados Coprimários da População ITT

Resultado	Intervenção (N=107)	Controlo (N=99)	Diferença Absoluta Média (IC 95%)	Benefício médio posterior, ajustado ao núcleo (intervalo credível 95%)*	Probabilidade de superioridade
mRS ponderada/ utilidade-média (SD)	5,5 (3,8)	3,4 (3,1)	2,1 (1,2, 3,1)	2,0 (1,1, 3,0)	>0,9999 ¹
Independência Funcional (mRS 0-2)	48,6%	13,1%	35,5% (23,9%, 47,0%)	32,8% (21,1%, 44,1%)	>0,9999

*Estimado pelo modelo linear geral de Bayesian ajustando para Enfarre de Núcleo

¹A probabilidade geral do benefício de um dispositivo é, então, a média das probabilidades do benefício para os conjuntos de dados imputados, ponderado pelas probabilidades de imputação daqueles conjuntos de dados. Esta probabilidade é de 0,999986.

O segundo objetivo de eficácia secundário foi a queda de NIHSS de ≥10 pontos da base ou um resultado de NIHSS de 0 ou 1.

Resposta Neurológica Precoce ao Dia 5-7/Alta

Resultado	Intervenção N=107	Controlo N=99	Diferença Absoluta Média (IC 95%)	Relação de Risco (IC 95%)	Valor p
Resposta Precoce†	47,7%	19,2%	28,5% (16,2%, 40,7%)	2,5 (1,6, 3,9)	<0,001

[†]Definida como queda de NIHSS de ≥ 10 pontos da base ou NIHSS 0 ou 1 ao dia 5-7 ou alta (a que ocorrer primeiro). O valor p não foi ajustado para multiplicidade.

O resultado de eficácia secundário foi as taxas de revascularização às 24 horas definido como a presença de recanalização parcial ou completa.

Taxas de revascularização às 24 horas

	Total N=206	Braço de Tratamento N=107	Braço de Controlo N=99	Diferença [IC 95%]	Valor p
Diferença nas taxas de revascularização às 24 (-6/+24) horas a partir de aleatorização	58,7% (121/206)	76,6% (82/107)	38,4% (38/99)	40,2% [27,1%, 51,5%]	< 0,0001 ^a

A revascularização às 24 horas foi definida como a presença de recanalização parcial ou completa.

a. Teste t. O valor p não foi ajustado para multiplicidade.

O objetivo principal de segurança foi a incidência de mortalidade relacionada com o acidente vascular cerebral aos 90 dias. Os resultados de segurança secundários para os dois Braços de Tratamento e de Controlo são a incidência de HICE, pela definição ECASS, nas 24 (-6/+24) horas pós-aleatorização (hora zero) e incidência de deterioração neurológica do resultado de NIHSS de base nos Dias 5-7/alta (o que ocorre primeiro) pós-aleatorização. A deterioração neurológica foi definida como aumento de ≥ 4 pontos no resultado de NIHSS do resultado de base.

Mortalidade Relacionada com Acidente Vascular Cerebral aos 90 Dias

	Total N=206	Braço de Tratamento N=107	Braço de Controlo N=99	Diferença [IC 95%]	Valor p
Incidência da mortalidade relacionada com todos os acidentes vasculares cerebrais aos 90 dias	17,0% (35/206)	15,9% (17/107)	18,2% (18/99)	-2,3% [-12,6%, 8,0%]	0,7126 ^a

^aPor aproximação normal

a. Teste t. O valor p não foi ajustado para multiplicidade.

O resultado de segurança secundário foi a Incidência de HICE, pela definição ECASS III, nas 24 (-6/+24) horas pós-aleatorização (hora zero).

Incidência de HICE pela Adjudicação CEC

	Total N=206	Braço de Tratamento N=107	Braço de Controlo N=99	Diferença [IC 95%]	Valor p
HIVE às 24 (-6/+24) horas pós-aleatorização	4,4% (9/206)	5,6% (6/107)	3,0% (3/99)	2,6% [-2,9%, 8,1%]	0,5011 ^a

^aPor aproximação normal

a. Teste exato de Fisher. O valor p não foi ajustado para multiplicidade.

A incidência de deterioração neurológica foi definida como um aumento de ≥ 4 pontos no resultado de NIHSS da base nos Dias 5-7/Alta pós-aleatorização (hora zero).

Incidência de Deterioração Neurológica pela Adjudicação CEC

	Total N=206	Braço de Tratamento N=107	Braço de Controlo N=99	Diferença [IC 95%]	Valor p
Incidência de deterioração neurológica entre a base e Dia 5 a 7/Alta	19,9% (41/206)	14,0% (15/107)	26,3% (26/99)	-12,2% [-23,1%, -1,4%]	0,0358 ^a

^aPor aproximação normal

a. Teste t. O valor p não foi ajustado para multiplicidade.


Independência funcional (mRS 90 dias 0-2) Subagrupados por tempo

Intervalos UVVB	Tratamento	Controlo	Diferença	Valor p
6-9 horas	50,0% (9/18)	14,3% (3/21)	35,7% [8,2%, 63,2%]	0,0346 ^a
9-12 horas	58,1% (18/31)	26,1% (6/24)	33,1% [8,5%, 57,6%]	0,0273 ^a
Total 6-12 horas	55,1% (27/49)	20,0% (9/45)	35,1% [16,9%, 53,3%]	0,0006^a
12-15 horas	37,5% (6/16)	9,1% (2/22)	28,4% [1,8%, 55,0%]	0,0498 ^a
15-18 horas	50,0% (13/26)	5,3% (1/19)	44,7% [23,1%, 66,4%]	0,0025 ^a
18-21 horas	36,4% (4/11)	0,0% (0/8)	36,4% [7,9%, 64,8%]	0,1032 ^a
21-24 horas	40,0% (2/5)	20,0% (1/5)	20,0% [-35,4%, 75,4%]	1,0000 ^a
Total 12-24*	43,1% (25/58)	7,4% (4/54)	35,7% [21,2%, 50,2%]	< 0,0001^a

a. Teste exato de Fisher.

*Maior nível de incerteza nos resultados mostrados para participantes no período de 18-24 horas desde a última vez vistos bem.

O valor p não foi ajustado para multiplicidade.

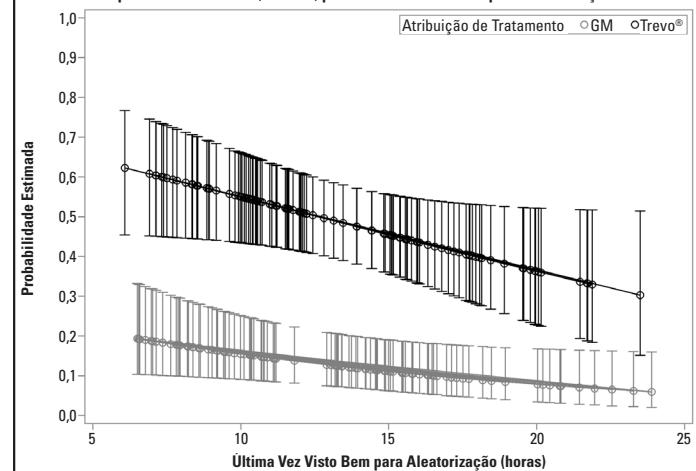Independência Funcional (mRS 0-2) por Última Vez Visto Bem para Aleatorização

A tabela seguinte é um resumo de todos os efeitos indesejáveis graves e não graves para os participantes do Braço de Tratamento e Braço de Controlo pelos Grupos Sistémicos MedDRA.

MedDRA* Grupo Sistémico	Braço de Tratamento N=107						Braço de Controlo N=99					
	EIG	Participantes com EIG	Sem EIG	Participantes Sem EIG	Total EI	Participantes com EI Totais	EIG	Participantes com EIG	Sem EIG	Participantes Sem EIG	Total EI	Participantes com EI Totais
Qualquer Efeito Indesejável (EI)	65	41 (38,3%)	476	102 (95,3%)	541	103 (96,3%)	83	47 (47,5%)	473	91 (91,9%)	556	91 (91,9%)
Doenças sanguíneas e do sistema linfático	0	0	11	10 (9,3%)	11	10 (9,3%)	1	1 (1,0%)	8	8 (8,1%)	9	8 (8,1%)
Doenças cardíacas	8	7 (6,5%)	37	29 (27,1%)	45	33 (30,8%)	6	5 (5,1%)	29	24 (24,2%)	35	28 (28,3%)
Doenças endócrinas	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	0	0	0	0
Doenças oftalmológicas	1	1 (0,9%)	0	0	1	1 (0,9%)	0	0	2	2 (2,0%)	2	2 (2,0%)
Doenças gastrointestinais	7	6 (5,6%)	42	30 (28,0%)	49	34 (31,8%)	12	11 (11,1%)	38	28 (28,3%)	50	34 (34,3%)
Doenças gerais e condições dos locais de administração	0	0	22	18 (16,8%)	22	18 (16,8%)	0	0	17	15 (15,2%)	17	15 (15,2%)
Doenças hepatobiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0%)	1	1 (1,0%)
Doenças do sistema imunológico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 (1,0%)	1	1 (1,0%)
Infeções e infestações	6	6 (5,6%)	46	34 (31,8%)	52	38 (35,5%)	7	7 (7,1%)	54	41 (41,4%)	61	43 (43,4%)
Lesão, envenenamento e complicações de procedimentos	2	2 (1,9%)	8	7 (6,5%)	10	9 (8,4%)	2	2 (2,0%)	8	6 (6,1%)	10	7 (7,1%)
Investigações	0	0	5	5 (4,7%)	5	5 (4,7%)	0	0	10	10 (10,1%)	10	10 (10,1%)
Distúrbios metabólicos e nutricionais	0	0	76	47 (43,9%)	76	47 (43,9%)	0	0	62	34 (34,3%)	62	34 (34,3%)
Doenças músculo-squeléticas e do tecido conjuntivo	0	0	11	10 (9,3%)	11	10 (9,3%)	2	2 (2,0%)	22	15 (15,2%)	24	16 (16,2%)
Neoplasmas benignos, malignos e não especificados	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	0	0	0	0
Doenças do sistema nervoso	21	21 (19,6%)	95	63 (58,9%)	116	71 (66,4%)	34	30 (30,3%)	88	53 (53,5%)	122	66 (66,7%)
Distúrbios psiquiátricos	1	1 (0,9%)	26	24 (22,4%)	27	24 (22,4%)	2	2 (2,0%)	30	27 (27,3%)	32	28 (28,3%)
Doenças renais e urinárias	0	0	18	15 (14,0%)	18	15 (14,0%)	1	1 (1,0%)	19	14 (14,1%)	20	15 (15,2%)
Doenças mamárias e do sistema reprodutivo	0	0	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	0	0	2	2 (2,0%)	2	2 (2,0%)
Doenças respiratórias, torácicas e mediastínicas	14	11 (10,3%)	33	28 (26,2%)	47	33 (30,8%)	11	9 (9,1%)	42	34 (34,3%)	53	37 (37,4%)
Doenças da pele e tecidos subcutâneos	0	0	3	3 (2,8%)	3	3 (2,8%)	0	0	10	7 (7,1%)	10	7 (7,1%)
Procedimentos médicos e cirúrgicos	1	1 (0,9%)	1	1 (0,9%)	2	2 (1,9%)	1	1 (1,0%)	2	2 (2,0%)	3	3 (3,0%)
Doenças vasculares	4	3 (2,8%)	39	33 (30,8%)	43	34 (31,8%)	4	4 (4,0%)	28	21 (21,2%)	32	23 (23,2%)

*Foi usada MedDRA v17.0.

Estudo MR CLEAN para suportar Utilização 1

MR CLEAN foi um ensaio multicêntrico, controlado, aberto, aleatorizado, prospectivo e grande em que participaram todos os centros hospitalares endovasculares da Holanda. O tratamento intra-arterial mais cuidados habituais (que podiam incluir administração intravenosa de IV t-PA) foram comparados com apenas cuidados habituais (grupo de controlo) em pacientes com acidente vascular cerebral isquémico agudo e uma oclusão arterial intracraniana proximal da circulação anterior que foram confirmados por imagem dos vasos. MR CLEAN aleatorizou 500 pacientes (233 tratamento [“IAT”], 267 controlo) em 16 centros médicos. Foram utilizados stents recuperáveis (incluindo a família de produtos do Dispositivo de Extração Trevo®) em 190 dos 233 pacientes (81,5%) atribuídos ao braço IAT, dos quais 120/190 participantes receberam tratamento intra-arterial de primeira linha com um Dispositivo de Extração Trevo e 104/120 receberam IV t-PA nas 3 horas seguintes ao início dos sintomas em comparação com todo o grupo de controlo de Gestão Médica (GM) MR CLEAN, dos quais 224 de 249 foram tratados com IV t-PA de acordo com a rotulagem da FDA. Dos 120 participantes que receberam tratamento intra-arterial de primeira linha com um Dispositivo de Extração Trevo, 24 participantes tiveram stenting carótido concomitante. Estes participantes estão excluídos do resumo de eficácia abaixo resultando numa coorte de eficácia primária de 96 participantes tratados com o Dispositivo de Extração Trevo. Os participantes com utilização lítica IA ou utilização de outros dispositivos de trombectomia mecânicos após o Dispositivo de Extração Trevo foram contados como falhas em resumos de eficácia abaixo.

Critérios Principais de Inclusão para MR CLEAN

Acidente vascular cerebral isquémico agudo com oclusão confirmada da ACI, M1, M2, A1 ou A2, tratamento nas 6 horas seguintes ao início dos sintomas e NIHSS >2, exame de TC ou RM excluíram hemorragia intracraniana; consentimento informado dado; e 18 anos ou mais.

Critérios Principais de Inclusão para Subconjunto do Dispositivo de Extração Trevo

Critérios de inclusão essenciais adicionais para análise do subconjunto do Dispositivo de Extração Trevo (Coorte da FDA) de MR CLEAN: tratamento de primeira linha com Dispositivo de Extração Trevo e IV t-PA nas 3 horas seguintes ao início dos sintomas.

Critérios Principais de Exclusão para MR CLEAN

Tensão arterial > 185/110 mmHg; glicose no sangue <2,7 ou > 22,2 mmol/L; tratamento intravenoso com terapêutica trombólita numa dose superior a 0,9 mg/kg de alteplase ou 90 mg; tratamento intravenoso com terapêutica trombólica apesar das contra-indicações (i.e., grande cirurgia, hemorragia gastrointestinal ou hemorragia do trato urinário nas 2 semanas anteriores ou punção arterial num local não compressível nos 7 dias anteriores; enfarte cerebral na distribuição da artéria ocluída relevante nas 6 semanas anteriores; prova laboratorial de anormalidades de coagulação (i.e., contagem de plaquetas <40x10⁹/L, APTT>50 s ou INR>3,0).

O objetivo principal de eficácia foi para demonstrar que a trombectomia com Dispositivo de Extração Trevo mais MM leva a independência funcional superior (mRS <3) aos 90 dias em comparação com apenas GM em participantes elegíveis que sofreram um acidente vascular cerebral isquémico agudo. Com base na análise, o tratamento IAT o Dispositivo de Extração Trevo resultou num efeito de tratamento altamente significativo quando ajustado para locais, utilização de IV t-PA e NIHSS de base.

Objetivo Principal de Eficácia

Variável	Relação para variáveis binárias	Razão de probabilidade [IC 95%]	Valor p
Stenting carótido concomitante excluindo Trevo	Trevo vs. GM	1,88 [1,07, 3,29]	0,014 ¹
IV t-PA	Sim vs. Não	1,45 [0,60, 3,52]	0,413 ⁴²
NIHSS	>14 ou ≤14	0,41 [0,24, 0,69]	0,0010 ²

¹Teste t unicaudal.

²Teste t bicaudal.

Distribuição de mRS de 90 dias*

mRS	Stenting carótido concomitante excluindo Trevo® (N=96)	Mr Clean/Controlo de 90 DIAS (N=249)
0	4,2% (4/96)	0,4% (1/249)
1	8,3% (8/96)	5,2% (13/249)
2	17,7% (17/96)	13,7% (34/249)
3	15,6% (15/96)	16,5% (41/249)
4	32,3% (31/96)	31,3% (78/249)
5	7,3% (7/96)	10,4% (26/249)
6	14,6% (14/96)	22,5% (56/249)
mRS [0, <3] com qualquer utilização lítica IA Considerada Falha de Tratamento*	29,2% (28/96)	19,3% (48/249)

*I participante com utilização lítica IA foi contado como uma falha.

*Os participantes em ambos os braços receberam IV tPA nas 3 horas seguintes (81 de 96 participantes na coorte Dispositivo de Extração Trevo e 224 de 249 participantes no braço de gestão médica).

A análise do objetivo principal da segurança foi definida como a taxa de mortalidade por todas as causas entre o Dispositivo de Extração Trevo mais gestão médica em comparação com a taxa de mortalidade por todas as causas no grupo de controlo de apenas gestão médica.

	Coorte FDA Trevo % (x/n) (LCL, UCL) ¹	GM % (x/n) (LCL, UCL) ¹
Mortalidade aos 90 dias	13,33 (16/120) (7,82, 20,75)	22,89 (57/249) (17,82, 28,62)

¹Intervalos de confiança exatos de Clopper Pearson de 95% bicaudais.

O primeiro objetivo de eficácia secundária foi a percentagem de pacientes sem oclusão intracraniana avaliada por uma revisão de consenso até três leitores após 24 horas. O objetivo foi avaliado por CTA MRA utilizando a escala de Lesão Oclusiva Arterial (AOL).

	Stenting carótido concomitante excluindo Trevo % (x/N) (LCL, UCL) ²	GM % (x/N) (LCL, UCL) ²
Sem oclusão (24 horas)	77,5% (62/80) (66,8, 86,1)	33,51 (65/194) (26,90, 40,62)

¹Os participantes sem CTA MRA 24 horas foram excluídos desta análise

²Intervalos de confiança exatos Clopper Pearson de 95% bicaudais.

O segundo objetivo de eficácia secundária é a percentagem de doentes com o Dispositivo de Extração Trevo que alcançaram a recanalização (TICI 2a ou melhor). Este objetivo também foi avaliado por uma revisão de consenso pelo, pelo menos, três leitores.

	Stenting carótido concomitante excluindo Trevo % (x/N) (LCL, UCL) ¹
Sucesso da revascularização (TICI ≥ 2a)	81,3% (78/96) (72,0, 88,5)

¹Intervalos de confiança exatos de Clopper Pearson de 95% bicaudais.

O terceiro objetivo de eficácia foi definido como a diferença nos resultados neurológicos avaliada pelo NIHSS às 24 horas e 5-7 dias pós-aleatorização entre o Dispositivo de Extração Trevo mais gestão médica em comparação com o grupo de controlo GM.

NIHSS	Stenting carótido concomitante excluindo Trevo Média ± SD (N) Mediana (Mín, Máx) (LCL, UCL) ²	GM Média ± SD (N) Mediana (Mín, Máx) (LCL, UCL) ²
NIHSS (24 Horas)	14,23 ± 9,23 (96) 14,00 (1, 42) (12,36, 16,10)	16,19 ± 7,77 (240) 16 (0, 42) (15,20, 17,18)
NIHSS (5-7 dias)¹	13,02 ± 12,16 (94) 12,00 (0, 42) (10,53, 15,51)	15,76 ± 11,49 (237) 15 (0, 42) (14,29, 17,23)

¹Os participantes com NIHSS em falta foram excluídos desta análise. Aos participantes que expiraram antes da alta foi atribuído um valor NIHSS de 42.

²Limits de confiança de 95% bicaudais com aproximação normal.

A tabela seguinte resume todos os efeitos indesejáveis durante os 90 dias pós-aleatorização, para a coorte o Dispositivo de Extração Trevo de participantes, utilizando a categorização do estudo MR CLEAN. Para todas as análises de segurança, os participantes expostos ao Dispositivo de Extração Trevo com ou sem stenting carótido estão incluídos.

Classe MR CLEAN	Coorte FDA Trevo 120 participantes c/189 Eventos % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Número de Eventos	GM 249 participantes c/331 Eventos % (x/N) [LCL, UCL] ¹ Número de Eventos
Acidente vascular cerebral isquémico	2,5% (3/120) [0,5%, 7,1%] 3	0,8% (2/249) [0,1%, 2,9%] 2
Hemorragia intracraniana sintomática	7,5% (9/120) [3,5%, 13,8%] 9	6,8% (17/249) [4,0%, 10,7%] 17
Hemorragia extracraniana	2,5% (3/120) [0,5%, 7,1%] 3	4,4% (11/249) [2,2%, 7,8%] 11
Isquemia cardíaca	0	2,0% (5/249) [0,7%, 4,6%] 5
Reação alérgica	1,7% (2/120) [0,2%, 5,9%] 2	0,4% (1/249) [0,0%, 2,2%] 1
Pneumonia	18,3% (22/120) [11,9%, 26,4%] 24	19,3% (48/249) [14,6%, 24,7%] 52
Outra infecção	23,3% (28/120) [16,1%, 31,9%] 34	13,7% (34/249) [9,6%, 18,6%] 41
Outra complicação	47,5% (57/120) [38,3%, 56,8%] 89	38,6% (96/249) [32,5%, 44,9%] 154
Progressão do acidente vascular cerebral	20,8% (25/120) [14,0%, 29,2%] 25	18,9% (47/249) [14,2%, 24,3%] 48

¹Intervalos de confiança exatos de Clopper Pearson de 95% bicaudais

A tabela seguinte resume todos os efeitos indesejáveis de MR CLEAN durante os 90 dias após aleatorização, para a coorte da FDA, pela codificação MeDRA.

Efeitos Indesejáveis Codificados MR CLEAN MeDRA v18.0 para coorte da FDA acima de 1% de frequência

Termo Preferido MedDRA	Coorte da FDA Trevo® (N=120) Pacientes com eventos (%)	Controlo (N=249) Pacientes com eventos (%)
Acidente vascular cerebral em evolução	19 (15,8%)	41 (16,5%)
Hemorragia intracraniana	13 (10,8%)	20 (8,0%)
Infeção do trato urinário	11 (9,2%)	17 (6,8%)
Fibrilação auricular	10 (8,3%)	10 (4,0%)
Pirexia	6 (5,0%)	6 (2,4%)
Descompensação neurológica	6 (5,0%)	6 (2,4%)
Pneumonia de aspiração	5 (4,2%)	8 (3,2%)
Delírio	4 (3,3%)	6 (2,4%)
Enxerto ósseo	4 (3,3%)	1 (0,4%)
Insuficiência cardíaca	3 (2,5%)	7 (2,8%)
Diarreia	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Urosepsis	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Queda	3 (2,5%)	4 (1,6%)
Dores de cabeça	3 (2,5%)	1 (0,4%)
Acidente vascular cerebral isquémico	3 (2,5%)	1 (0,4%)
Paragem cardíaca	2 (1,7%)	0
Hipersensibilidade	2 (1,7%)	1 (0,4%)
Infeção por Clostridium difficile	2 (1,7%)	0
Gota	2 (1,7%)	3 (1,2%)
Dissecção da artéria carótida	2 (1,7%)	0
Epilepsia	2 (1,7%)	3 (1,2%)
Depressão	2 (1,7%)	4 (1,6%)
Retenção urinária	2 (1,7%)	2 (0,8%)
Embolia pulmonar	2 (1,7%)	6 (2,4%)
Hematoma	2 (1,7%)	2 (0,8%)
Anemia	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Bradicardia	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Ataques	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Insuficiência respiratória	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Inserção de tubo gastrointestinal	1 (0,8%)	5 (2,0%)
Hipotensão	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Flebite	1 (0,8%)	3 (1,2%)
Vasoespasmo	1 (0,8%)	0
Arritmia	0	3 (1,2%)
Isquemia do miocárdio	0	3 (1,2%)
Insuficiência renal	0	3 (1,2%)
Trombose grave na veia	0	3 (1,2%)

Estudo TREVO 2 para suportar Utilização 2

O ensaio clínico TREVO 2 (Thrombectomy REvascularization of large Vessel Occlusions - Resvascularização por Trombectomia de Oclusões Grandes de Vasos em acidente vascular cerebral isquémico) avaliou a segurança e a eficácia do Dispositivo de Extração Trevo em comparação com o Dispositivo de Extração Merci®. Cento e setenta e oito (178) pacientes foram inscritos e aleatorizados para tratamento com o Dispositivo de Extração Trevo (N=88) ou o Dispositivo de Extração Merci (N=90). Os critérios principais de inclusão foram: pacientes com uma grande oclusão dos vasos que falharam ou eram inelegíveis para o ativador de plasminogênio do tecido intravascular (IV t-PA) e que podiam ser tratados nas 8 horas seguintes ao início dos sintomas do acidente vascular cerebral; idade 18-85; 8 ≤ NIHSS ≤ 29; e confirmação angiográfica de uma oclusão grande dos vasos persistente na carótida interna, artérias cerebral média (segmentos M1 e/ou M2), basilar e/ou vertebral. Os critérios principais de exclusão foram: estenose num vaso proximal que requer tratamento ou que impede o acesso ao trombo com o dispositivo atribuído ao estudo.

O objetivo principal da eficácia foi a revascularização definida como, pelo menos, fluxo TICI 2 após utilização do dispositivo atribuído, conforme medido por um Laboratório Nuclear. Os participantes com uma base TICI 2a por Laboratório Nuclear e os participantes em quem o dispositivo nunca foi tentado foram excluídos da análise mostrada na tabela abaixo.

O objetivo principal de segurança foi a incidência de efeitos indesejáveis graves relacionados com procedimentos (EIGRP) durante 24 horas pós-procedimento definida como: perfuração vascular ou dissecção arterial intramural, HIC sintomática, embolização para um território não envolvido previamente, complicação no local de acesso que requer reparação cirúrgica ou transfusão sanguínea, mortalidade nas 24 horas, falha do dispositivo (rotura in-vivo) ou quaisquer outras complicações consideradas pela Comissão de Eventos Clínicos para serem relacionadas com o procedimento.


Objetivos do Estudo TREVO 2 (Participantes com TICI de Base 0 ou 1, Dispositivo do estudo tentado)

Objetivo	Trevo N=79 pts	Merci N=81 pts	Diferença [IC 95%] ^a	Valor p
Objetivo principal de eficácia				
Sucesso da revascularização pós-dispositivo (TICI ≥ 2a)				
<i>Utilização de qualquer terapêutica adjacente considerada falha do tratamento</i>	79,7% (63/79)	49,4% (40/81)	30,4%	<0,0001 ^c
[Intervalo Conf. 95%] ^a	[69,2%, 88,0%]	[38,1%, 60,7%]	[15,0%, 44,1%]	<0,0001 ^d
Objetivo principal de segurança				
Eventos compostos	13,9% (11/79)	23,5% (19/81)	-9,5% [-22,1%, 2,8%]	0,1567 ^e
[Intervalo Conf. 95%] ^a	[7,2%, 23,6%]	[14,8%, 34,2%]		
Perfuração do Vaso	0,0% (0/79)	9,9% (8/81)	-9,9% [-18,5%, -3,9%]	
Dissecção Arterial Intramural	0,0% (0/79)	1,2% (1/81)	-1,2% [-6,7%, 3,5%]	
HIC sintomática	5,1% (4/79)	9,9% (8/81)	-4,8% [-14,1%, 3,8%]	
Embolização em Território Não Envolvido Previamente	7,6% (6/79)	4,9% (4/81)	2,7% [-5,6%, 11,4%]	
Complicação no local de acesso requerendo reparação cirúrgica ou transfusão sanguínea	1,3% (1/79)	0,0% (0/81)	1,3% [-3,3%, 6,9%]	
Mortalidade nas 24 horas	1,3% (1/79)	0,0% (0/81)	1,3% [-3,3%, 6,9%]	
Falha do Dispositivo in-vivo	0,0% (0/79)	0,0% (0/81)	0,0% [-4,6%, 4,6%]	
Outro EIG-RP	0,0% (0/79)	0,0% (0/81)	0,0% [-4,6%, 4,6%]	
mRS 0-2 aos 90 dias	38,2% (29/76)	17,9% (14/78)	20,2% [6,4%, 34,1%]	0,0068 ^e

a: intervalos de confiança exatos de Clopper Pearson em proporções individuais; b: intervalos de confiança exatos sobre diferenças em proporções calculadas com StatXact Versão 8; c: hipótese de não inferioridade utilizando o método de Blackwelder com margem de não inferioridade de 10%; d: teste exato de Fisher unicaudal de superioridade; e: teste exato de Fisher bicaudal.

GARANTIA

A Stryker Neurovascular garante que foram tomados todos os cuidados devidos na concepção e fabrico deste instrumento. Esta garantia substitui e exclui todas as outras aqui não expressamente mencionadas, explícitas ou implícitas por força de lei, ou de qualquer outra forma, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação para fins específicos. O manuseio, o armazenamento, a limpeza e a esterilização deste instrumento, bem como os factores relacionados com o paciente, diagnóstico, tratamento, procedimentos cirúrgicos e outros assuntos fora do controlo da Stryker Neurovascular afectam directamente o instrumento e os resultados obtidos pela sua utilização. A responsabilidade da Stryker Neurovascular, de acordo com esta garantia, limita-se à reparação ou substituição deste instrumento e a Stryker Neurovascular não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais ou consequenciais resultantes, directa ou indirectamente, da utilização deste instrumento. A Stryker Neurovascular não assume, nem autoriza qualquer outra pessoa a assumir em seu nome, qualquer outra obrigação ou responsabilidade adicional em relação a este instrumento. A Stryker Neurovascular não assume nenhuma responsabilidade relativamente a instrumentos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados e não estabelece quaisquer garantias, explícitas ou implícitas, incluindo mas não se limitando à comercialização ou adequação para fins específicos, em relação a estes instrumentos.

REF	Catalog Number Número de catálogo Numéro de catalogue Bestell-Nr. Número di catalogo Catalogusnummer Referencia	LOT	Lot Lote Lot Charge Lotto Partij Lote	STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide. Esterilizado por óxido de etileno. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Mit Ethylenoxid sterilisiert. Sterilizzato con ossido di etilene. Gesteriliseerd met ethylenoxide. Esterilizado por óxido de etileno.
	Consult instructions for use. Consultar las instrucciones de uso. Consulter le mode d'emploi. Gebruchsweisung beachten. Consultare le istruzioni per l'uso. Raadpleeg instructies voor gebruik. Consulte as Instruções de Utilização.		Recyclable Package Envase recicitable Emballage recyclable Wiederverwertbare Verpackung Confezione riciclabile Recyclebare verpakking Embalagem Recicável		Nonpyrogenic Apirógeno Apyrogène Nicht pyrogen Apirogeno Niet-pyrogeen Apirogénico
	www.strykerneurovascular.com/DFU Consult instructions for use on this website. Consultar las instrucciones de uso en el siguiente sitio web. Consulter le mode d'emploi sur ce site Web. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf dieser Website. Consultare le istruzioni per l'uso su questo sito Web. Raadpleeg instructies voor gebruik op deze website. Consulte as Instruções de Utilização neste website.		Use By Fecha de caducidad Date limite d'utilisation Verwendbar bis Usare entro Uiterste gebruiksdatum Validade		Flush package hoop with saline before removing device Limpie el aro del envase con solución salina antes de retirar el dispositivo Laver l'anneau d'emballage avec un sérum physiologique avant de retirer le dispositif Die Packung vor Herausnehmen der Vorrichtung mit Kochsalzlösung spülen Irrigare la confezione con soluzione fisiologica prima di rimuovere il dispositivo Spoel de beschermring met fysiologische zoutoplossing alvorens het instrument te verwijderen Regue o tubo da embalagem com soro fisiológico antes de retirar o dispositivo
	Contents Contenido Contenu Inhalt Contenuto Inhoud Conteúdo		Australian Sponsor Address Dirección del patrocinador australiano Adresse du promoteur australien Adresse des australischen Sponsors Indirizzo sponsor australiano Adres Australische sponsor Endereço do Patrocinador Australiano		
EC REP	EU Authorized Representative Representante autorizado en la UE Représentant agréé UE Autorisierter Vertreter in der EU Rappresentante autorizzato per l'UE Erkend vertegenwoordiger in EU Representante Autorizado na U.E.		For single use only. Do not reuse. Para un solo uso. No reutilizar. À usage unique. Ne pas réutiliser. Für den einmaligen Gebrauch. Nicht wieder verwenden. Esclusivamente monouso. Non riutilizzare. Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken. Apenas para uma única utilização. Não reutilize.		
	Legal Manufacturer Fabricante legal Fabricant légal Berechtigter Hersteller Fabbricante legale Wettelijke fabrikant Fabricante Legal		Do Not Resterilize No reesterilizar Ne pas restériliser Nicht erneut sterilisieren Non risterilizzare Niet opnieuw steriliseren Não reesterilize		
	Date of Manufacture Fecha de fabricación Date de fabrication Herstellungsdatum Data di fabbricazione Fabricagedatum Data de Fabrico		Do not use if package is damaged. No usar si el envase está dañado. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.		



**Australian
Sponsor Address**

Stryker Australia Pty Ltd
8 Herbert Street
St Leonards, NSW 2065
Australia



**Legal
Manufacturer**

Stryker Neurovascular
47900 Bayside Parkway
Fremont, CA 94538
USA
USA Customer Service 855-91 NEURO (916-3876)



**Do not use if package
is damaged.**



**Recyclable
Package**

€ 0459

Copyright © 2018 Stryker

2018-06



NV00030337-01